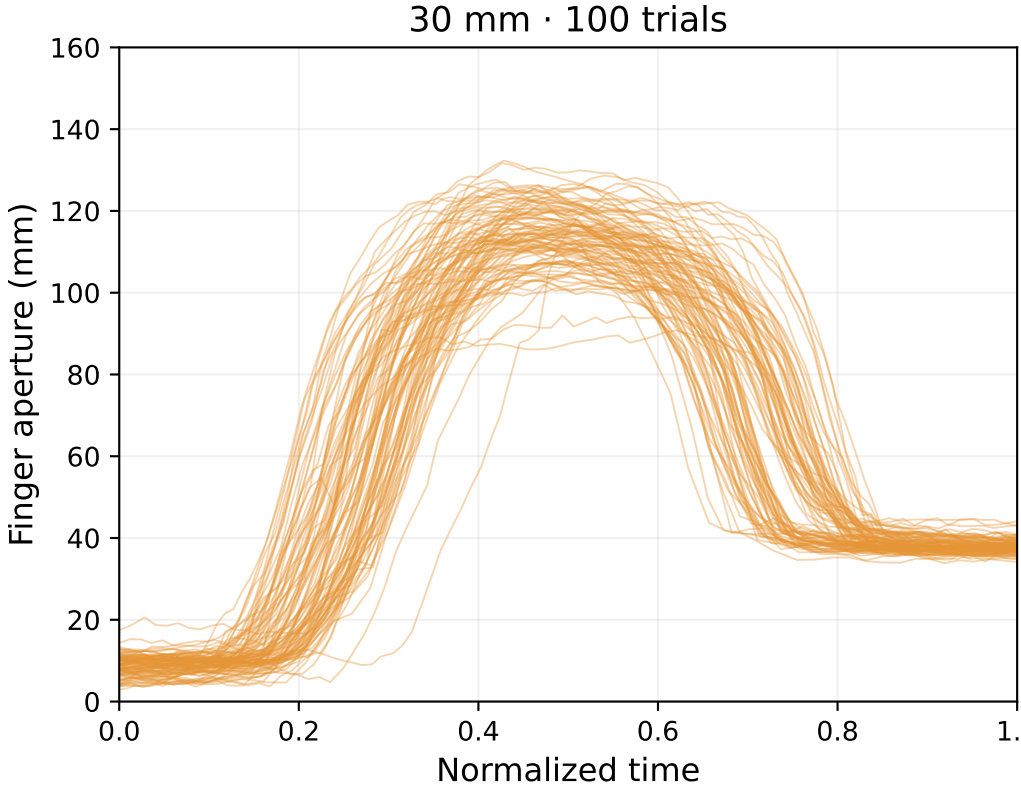

30 mm · 100 trials
Finger aperture (mm)
160
140
120
100
80
60
40
20
0
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Normalized time