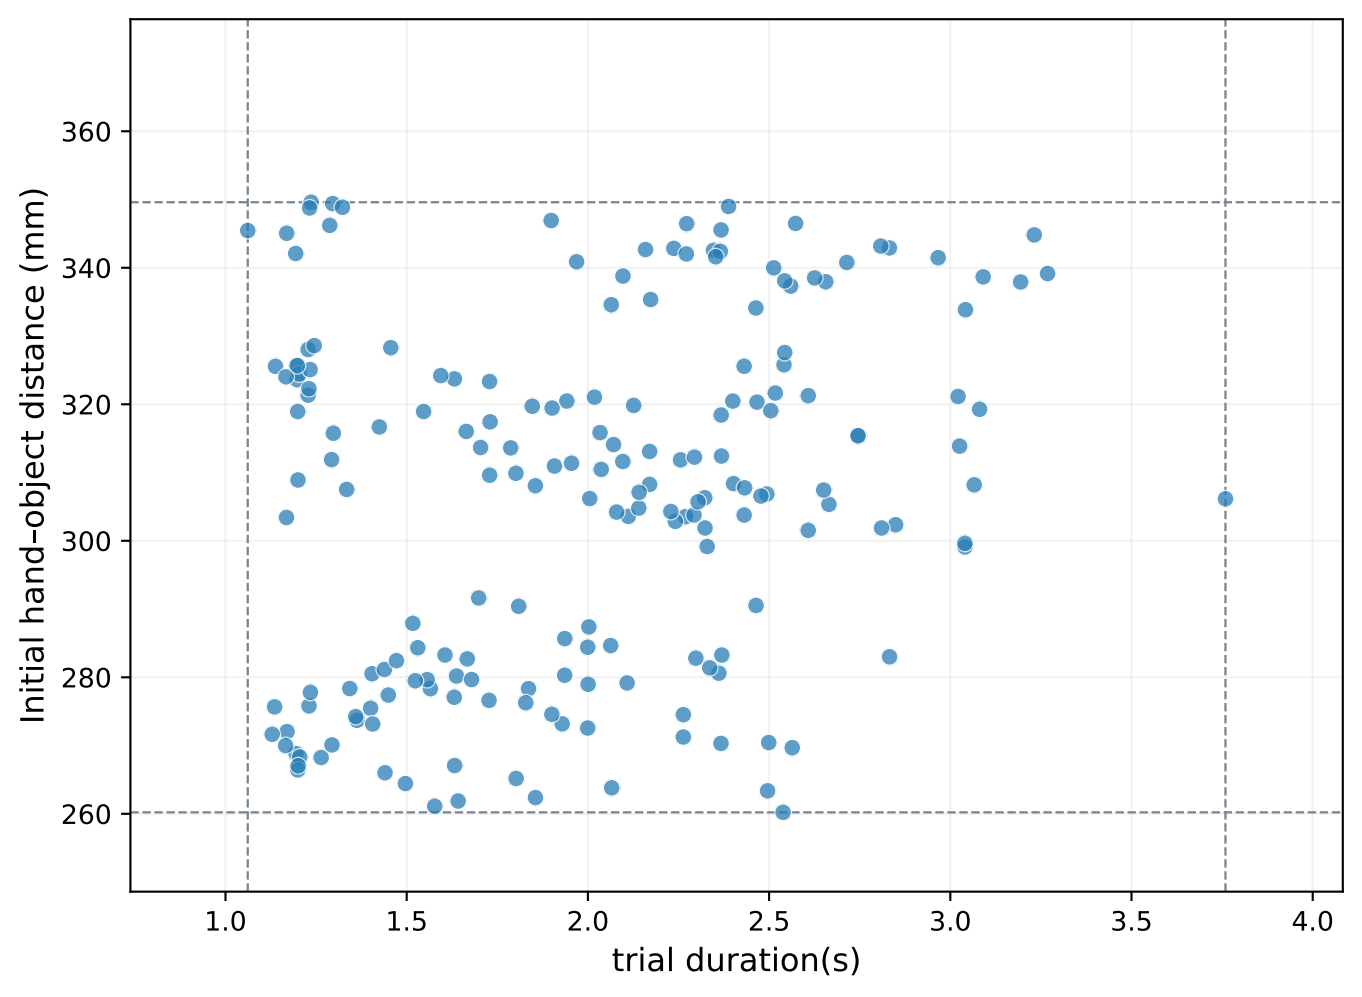
Initial hand–object distance (mm)
360
340
320
300
280
260
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
trial duration(s)