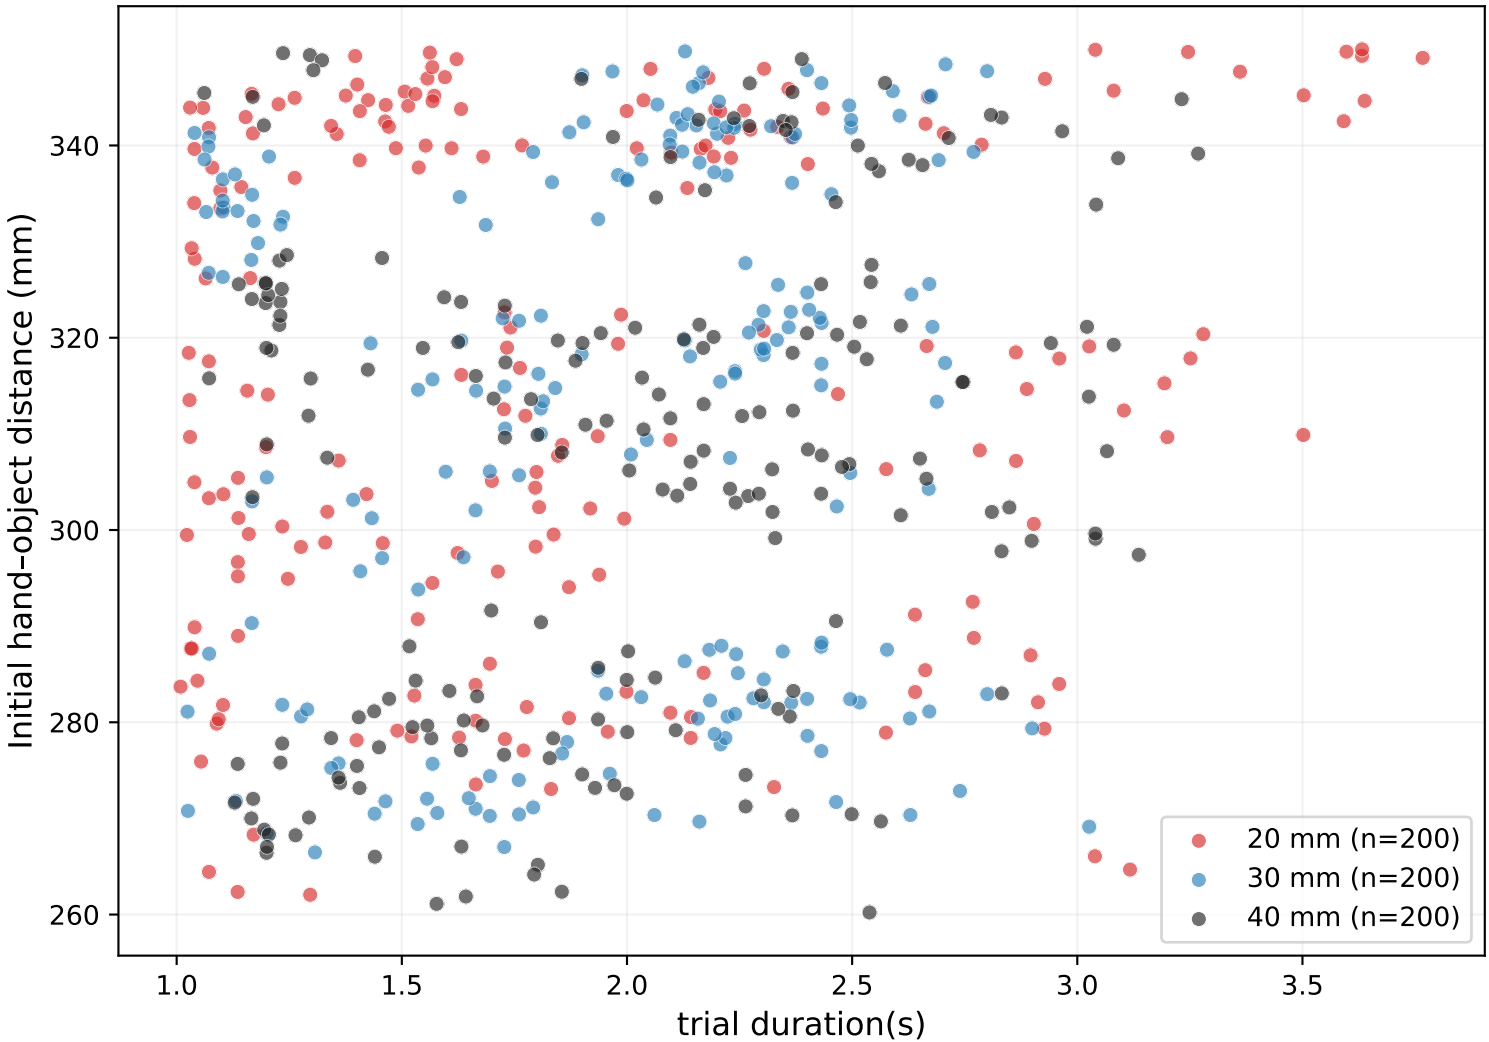
Initial hand–object distance (mm)
340
320
300
280
260
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
trial duration(s)
20 mm (n=200)
30 mm (n=200)
40 mm (n=200)