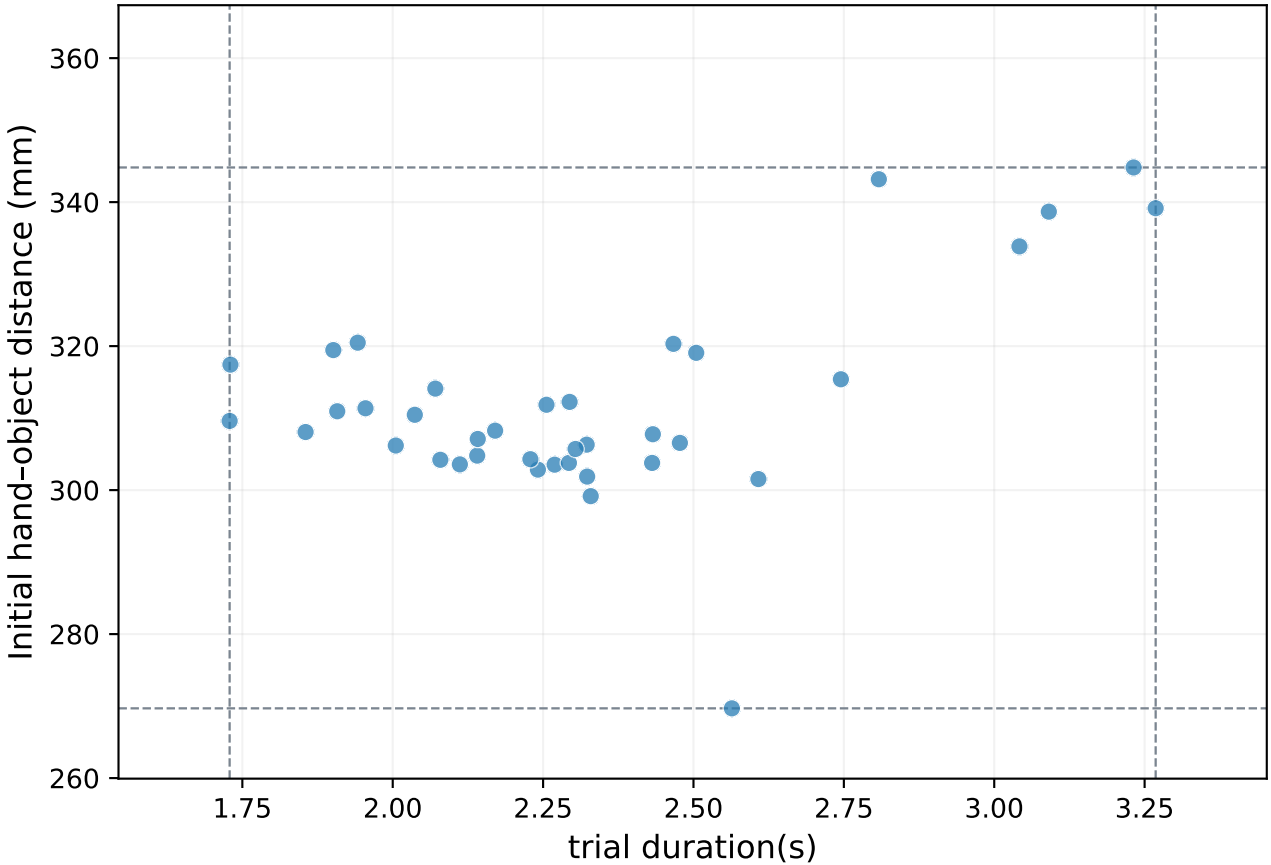
Initial hand–object distance (mm)
360
340
320
300
280
260
1.75
2.00
2.25
2.50
2.75
3.00
3.25
trial duration(s)