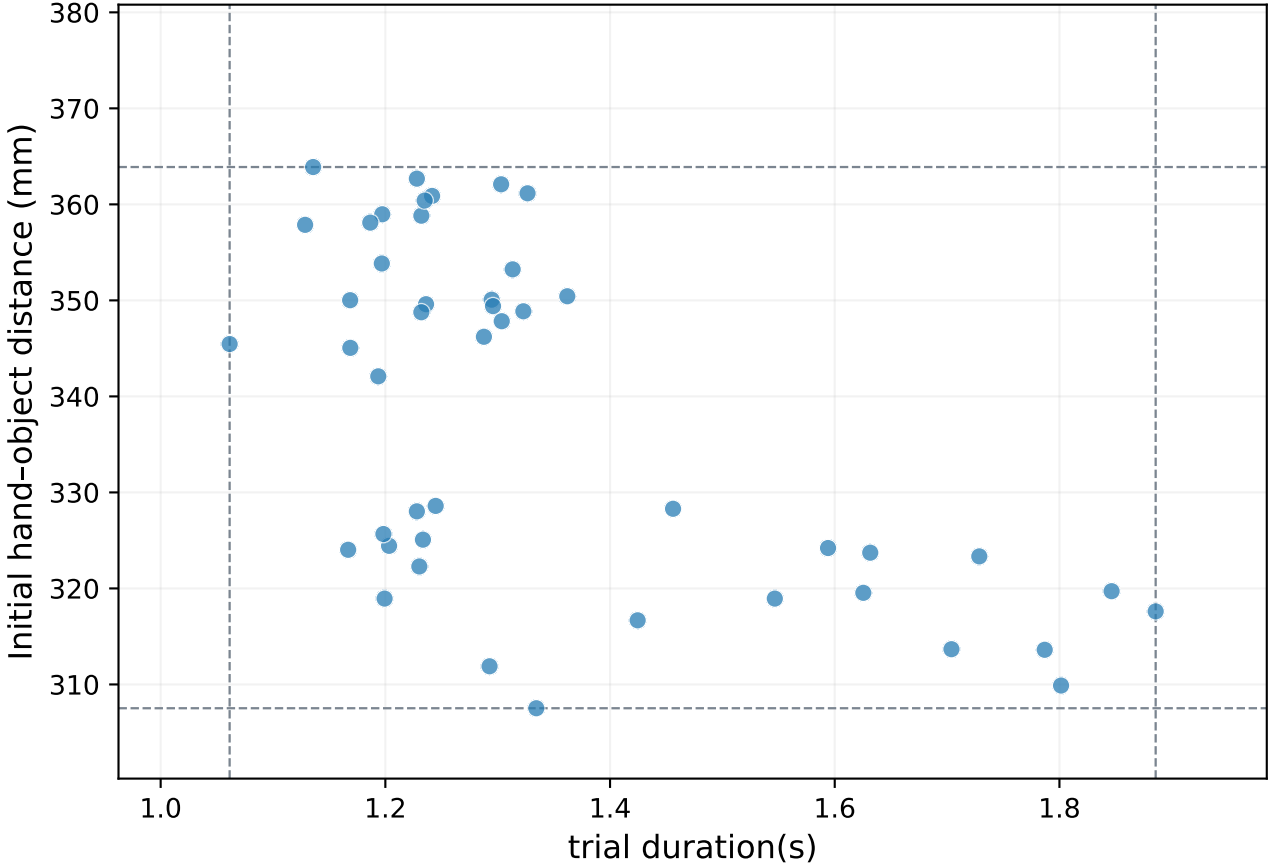
Initial hand–object distance (mm)
380
370
360
350
340
330
320
310
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
trial duration(s)