


A

B

C

D


7.进样进入轨道位置有无试管架检测

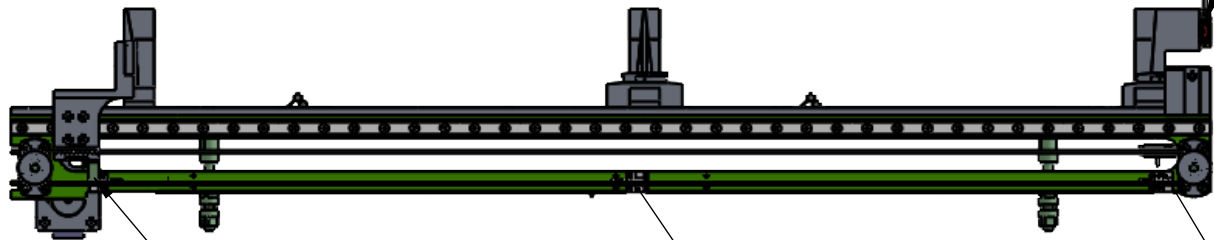

13.进样推杆电机原点

15.进样推杆位置提篮2头光电检测


14.进样推杆位置提篮1头光电检测

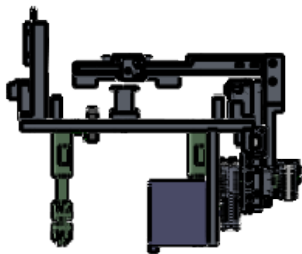

压力传感器


17.进样提篮2感应开关

16.进样提篮1感应开关

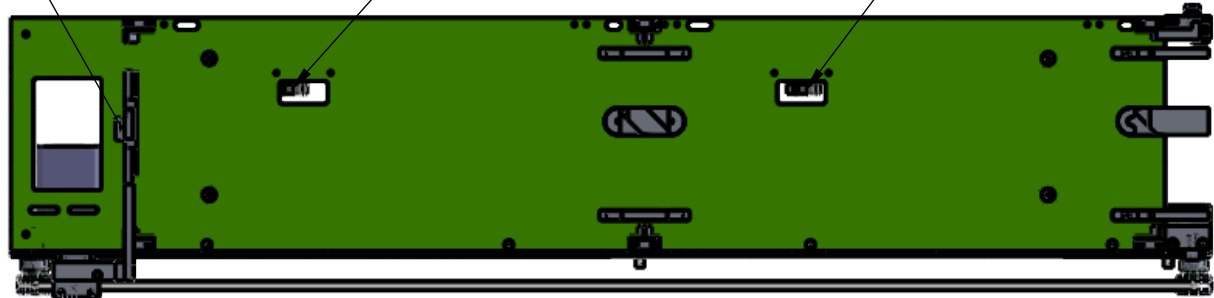

1		1
2		1
3		1
4		1
5		1
6		1
7		1
8		2
9		2
10		4
11		8
12		1
13		1
14		1
15		3
16		2
17		4
18		1
19		4
20		2
21		1
22		1
23		1
24		1
25		1

26		1
27		2
28		2
29		1
30		1
31		1
32		1
33		1
34		1
35		2
36		2
37		2
38		1
39		1
40		1
41		1
42		1
43		1
44	GB/T77-2000内六角平端紧定螺钉M6×10 S002-0145-00	2
45	M001-9852-00 提篮送样固定底板	1
46	S003-0113-00 拖链E03.10.010.43(750).03.10.12Z.A2	1
47	M001-9850-00 收样传感器调节盖板	1
48	M001-9851-00 提篮头段定位块2	1
49	S002-0149-00 GB/T879.4-2000 弹性圆柱销卷制2×32	1

						苏州立禾生物医学工程有限公司			xxx	
									xxx	
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年 月 日	阶 段 标 记		质量		比例
设计			标准化					3.31		1:10
校核			工艺							
主管设计			审核							
			批准			共 1 张 第 1 张		版本 1.0	替代	