


数据检测

远程通讯


仪器网线接口

VDDIO 使用 3.3v

Title		
Size	Number	Revision
A3		
Date:	2019/11/15	Sheet of
File:	F:\H360 免疫仪器硬件设计\COMMON	Drawn By:

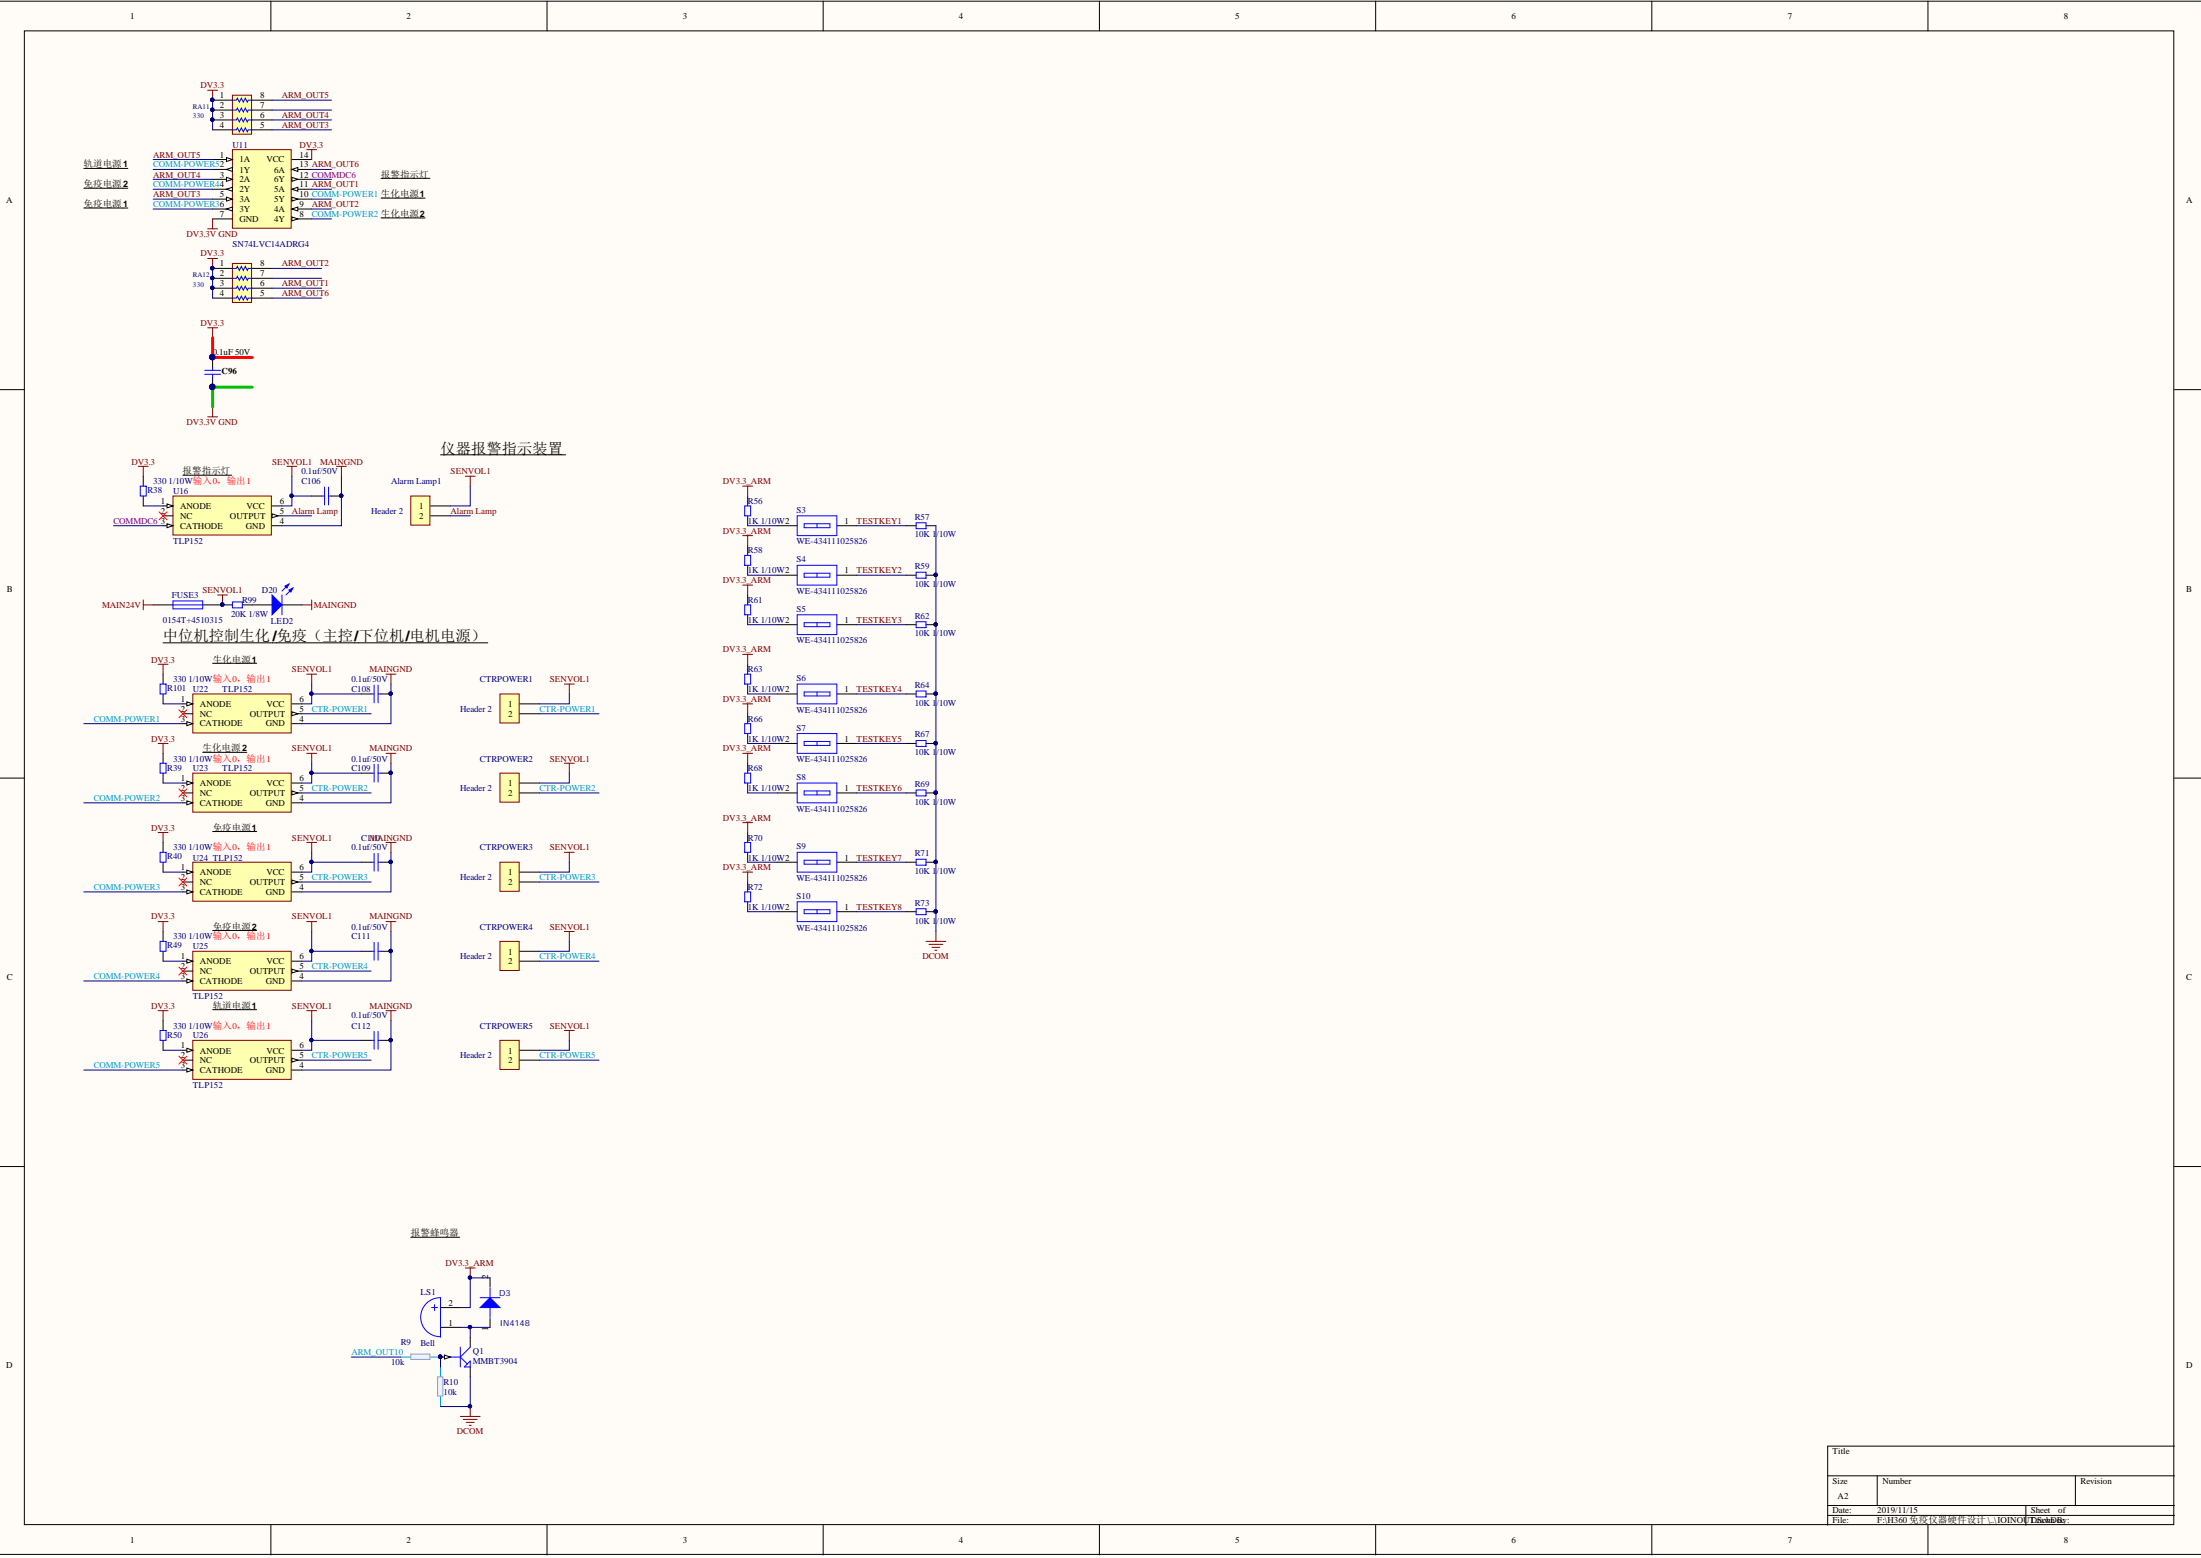

Title		
Size	Number	Revision
A2		
Date:	2019/11/15	Sheet of
File:	031320 免疫仪器硬件设计\1、IOINO	1

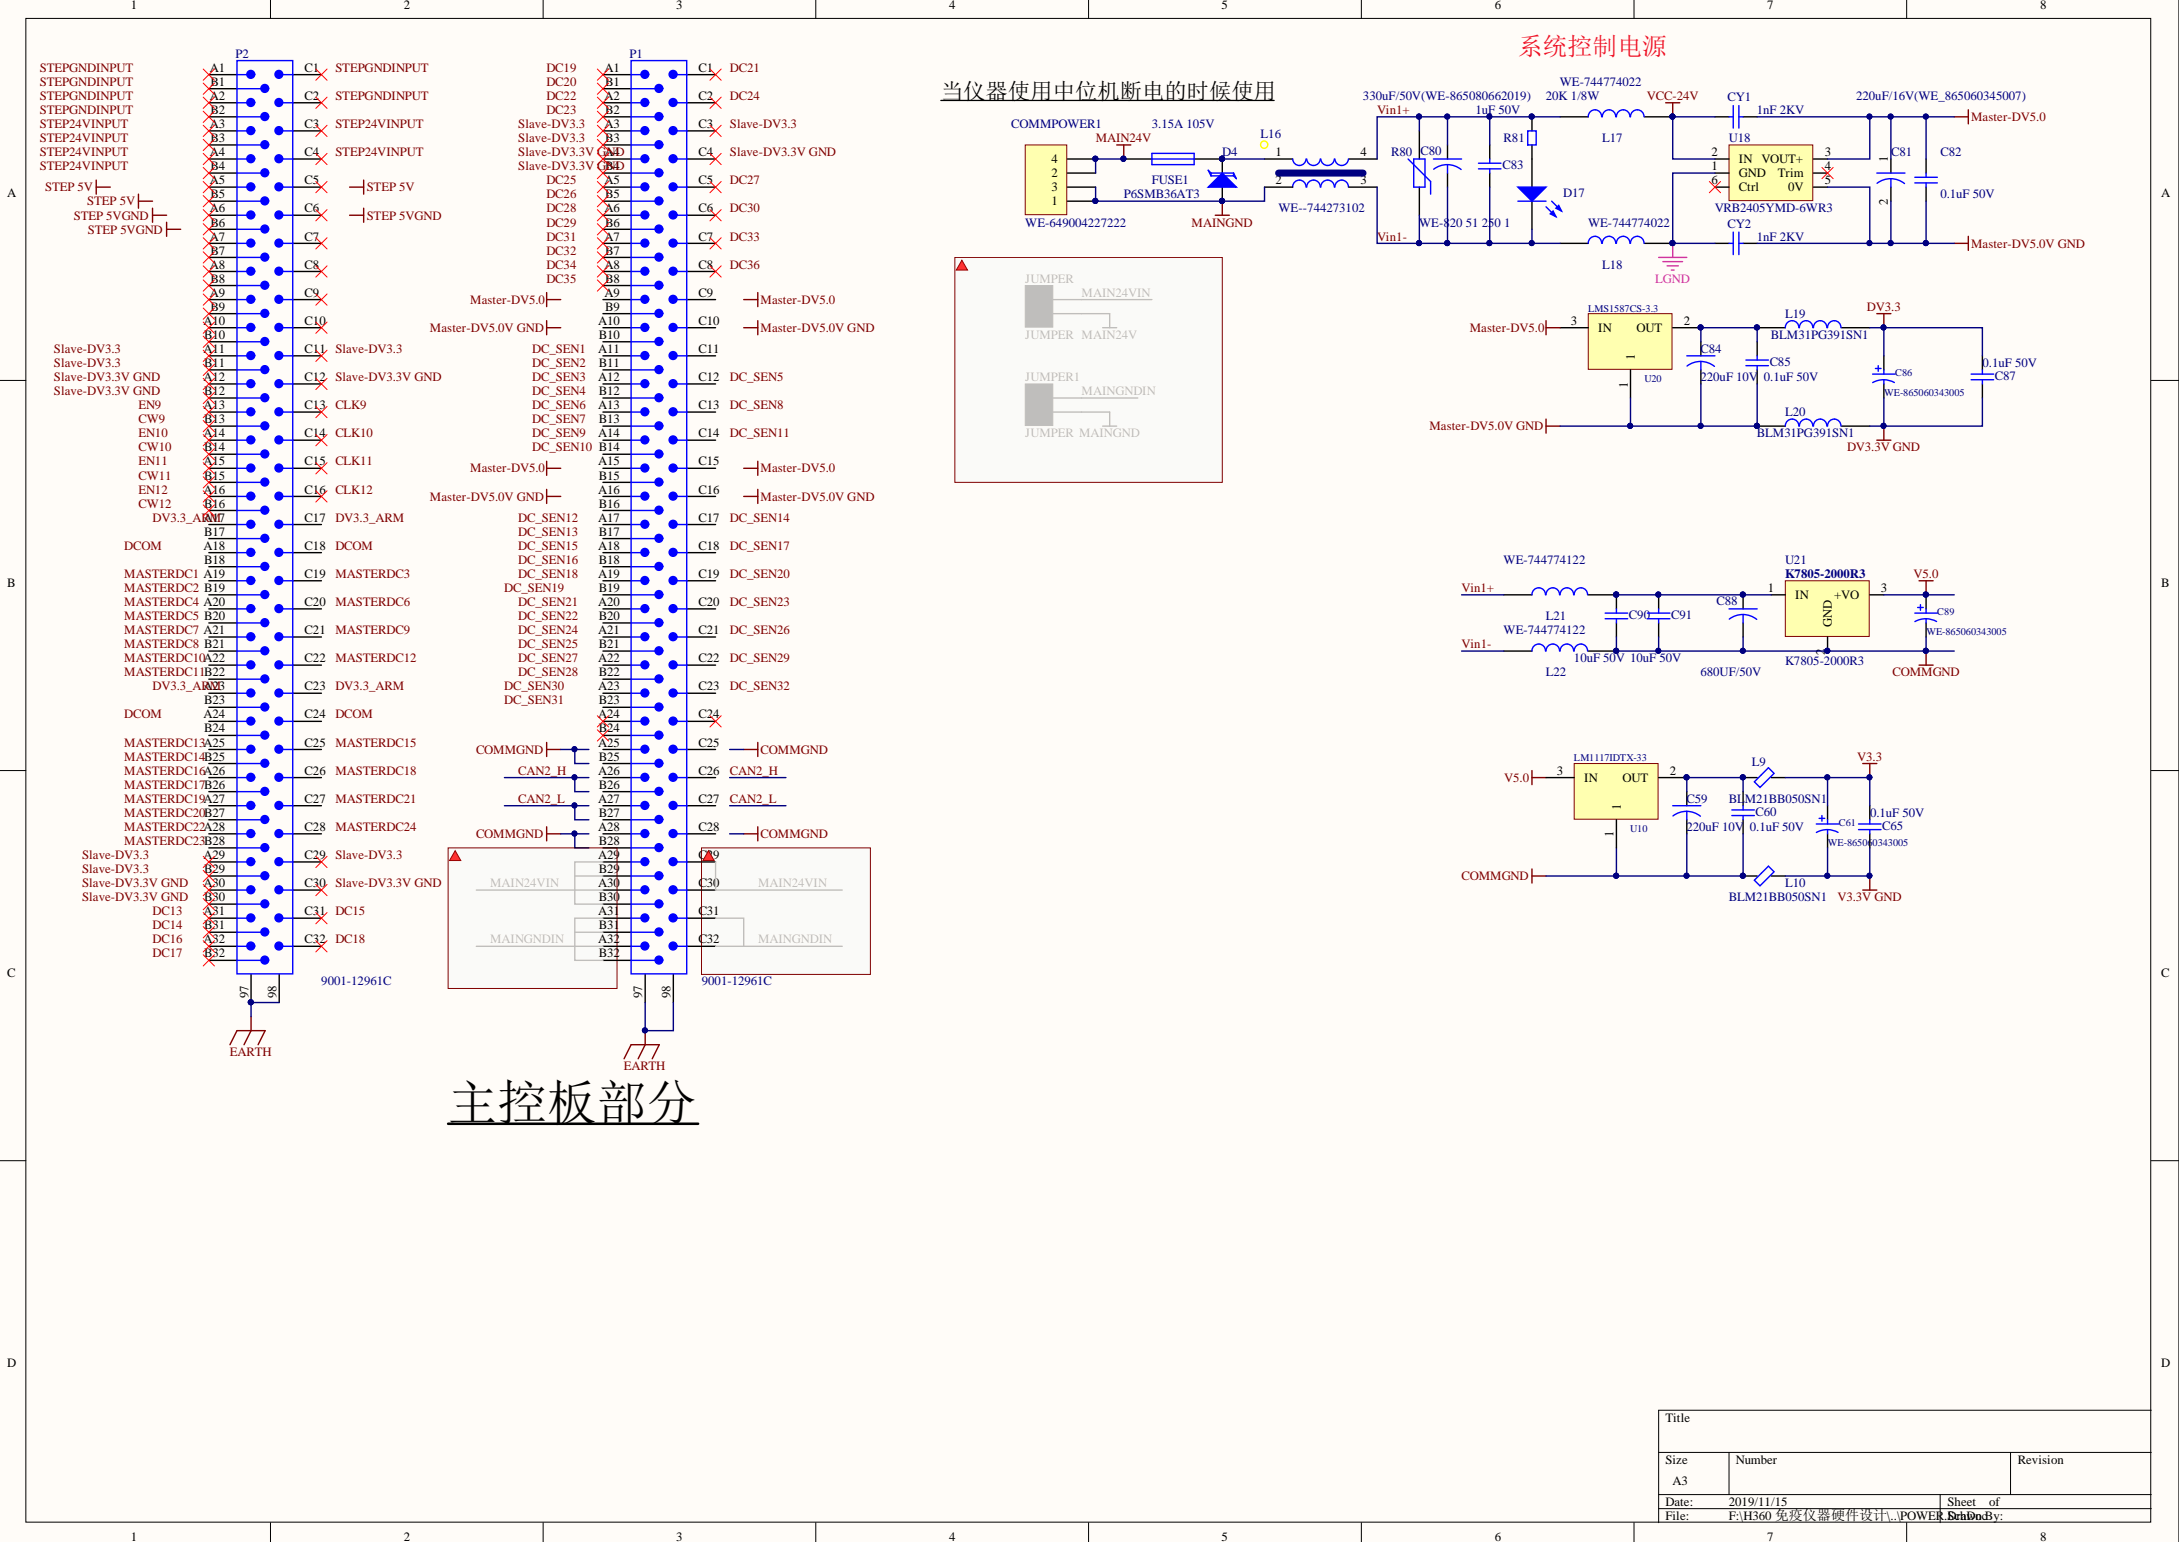

Title		
Size	Number	Revision
A3		
Date:	2019/11/15	Sheet of
File:	F:\H360 免疫仪器硬件设计\POWER SchDocBy:	

