Guide de coupe générique : modèle paramétrique (schéma, non à l'échelle)

Les cotes en symboles sont des PARAMÈTRES modifiables (onglet CORA, étape 12) ; les cotes « = … » DÉCOULENT de l'os segmenté et sont recalculées pour chaque scanner. Cas : tibia, deux apex, θ1 = 10,1°, θ2 = 14,1°.

A · Coupe dans le plan d'une fente

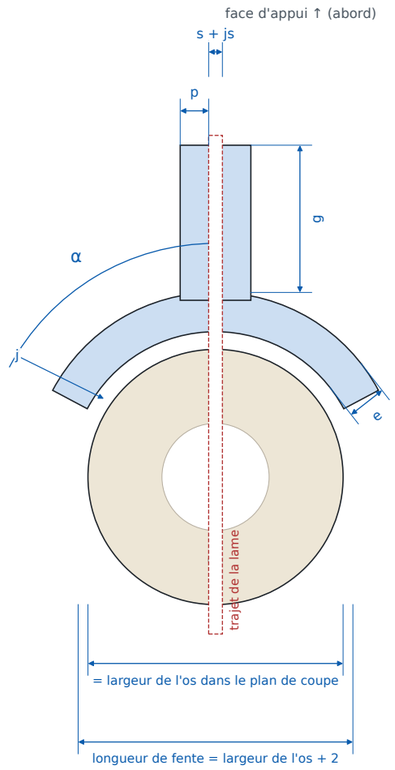

B · Vue de la face d'appui (coin de fermeture)

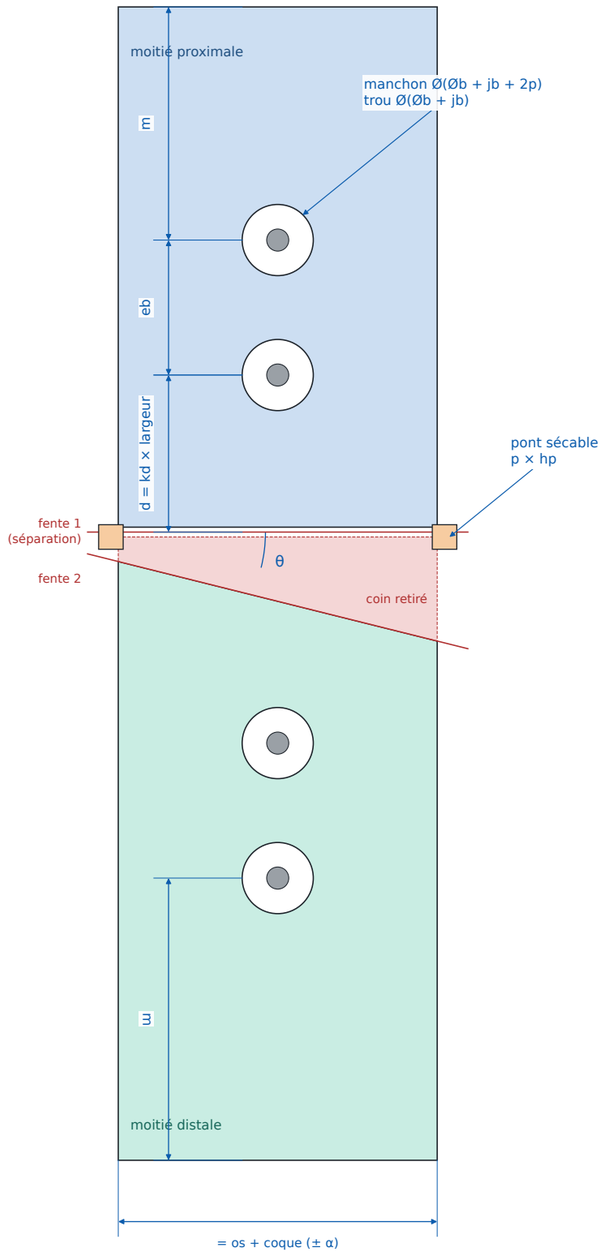

C · Manchon (coupe)

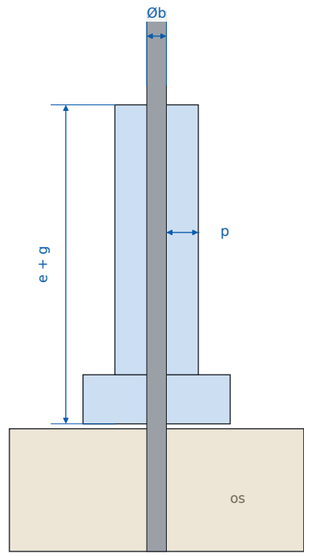

Paramètres du guide générique

sym.	description	défaut	ce cas	
j	jeu entre l'os et la coque	0,30	0,30	mm
e	épaisseur de la coque	3,0	3,0	mm
α	demi-ouverture de la coque autour de la face d'appui	75,0	75,0	°
δ	dépouille (pose et retrait sans contre-dépouille)	5,0	5,0	°
m	coque au-delà des broches extrêmes	8,0	8,0	mm
r	rayon des congés	0,80	0,80	mm
g	hauteur de guidage au-dessus de la coque	10,0	10,0	mm
p	paroi des tours et des manchons	2,0	2,0	mm
s	épaisseur de la lame de scie	0,60	0,60	mm
js	jeu de la fente	0,20	0,20	mm
Øb	diamètre des broches	1,6	1,6	mm
jb	jeu du manchon	0,20	0,20	mm
hp	hauteur des ponts sécables	5,0	5,0	mm
eb	écart entre 2 broches d'un fragment (planif.)	10,0	10,0	mm
kd	distance broche–coupe / largeur de l'os (planif.)	1,2	1,2	×
jv	distance minimale aux os voisins	1,00	1,00	mm
mc	écart supplémentaire au cartilage	1,0	1,0	mm
er	réduction : barre → os	4,0	4,0	mm
lr	réduction : longueur des manchons	12,0	12,0	mm
tb	réduction : épaisseur de la barre	6,0	6,0	mm

Dimensions qui découlent de l'os (ce cas, mm)

dimension	valeur
fente(s)	21,8 × 0,80 ; 21,6 × 0,80
tour (hauteur)	17,1 ; 17,1
manchon Ø ext. / trou	5,80 / 1,80
coque (longueur)	72,9
angle entre fentes	10,1°
broches → coupe	1-P1 18,0 ; 1-P2 28,0 ; 1-D1 18,0 ; 1-D2 28,0
encombrement	74,0 × 33,6 × 22,6

Formules : longueur de fente = largeur de l'os + 2 ; hauteur de tour = os + j + e + g ; épaisseur de tour = s + js + 2p ; manchon Ø = Øb + jb + 2p ; d = kd × largeur de l'os ; coque = de (broche la plus proximale − m) à (la plus distale + m), à ≥ 10 mm des extrémités articulaires ; ponts = p × hp ; ◄ : valeur changée pour ce cas.

CT-CORA3D, étape 7 (dessin_guide.py) — 16/10/2026 15:54 — prototype de recherche, non validé cliniquement.