

Guide de coupe 1 sur 2 (site proximal) : plan coté

Tibia · coin de fermeture · θ = 10,1° · cotes en mm · échelle 1:1 sur A3 · traits mixtes = axes des broches, tirets rouges = plans de coupe


A · depuis la face d'appui

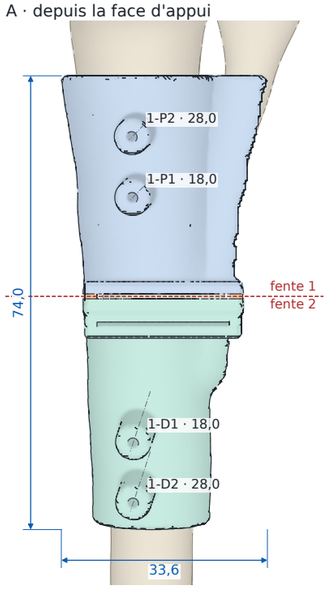

B · de profil

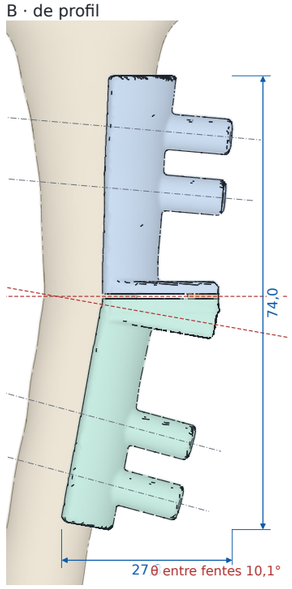

C · axiale (depuis proximal)



Dimensions de ce guide (mm)

élément	valeur
fente 1	21,8 × 0,80 ; tour 17,1 ; lame 26,4 jusqu'à la charnière, 28,4 coupe complète
fente 2	21,6 × 0,80 ; tour 17,1 ; lame 26,2 jusqu'à la charnière, 28,3 coupe complète
manchons	Ø ext. 5,80, trou Ø 1,80
broches	1-P1 à 18,0 de la coupe (manchon 13,3) ; 1-P2 à 28,0 de la coupe (manchon 13,3) ; 1-D1 à 18,0 de la coupe (manchon 13,3) ; 1-D2 à 28,0 de la coupe (manchon 13,3)
écart broches	proximal 10,0 ; distal 10,0
coque	longueur 72,9 ; e = 3,0 ; j = 0,30 ; ± 75°
ponts	2 × 2,0 × 5,0
guide de coupe	74,0 × 33,6 × 22,6 (axe de l'os × largeur × hauteur)

Notes : mode opératoire

- Distances des broches : depuis le plan de coupe de leur fragment (P : fente 1 ; D : dernière fente).
1. Abord médial : exposer l'os sur la longueur des deux guides de coupe, en ménageant le périoste du segment intermédiaire (sa vascularisation).
2. Guide de coupe 1 (proximal, coin de fermeture) : le poser (une seule position), forer ses broches 1-P1, 1-P2 puis 1-D1, 1-D2.
3. Guide de coupe 2 (distal, coin d'ouverture) : le poser (une seule position), forer ses broches 2-P1, 2-P2 puis 2-D1, 2-D2.
4. Guide 1, fente 1 : couper jusqu'à la charnière (lame enfoncée de 26.4 mm).
5. Guide 1, fente 2 : couper jusqu'à la charnière (lame enfoncée de 26.2 mm).
6. Guide 2, fente 1 : couper jusqu'à la charnière (lame enfoncée de 25.3 mm).
7. Couper les ponts des deux guides ; retirer chaque moitié le long de ses broches.
8. Retirer le(s) coin(s) osseux.
9. Ostéotomiser la fibula aux niveaux des coupes : intacte, elle empêcherait la correction.
10. Corriger le site distal puis le site proximal jusqu'à ce que les 8 broches soient parallèles.
11. Enfiler le guide de réduction sur les 8 broches jusqu'au contact de ses manchons avec l'os : les trois fragments sont dans la position planifiée.
12. Fixer (une plaque longue sur les trois fragments, ou deux plaques) ; retirer le guide de réduction et les broches.

cote de contrôle : 50 mm de l'objet (50 mm imprimés, échelle 1:1)

Pièce	Guide de coupe patient-spécifique (2 moitiés, 2 ponts sécables) + guide de réduction
Cas	tibia droit · os fictif (modèle)
Correction	fermeture θ = 10,1°, règle 1 de Paley
Stratégie	abord médial ; charnière conservée ; charnière à 2,0 mm ; broches 2+2
Matériau	PA12 (frittage laser) ou résine stérilisable ; régler les jeux sur coupons imprimés
Échelle	1:1 sur A3 · cotes en mm · tolérance d'impression ± 0,1
Généré	CT-CORA3D étape 7 (dessin_guide.py) · 16/10/2026 15:54 · prototype de recherche