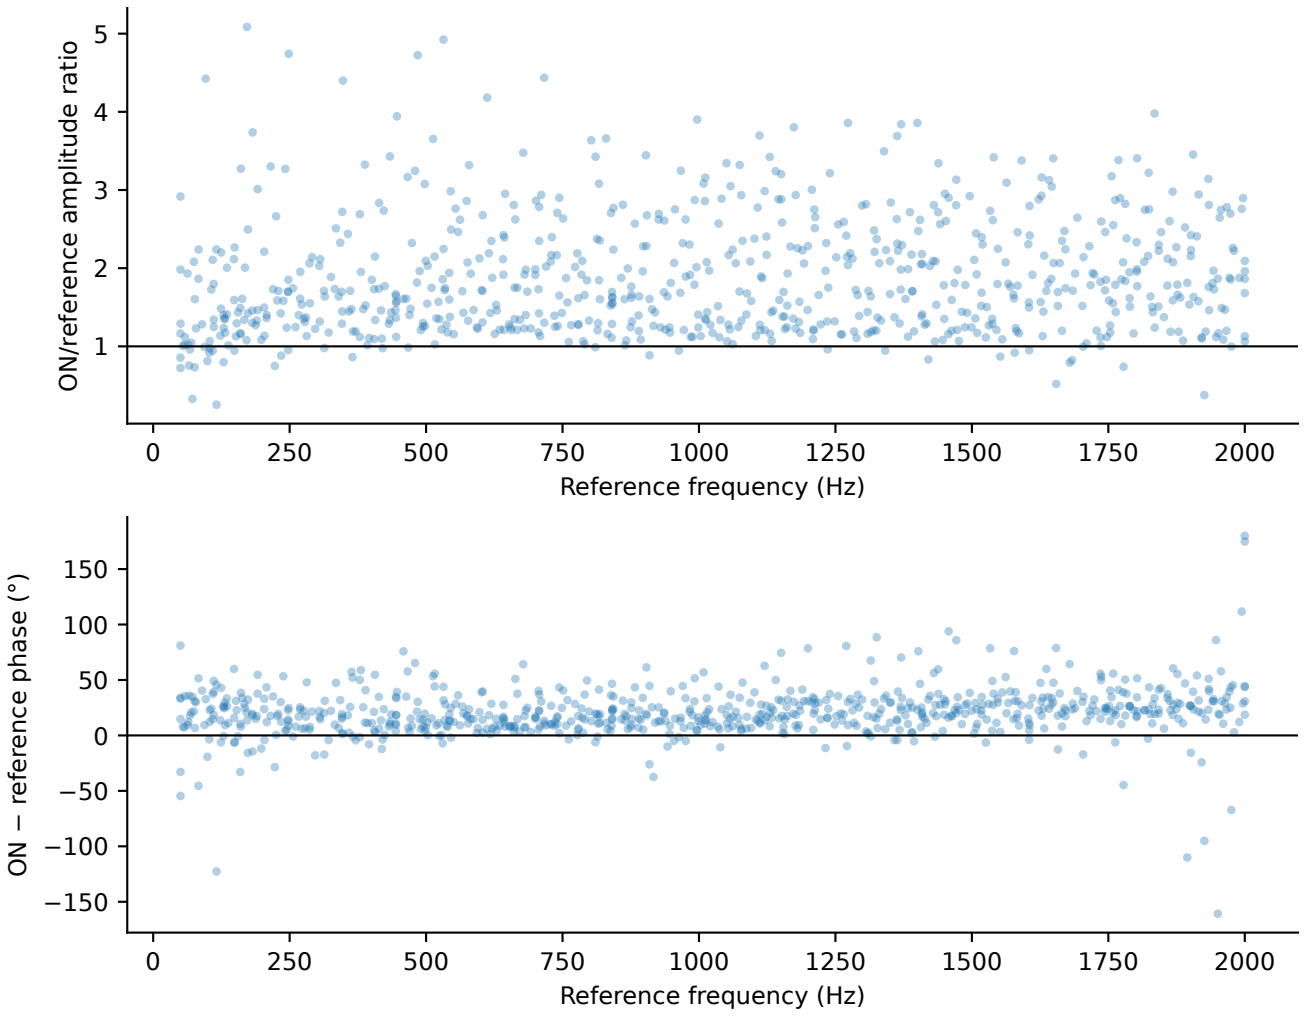
ON/reference amplitude ratio
5
4
3
2
1
0
250
500
750
1000
1250
1500
1750
2000
Reference frequency (Hz)
ON − reference phase (°)
150
100
50
0
−50
−100
−150
0
250
500
750
1000
1250
1500
1750
2000
Reference frequency (Hz)