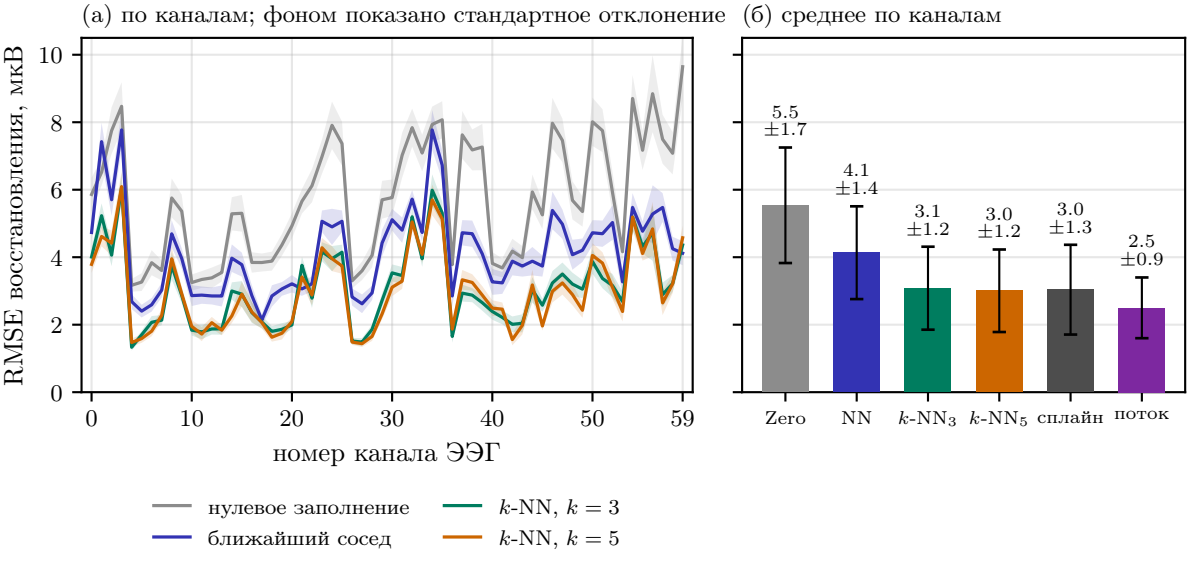

(а) по каналам; фоном показано стандартное отклонение
(б) среднее по каналам
RMSE восстановления, мкВ
номер канала ЭЭГ
нулевое заполнение
ближайший сосед
k-NN, k = 3
k-NN, k = 5
5.5 ±1.7
4.1 ±1.4
3.1 ±1.2
3.0 ±1.2
3.0 ±1.3
2.5 ±0.9
Zero
NN
k-NN3
k-NN5
сплайн
поток