Mécanisme d'entraînement — InfuPro 300

Vue en coupe schématique. Le moteur entraîne l'arbre à came par un réducteur ; la came déplace les doigts qui pincent la tubulure.

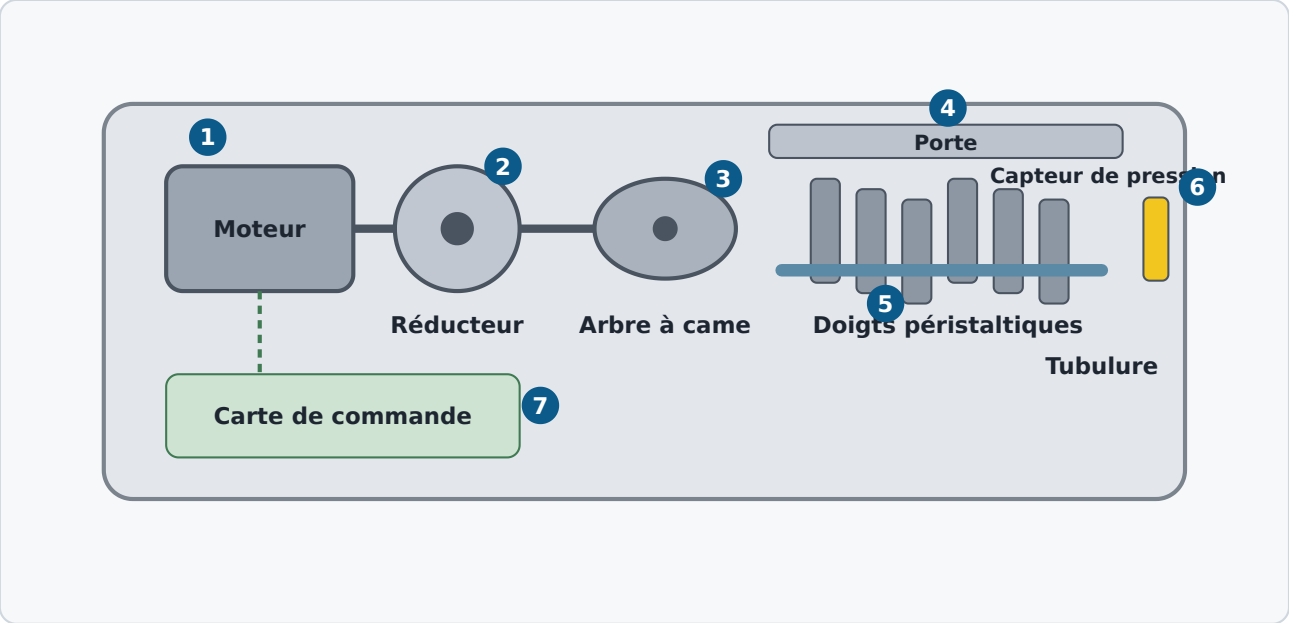


Figure 1 — Coupe schématique du mécanisme d'entraînement

Principe de fonctionnement

1. Le moteur pas à pas tourne selon la consigne de la carte de commande.
2. Le réducteur adapte la vitesse et le couple.
3. L'arbre à came déplace les doigts successivement.
4. Les doigts pincent puis relâchent la tubulure : le liquide avance.
5. Le capteur de pression surveille la pression de ligne.

> **Attention.** Le mécanisme est un sous-ensemble fermé : toute intervention interne est réservée à l'atelier.

Détail came et doigts — légende

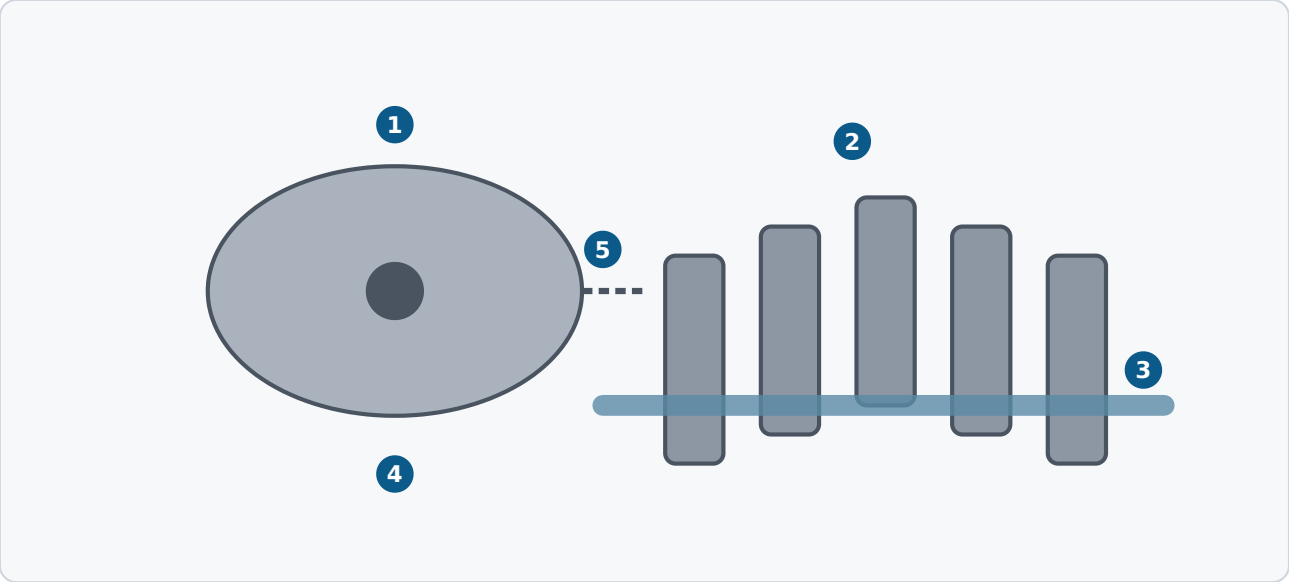


Figure 2 — Détail : came (1), doigts (2), tubulure (3), axe (4), liaison réducteur (5)

Légende de la figure 1

Repère	Élément
1	Moteur pas à pas
2	Réducteur
3	Arbre à came
4	Porte
5	Doigts péristaltiques
6	Capteur de pression de ligne
7	Carte de commande

Points de contrôle de l'atelier

Élément	Contrôle	Fréquence
Doigts	usure, jeu	annuelle
Came	état de surface	annuelle
Réducteur	bruit, jeu	annuelle
Capteur de pression	propreté de l'alvéole	à chaque visite