Nettoyage des capteurs — VitaScan M200 et M400

Cette procédure concerne le capteur SpO2, le câble patient ECG et, sur le M400 uniquement, la sonde de température.

Principes

- Nettoyer après chaque utilisation, accessoire débranché de l'appareil.
- Ne jamais immerger les connecteurs.
- Utiliser une lingette alcoolisée (isopropanol 70 %) ou une solution d'ammonium quaternaire diluée.
- Laisser sécher complètement avant rebranchement.

> **Attention.** Un accessoire fissuré ou dont la gaine est abîmée n'est pas nettoyé : il est remplacé.

Produits

Produit	Usage	Remarque
Lingette isopropanol 70 %	surfaces des accessoires	essuyer, laisser sécher
Ammonium quaternaire dilué	désinfection	respecter la dilution
Chiffon non pelucheux	essuyage	propre et sec

À éviter

- Javel concentrée.
- Solvants.
- Immersion des connecteurs.
- Autoclave.

Repérage des éléments

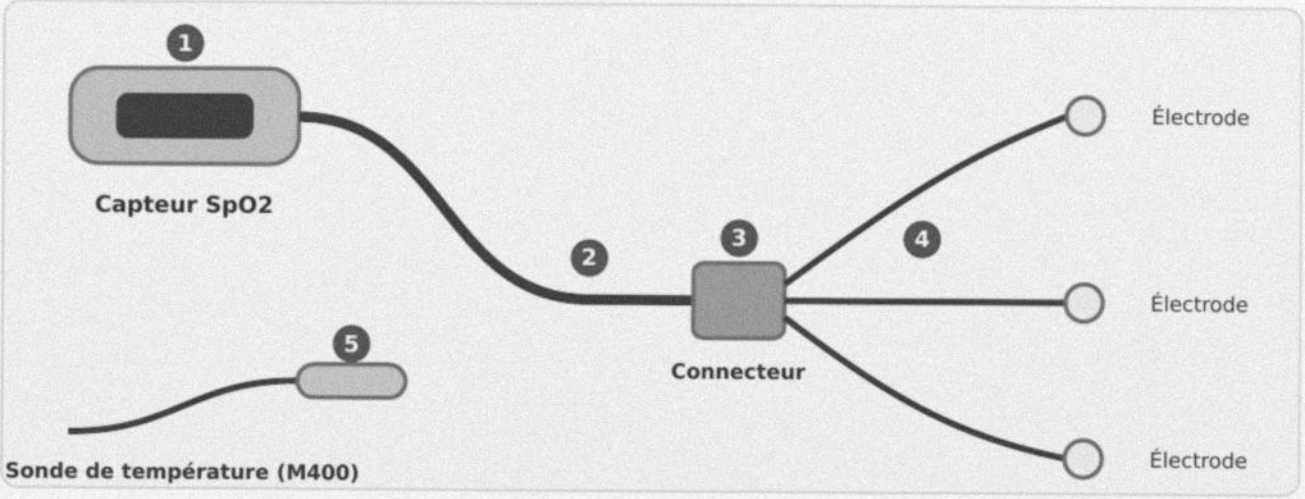


Figure 1 — Capteur SpO2 (1), câble (2), connecteur (3), fils ECG (4), sonde de température du M400 (5)

Le connecteur (3) ne se nettoie qu'à la lingette, sans humidifier les broches.

Points de contrôle

- Le capteur SpO2 : fenêtre optique propre et sans rayure.
- Le câble : gaine intacte, pas de pli marqué.
- Le connecteur : broches propres et droites.

Procédure par accessoire

Accessoire	Modèle	Méthode	Fréquence
Capteur SpO2	M200, M400	lingette sur la partie en contact et sur le câble	après chaque utilisation
Câble patient ECG	M200, M400	chiffon humidifié, du connecteur vers l'extrémité	après chaque utilisation
Sonde de température	M400	lingette sur la sonde, sans plier le câble	après chaque utilisation

Après nettoyage

1. Contrôler visuellement la gaine et les connecteurs.
2. Rebrancher et vérifier que l'appareil détecte l'accessoire.
3. Consigner tout accessoire écarté.

Contrôle du câble

Étape	Critère
Inspection de la gaine	pas de coupure ni d'écrasement
Flexion douce	pas de point dur ni de fil apparent
Connecteur	broches droites, sans oxydation

Consignation

Information	Où la noter
Accessoire écarté	registre de maintenance
Date du nettoyage approfondi	étiquette de l'accessoire
Anomalie	ticket de maintenance

> **Attention.** Un accessoire douteux est remplacé plutôt que réparé.