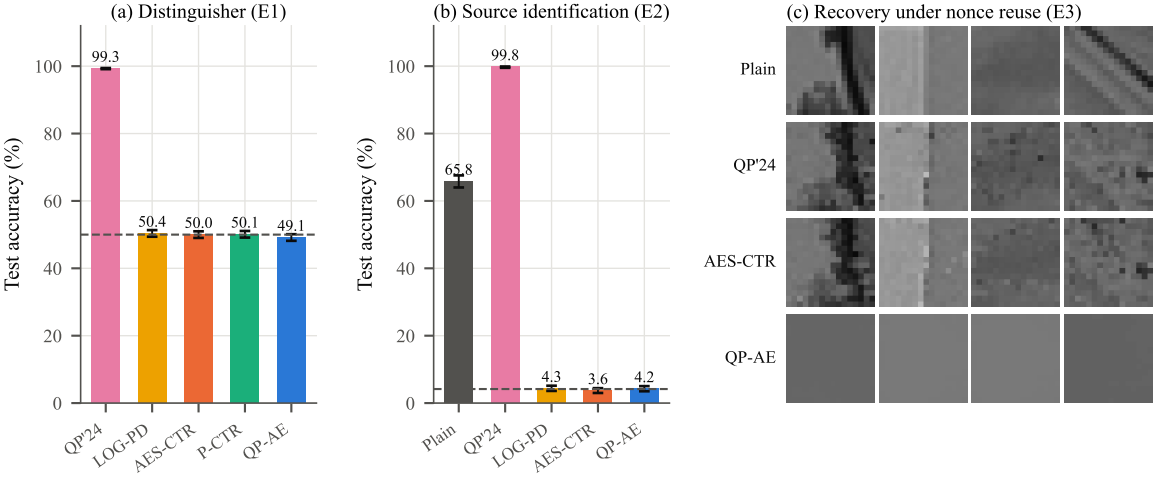
(a) Distinguisher (E1)
Test accuracy (%)
0
20
40
60
80
100
99.3
50.4
50.0
50.1
49.1
QP'24
LOG-PD
AES-CTR
P-CTR
QP-AE
(b) Source identification (E2)
Test accuracy (%)
0
20
40
60
80
100
65.8
99.8
4.3
3.6
4.2
Plain
QP'24
LOG-PD
AES-CTR
QP-AE
(c) Recovery under nonce reuse (E3)
Plain
QP'24
AES-CTR
QP-AE