

CÓDIGO	REVISÃO	DATA
FRGH.049		

REGISTRO DE INVESTIGAÇÃO DE PRODUTO

Caso algum campo não seja aplicável, preencha com N/A.

1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

Produto:	HealthGo Air
Data:	22/05/2026
Número de Série / Lote:	202507180005
HGID:	25071832
Cliente (caso aplicável):	Porto Servicos Medicos E Ultrassom / Cristina Melo Rocha

2. INFORMAÇÕES DO PROBLEMA

PROBLEMA RELATADO PELO CLIENTE:

Análise de calibração, valores basais elevados de H2.

PROBLEMA CONSTATADO PELO SUPORTE:

Falha de calibração

3. ANÁLISE TÉCNICA INTERNA

RESULTADO DA INVESTIGAÇÃO:


MAE muito alta. Taxa de elevação de H2 muito grande em relação ao valor predicto. Necessário uma SVM e acompanhar funcionamento. Se não solucionar, abrir requerimento de substituição.

OBSERVAÇÕES:

GoPremium: NÃO

CÓDIGO	REVISÃO	DATA
FRGH.049		

4. EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA

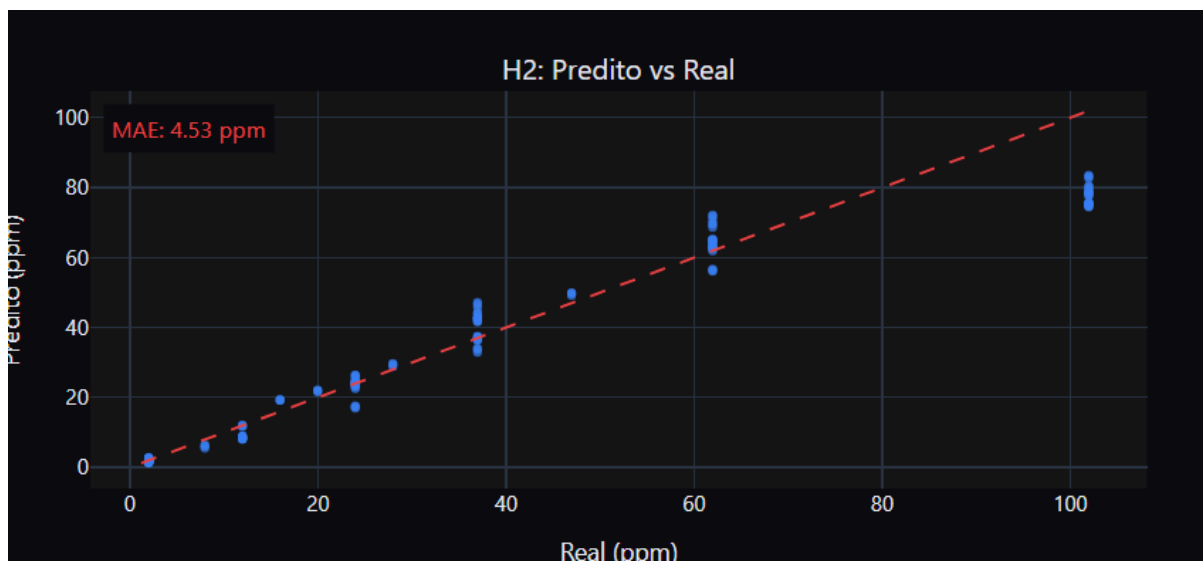


5. DISPOSIÇÃO FINAL

- X Recolhimento do produto
- Atualização de firmware
- Recalibração Remota

CÓDIGO	REVISÃO	DATA
FRGH.049		

ASSINATURA

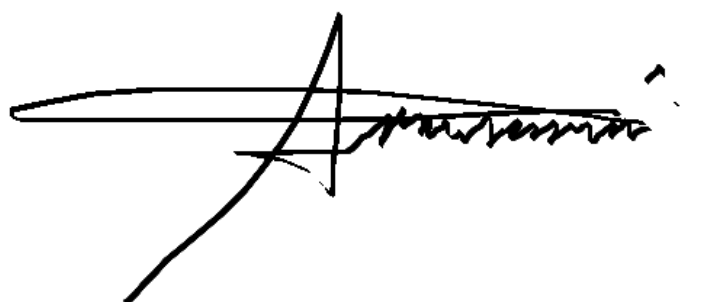A handwritten signature in black ink, appearing to read 'André Luiz de Souza', is written over a horizontal line within a rectangular box.

Analista responsável: André Luiz de Souza