

CÓDIGO	REVISÃO	DATA
FRGH.049		

REGISTRO DE INVESTIGAÇÃO DE PRODUTO

Caso algum campo não seja aplicável, preencha com N/A.

1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

Produto:	HealthGo Air
Data:	01/04/2026
Número de Série / Lote:	202511240003
HGID:	25101707
Cliente (caso aplicável):	Dalva Maria Alcantara (Gastrocentro)

2. INFORMAÇÕES DO PROBLEMA

PROBLEMA RELATADO PELO CLIENTE:

Solicitante entrou em contato informando que o equipamento não está emitindo sons e que os valores estavam se repetindo.

PROBLEMA CONSTATADO PELO SUPORTE:

Equipamento com falha no funcionamento das bombas e válvulas

3. ANÁLISE TÉCNICA INTERNA

RESULTADO DA INVESTIGAÇÃO:

Realizada atualizações de firmware e acompanhamentos. Os valores se mantiveram constantes em vários pacientes, H2 = CH4.
Foi identificado que o equipamento não realiza limpezas automáticas no qual o mesmo não realiza nenhum barulho! Nem ao ligar e desligar ou ao atualizar o firmware. Problema na bomba.
Em contato com a engenharia, foi solicitado o recolhimento.

OBSERVAÇÕES:

N/A

4. EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA

N/A

CÓDIGO	REVISÃO	DATA
FRGH.049		

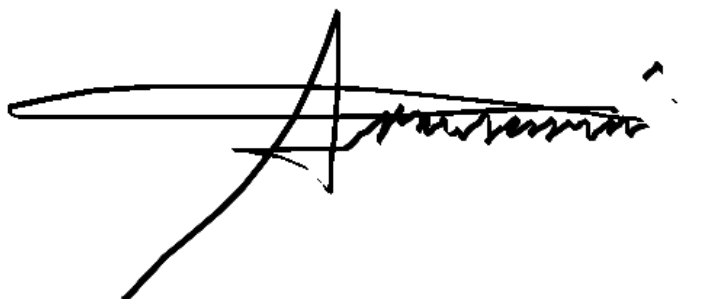
5. DISPOSIÇÃO FINAL

X Recolhimento do produto

Atualização de firmware

Recalibração Remota

ASSINATURA

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'A' followed by a series of loops and a long horizontal stroke.

CÓDIGO	REVISÃO	DATA
FRGH.049		

Analista responsável: André Luiz de Souza