

CÓDIGO	REVISÃO	DATA
FRGH.049		

REGISTRO DE INVESTIGAÇÃO DE PRODUTO

Caso algum campo não seja aplicável, preencha com N/A.

1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

Produto:	HealthGo Air
Data:	24/03/2026
Número de Série / Lote:	202509100003
HGID:	25082508
Cliente (caso aplicável):	Lorena Sagrilo Auer

2. INFORMAÇÕES DO PROBLEMA

PROBLEMA RELATADO PELO CLIENTE:

Aparelho está com os valores das amostras coletadas fora da conformidade.

PROBLEMA CONSTATADO PELO SUPORTE:

O aparelho está dando valores repetidos para todos os pacientes, uma flatline traça o gráfico apresentando sinal de descalibração

3. ANÁLISE TÉCNICA INTERNA

RESULTADO DA INVESTIGAÇÃO:

Após análise investigativa, o aparelho consta com os offsets de sensores TGS2600, TGS2611 fora dos parâmetros esperados de calibração, bem como mal aquecimento no momento da calibração na fábrica e mal comportamento dos sensores. Foi realizada uma SVM para correção dos aspectos e não solucionou o erro apresentado durante os testes. Recomendo recolhimento do equipamento para calibração na fábrica.

OBSERVAÇÕES:

Equipamento foi recolhido para calibração de 1 ano/250 exames realizados e retornou a médica ruim.

4. EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA

N/A

CÓDIGO	REVISÃO	DATA
FRGH.049		

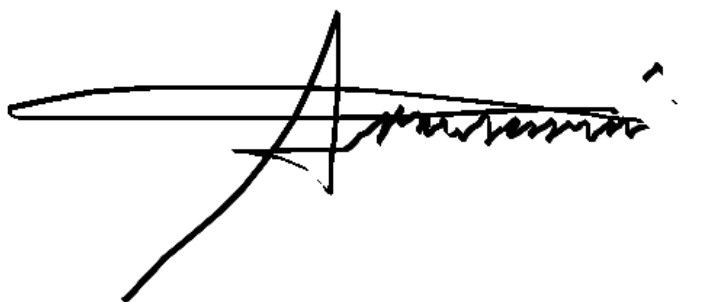
5. DISPOSIÇÃO FINAL

X Recolhimento do produto

Atualização de firmware

Recalibração Remota

ASSINATURA

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'A' followed by a series of cursive letters, likely 'MARTINS'.

CÓDIGO	REVISÃO	DATA
FRGH.049		

Analista responsável: André Luiz de Souza