

CÓDIGO	REVISÃO	DATA
FRGH.049		

REGISTRO DE INVESTIGAÇÃO DE PRODUTO

Caso algum campo não seja aplicável, preencha com N/A.

1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

Produto:	HealthGo Air
Data:	26/05/2026
Número de Série / Lote:	202506240009
HGID:	25062522
Cliente (caso aplicável):	Paula Silveira

2. INFORMAÇÕES DO PROBLEMA

PROBLEMA RELATADO PELO CLIENTE:

Equipamento não reconhecido no Software.

PROBLEMA CONSTATADO PELO SUPORTE:

Atualização de software e firmware realizadas, verificada especificações do computador que se encontra dentro do padrão.

3. ANÁLISE TÉCNICA INTERNA

RESULTADO DA INVESTIGAÇÃO:

Observações: Sensores 00 e 03 se encontram fora das métricas.

As conexões foram freqüentes no dia 13/05, sendo necessárias realizar SVM mais de 4 vezes.

Nos últimos 15 dias ocorreram outras vezes.

Diante do ocorrido e por estar próximo de vencer a garantia indico recolhimento para manutenção e calibração.

OBSERVAÇÕES:

GoPremium: NÃO

4. EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA

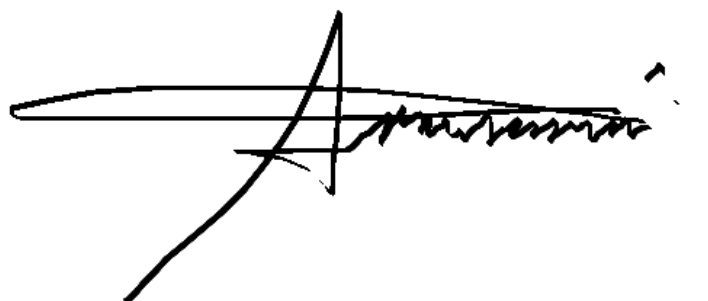
N/A

CÓDIGO	REVISÃO	DATA
FRGH.049		

5. DISPOSIÇÃO FINAL

- X Recolhimento do produto
- Atualização de firmware
- Recalibração Remota

ASSINATURA

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'A' followed by a series of horizontal strokes and a small flourish at the end.

CÓDIGO	REVISÃO	DATA
FRGH.049		

Analista responsável: André Luiz de Souza