

CÓDIGO	REVISÃO	DATA
FRGH.049		

REGISTRO DE INVESTIGAÇÃO DE PRODUTO

Caso algum campo não seja aplicável, preencha com N/A.

1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

Produto:	HealthGo Air
Data:	06/05/2026
Número de Série / Lote:	202510130004
HGID:	25092606
Cliente (caso aplicável):	RITA DE CÁSSIA SILVA

2. INFORMAÇÕES DO PROBLEMA

PROBLEMA RELATADO PELO CLIENTE:
Descreve basais elevados para H2 e não elevação de H2 após ingestão de substrato.
PROBLEMA CONSTATADO PELO SUPORTE:
Problema na calibração

3. ANÁLISE TÉCNICA INTERNA

RESULTADO DA INVESTIGAÇÃO:
No Studio as métricas se mostram em conformidade em todos os sensores.
Ao analisar os exames da médica podemos observar basais <10, esses se deram depois de protocolos de caminhada e repetir o enxaguante.
Padrão linear recorrente, sem elevação esperada.
Realizada uma SVM no dia 30/04 para que pudéssemos acompanhar se há melhora nos basais e curvas.
Na data de hoje a médica relatou que continua com basais elevados em 3 pacientes, todos acima de 40 PPM, a dieta foi realizada por 48 horas + Jejum dentro do esperado.
Foi realizada investigação do POP e não foi encontrado nenhum desvio no cuidado do equipamento.
OBSERVAÇÕES:
GoPremium: NÃO

CÓDIGO	REVISÃO	DATA
FRGH.049		

4. EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA

N/A

5. DISPOSIÇÃO FINAL

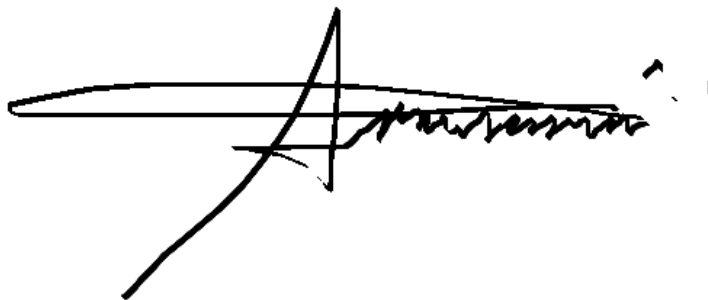
X Recolhimento do produto

Atualização de firmware

Recalibração Remota

CÓDIGO	REVISÃO	DATA
FRGH.049		

ASSINATURA

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'André Luiz de Souza', is written over a horizontal line within a rectangular box.

Analista responsável: André Luiz de Souza