

CÓDIGO	REVISÃO	DATA
FRGH.049		

REGISTRO DE INVESTIGAÇÃO DE PRODUTO

Caso algum campo não seja aplicável, preencha com N/A.

1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

Produto:	HealthGo Air
Data:	22/05/2026
Número de Série / Lote:	202603090008
HGID:	26031905
Cliente (caso aplicável):	RESPIRAR CLINICA DO APARELHO RESPIRATORIO SIMPLES PURA / Cliente: Rafaela Muniz

2. INFORMAÇÕES DO PROBLEMA

PROBLEMA RELATADO PELO CLIENTE:

Dra. entrou em contato informando que todos os pacientes, inclusive o exame dela própria (totalmente assintomática) vieram com metano basal maior que 10 ppm. Dra. realizou a compra do equipamento ano passado e faz 1 mês que encontra-se com o equipamento.

PROBLEMA CONSTATADO PELO SUPORTE:

Falha de calibração

3. ANÁLISE TÉCNICA INTERNA

RESULTADO DA INVESTIGAÇÃO:

Em análise observei que apesar da baixa variação média de valores de CH₄, o equipamento está dando valores bem fora do ideal previsto. Recomendo subir uma SVM para tentativa de correção e acompanhar os exames. Se continuar, solicitar à engenharia uma SVM com correção no offset do TGS2611.

Vamos pedir substituição desse equipamento. Diria para fazer régua de comunicação. Ligar para a cliente de preferência

OBSERVAÇÕES:

GoPremium: NÃO

CÓDIGO	REVISÃO	DATA
FRGH.049		

4. EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA



Amós Nunes sex. 16:54

👤 Você

Cliente: Rafaela Muniz
RESPIRAR CLINICA DO APARELHO RESPIRATORIO SIMPLES PURA
GO Premium: Básico...

 26031905_healthgo_atualizado...

Vamos pedir substituição desse equipamento. Diria para fazer régua de comunicação. Ligar para a cliente de preferência

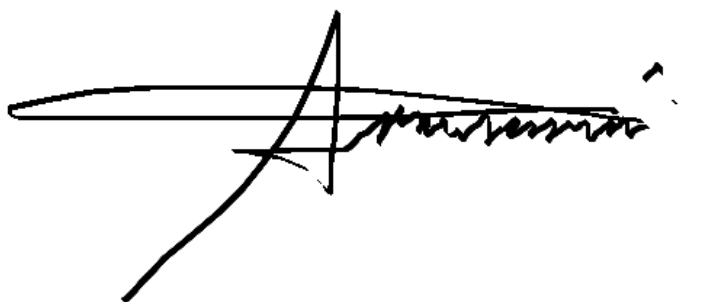
👤 1 resposta sex. 16:58

5. DISPOSIÇÃO FINAL

- X Recolhimento do produto
- Atualização de firmware
- Recalibração Remota

CÓDIGO	REVISÃO	DATA
FRGH.049		

ASSINATURA

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'André Luiz de Souza', is written over a horizontal line within a rectangular box.

Analista responsável: André Luiz de Souza