

CÓDIGO	REVISÃO	DATA
FRGH.049		

REGISTRO DE INVESTIGAÇÃO DE PRODUTO

Caso algum campo não seja aplicável, preencha com N/A.

1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

Produto:	HealthGo Air
Data:	29/04/2026
Número de Série / Lote:	202603030002
HGID:	26030503
Cliente (caso aplicável):	Sarah Branco Ribeiro

2. INFORMAÇÕES DO PROBLEMA

PROBLEMA RELATADO PELO CLIENTE:
Aponta que todos os basais de H2 se apresentam elevados e todos os pacientes positivam para CH4.
PROBLEMA CONSTATADO PELO SUPORTE:
Falha de calibração

3. ANÁLISE TÉCNICA INTERNA

RESULTADO DA INVESTIGAÇÃO:
Analizando no Studio, as métricas do sensor 00 se encontram acima do padrão da calibração, Já foi realizada algumas SVM conforme disponibilidade do Studio nas últimas semanas onde não se mostrou melhoras nas amostras apresentadas.
Em todos os exames realizados nas últimas duas semanas, os valores para CH4 se mostraram >10 PPM.
A engenharia visualizou um comportamento estranho nos sensores, sugerindo o recolhimento para calibração do equipamento na fábrica.
OBSERVAÇÕES:
GoPremium: NÃO

4. EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA

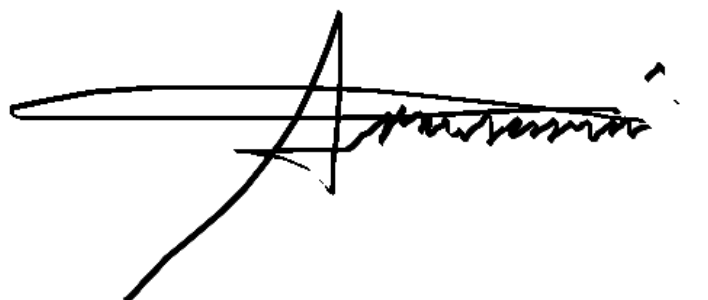
N/A

CÓDIGO	REVISÃO	DATA
FRGH.049		

5. DISPOSIÇÃO FINAL

- X Recolhimento do produto
- Atualização de firmware
- Recalibração Remota

ASSINATURA

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'A' followed by a series of cursive letters, likely 'MARTINHO'.

CÓDIGO	REVISÃO	DATA
FRGH.049		

Analista responsável: André Luiz de Souza