



Relatório de Teste: Software 1.5.0

NOTA

Projeto: [Software V. 1.5.0]
Data de Execução: 2026-04-22
Versão/Build: 1.5.0
Tester Responsável: [André Souza]



Funções e Atribuições do Tester

Checklist de Prontidão:

- ☒ ☒ DBeaver configurado e conectado ao banco.
- ☒ ☒ Software 1.5.0 instalado com Terminal Debug habilitado.
- ☒ ☒ Acesso aos logs de erro garantido.

Setor Responsável: Suporte N3



Validação de Infraestrutura



DBeaver (Banco de Dados SQLite/JSON)

- ☒ ☒ Conexão com o banco estabelecida?
- ☒ ☒ Logs de erro acessíveis via SQL?
- ☒ ☒ Alterações de teste refletidas no banco?



Terminal Debug (Logs em Tempo Real) – Versão de Software testada sem Terminal Debug

- ☒ ☒ Terminal de debug abre ao iniciar o software?
- ☒ ☒ Logs são legíveis e detalhados?
- ☒ ☒ Erros críticos aparecem instantaneamente no console?



Registro de Testes (v1.4.9)

ID	Caso de Teste	Status	Observações / Evidências
01	Inicialização do Software	[X] PASS / [] FAIL	Ok
02	Login e Autenticação	[X] PASS / [] FAIL	Ok
03	Processamento de Dados 1.4.9	[X] PASS / [] FAIL	Ok
04	Estabilidade do Banco (DBeaver)	[X] PASS / [] FAIL	Ok
05	Realização de exames	[] PASS / [X] FAIL	Não apareceram valores de H2S em ppb.

ID	Caso de Teste	Status	Observações / Evidências
06	Alteração de idioma	[] PASS / [X] FAIL	As notas continuam mantendo o idioma original (PTBR)
07	Geração de Laudo	[X] PASS / [] FAIL	Ok
08	Fluidez do Software	[X] PASS / [] FAIL	Ok
09	Laudo em DOC	[X] PASS / [] FAIL	Ok
10	Coleta de sopros simultaneos	[X] PASS / [] FAIL	Fluidez na alteração de tela de exame
11	Crash de desconexão	[X] PASS / [] FAIL	Software permanece aberto
12	Comandos GoStudio	[] PASS / [X] FAIL	Funções inoperantes com o Firmware
13	Alerta pós finalização de exame	[X] PASS / [] FAIL	Ok

 Bug Log (v1.5.0)


[BUG-001] - [Quebra de página no PDF do Laudo]

- **Gravidade:** [Baixa]
- **Descrição:** [A quebra de página permanece com um espaço enorme que não altera, deixando informações quebradas na página 2]
- **Passos:**
 1. Abrir software 1.4.9
 2. [Realizar o exame > Finalizar o exame > Preencher o mínimo de campos necessários > Salvar o laudo > Gerar o PDF]

• **Evidência:**

Tempo (min)	Basal	15	30	45	60	75	90	120
H2 (ppm)	3	3	3	4	5	12	12	23
CH4 (ppm)	3	3	3	2	2	2	2	0

Substrato:
Lactulose

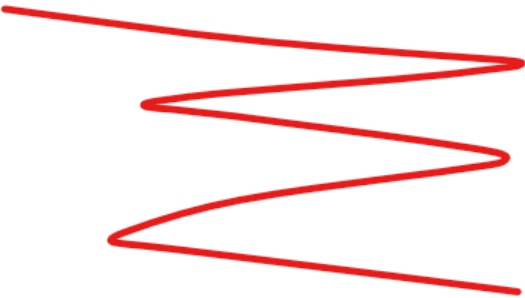

reportado à equipe responsável pela tratativa

Erro

✓ Conclusão e Parecer Técnico

- ☒ ☒ **APTO** para liberação.
- ☐ **NÃO APTO** (Necessita correção urgente).

Comentários Finais:

[A nova versão de software vêm com mais fluidez, menos instabilidades, os bugs anteriores foram corrigidos, porém a função de comando do GoStudio com o aparelho em campo não estão funcionando. Apesar dos erros sinalizados não há necessidade de correção urgente pois não acarreta no funcionamento direto do Software. A torre de analistas responsáveis já está ciente das inconsistências sinalizadas e a nova versão já está apta para liberação.]

Gerado via Suporte N3 Workflow