


	Response	Std	Off rate	Std
#1	4.89	0.0048	2.08e-04	2.93e-06
.				
AIC	-1729.57			

	Response	Std	Off rate	Std
#1	4.41	0.0178	1.21e-05	5.77e-06
#2	0.643	0.0168	5.05e-03	1.47e-04
AIC	-3853.86			


	Response	Std	Off rate	Std
#1	4.4	0.0226	1.05e-05	7.13e-06
#2	0.647	0.02	5.00e-03	1.98e-04
#3	0.00366	0.00636	1.19e-01	4.06e-01
AIC	-3850.21			

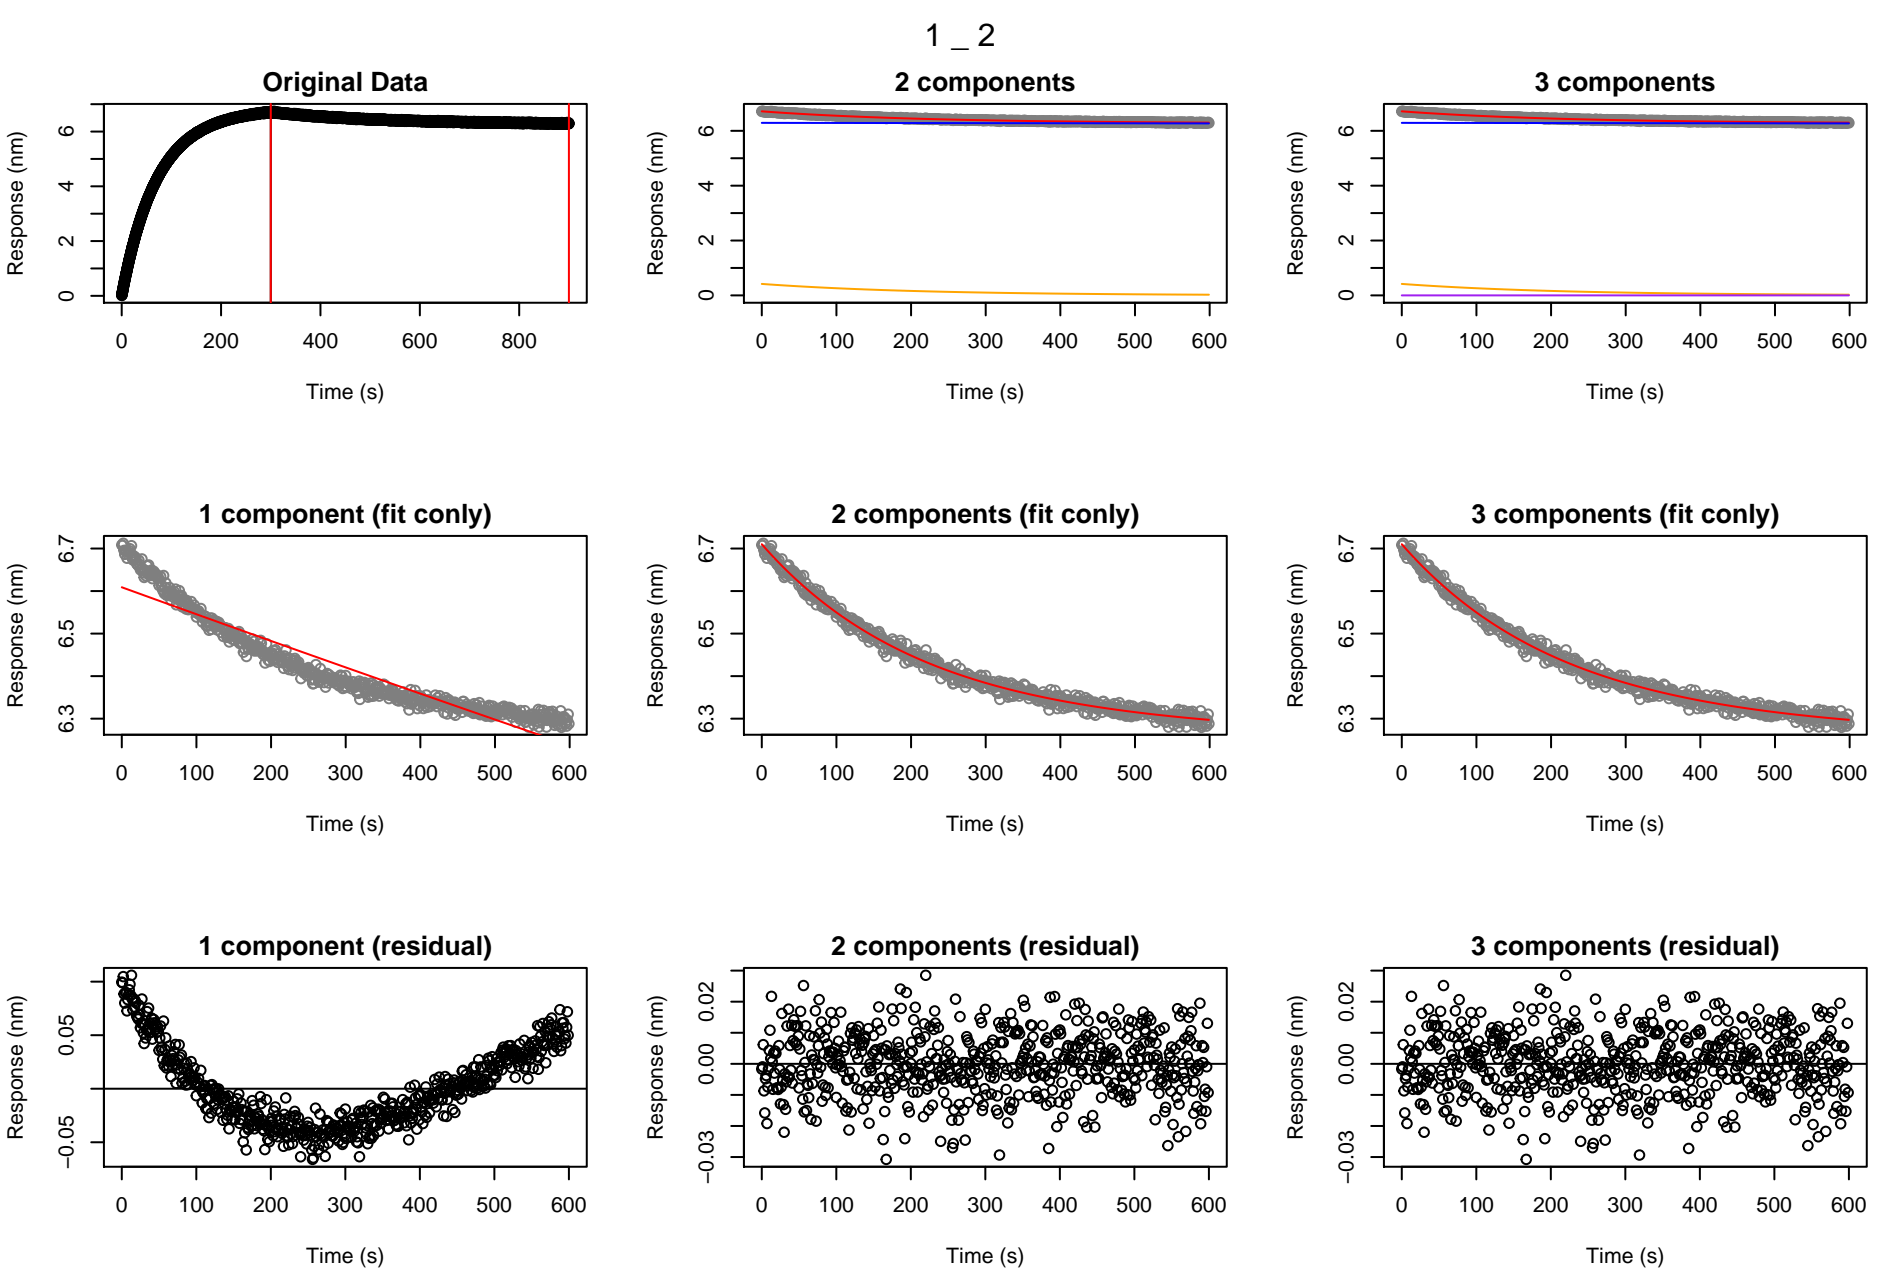

	Response	Std	Off rate	Std
#1	6.61	0.00303	9.64e-05	1.34e-06
.				
AIC	-2263.25			

	Response	Std	Off rate	Std
#1	6.29	0.0215	5.31e-06	4.70e-06
#2	0.418	0.0204	4.72e-03	2.44e-04
AIC	-3817.40			


	Response	Std	Off rate	Std
#1	6.29	0.0219	5.31e-06	4.79e-06
#2	0.418	0.0208	4.72e-03	2.51e-04
#3	5.78e-07	0.0102	1.57e+00	8.01e+04
AIC	-3813.40			

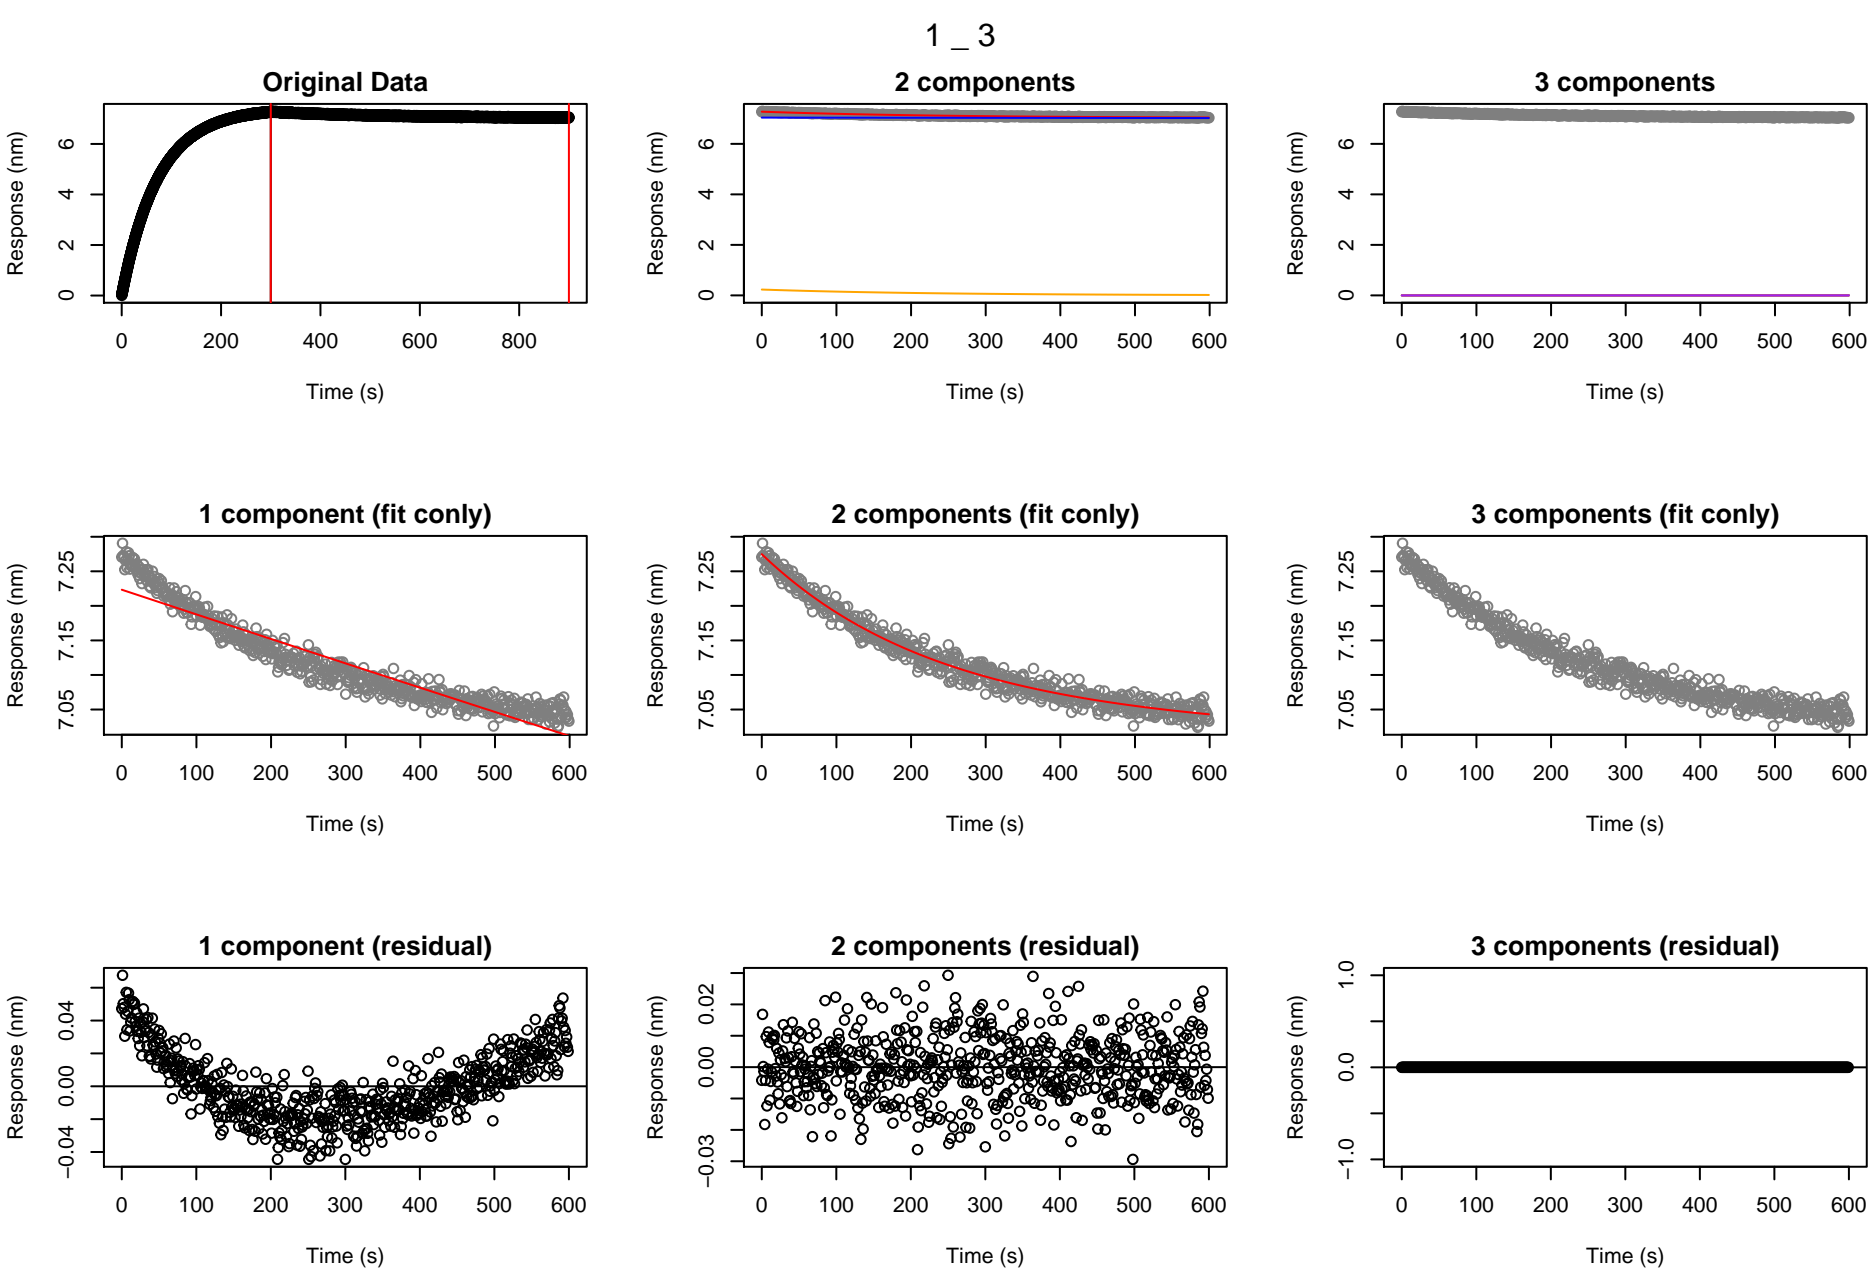

	Response	Std	Off rate	Std
#1	7.22	0.00171	4.96e-05	6.88e-07
.				
AIC	-2942.27			

	Response	Std	Off rate	Std
#1	7.04	0.0263	4.28e-06	4.90e-06
#2	0.231	0.0252	4.35e-03	4.75e-04
AIC	-3808.19			


	Response	Std	Off rate	Std
#1	0	0	1.00e-07	0.00e+00
#2	0	0	1.00e-07	0.00e+00
#3	0	0	1.00e-07	0.00e+00
AIC	0.00			

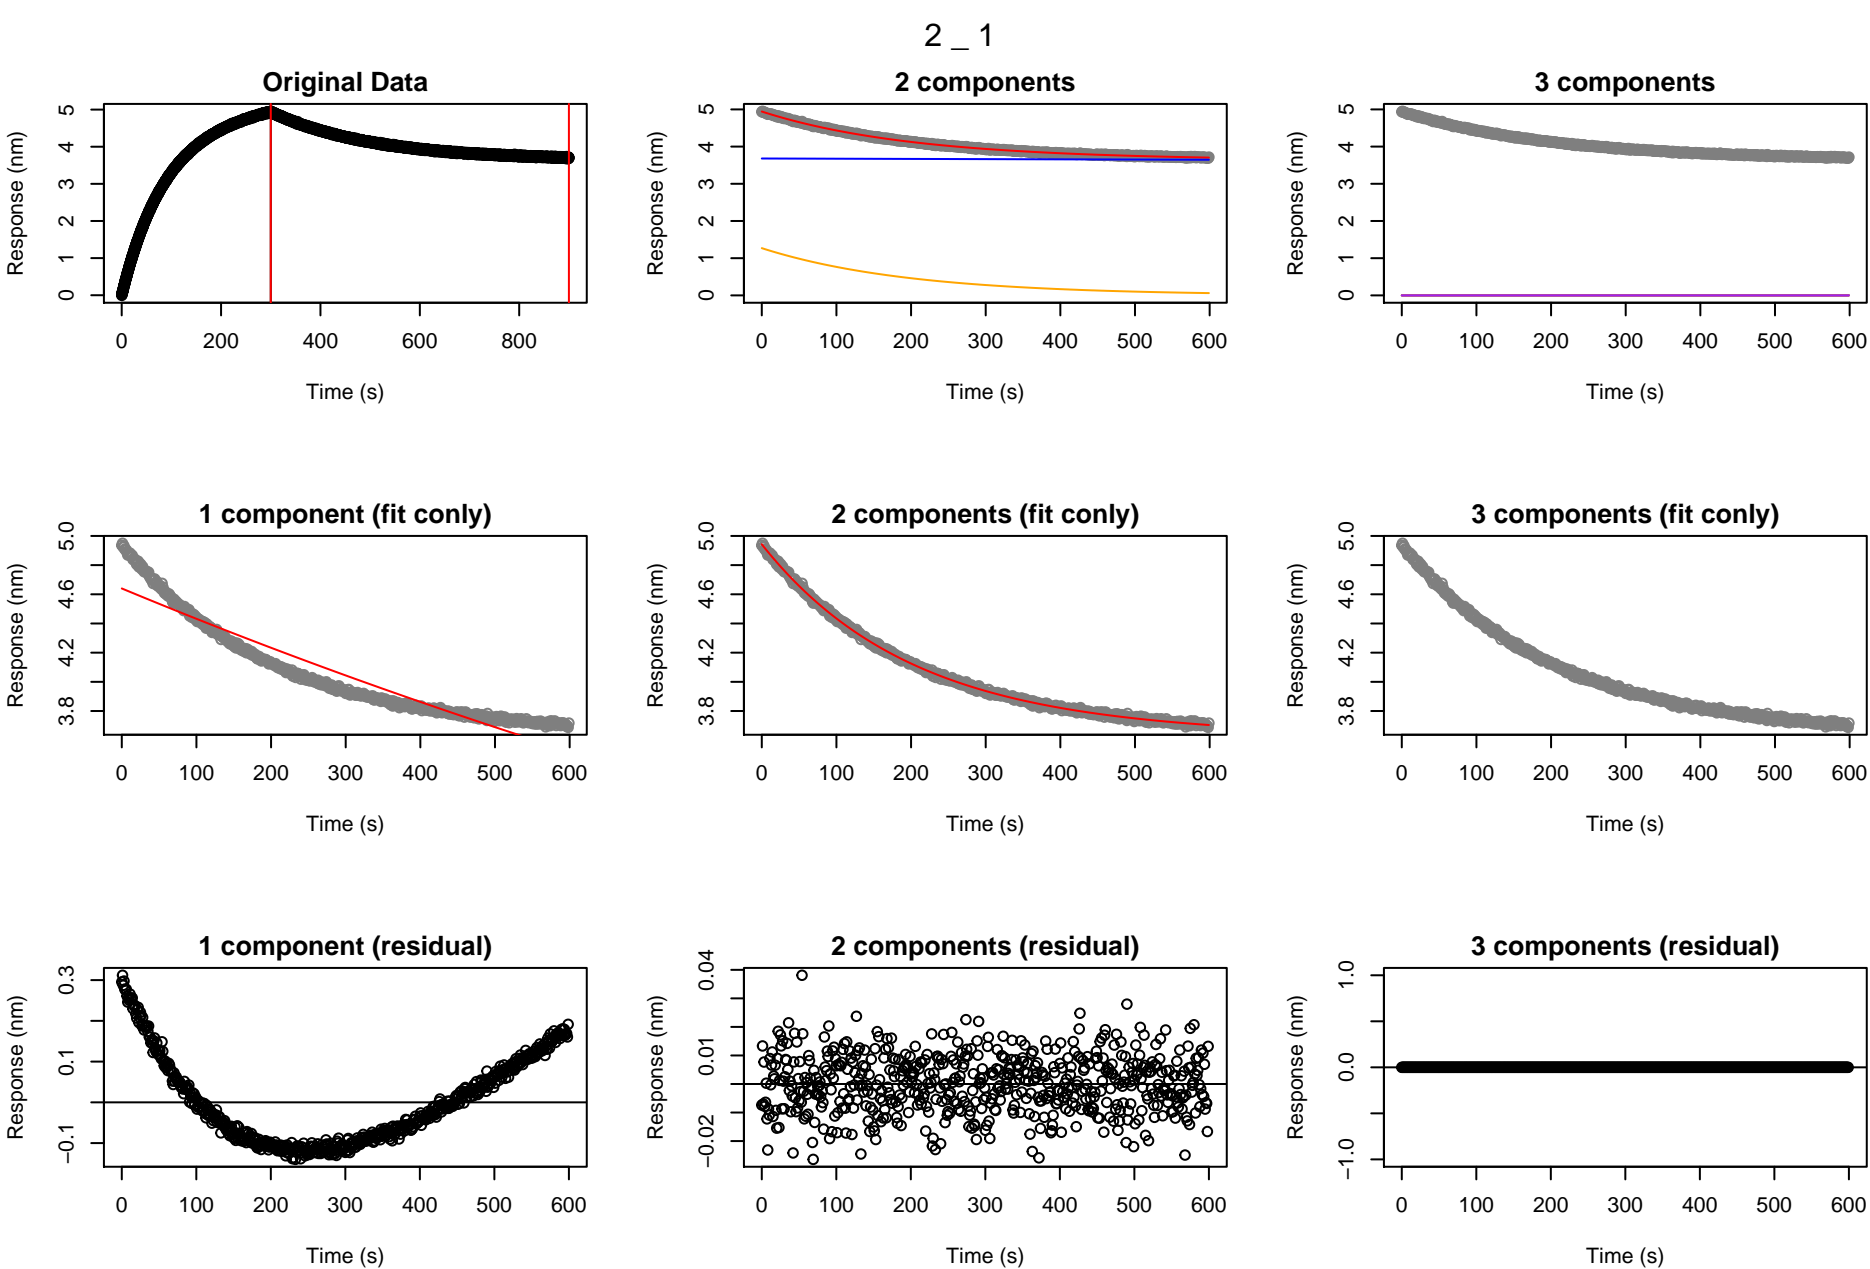

	Response	Std	Off rate	Std
#1	4.64	0.00921	4.58e-04	6.16e-06
.				
AIC	-990.33			

	Response	Std	Off rate	Std
#1	3.68	0.0181	1.53e-05	7.06e-06
#2	1.27	0.0171	5.06e-03	7.63e-05
AIC	-3827.34			


	Response	Std	Off rate	Std
#1	0	0	1.00e-07	0.00e+00
#2	0	0	1.00e-07	0.00e+00
#3	0	0	1.00e-07	0.00e+00
AIC	0.00			

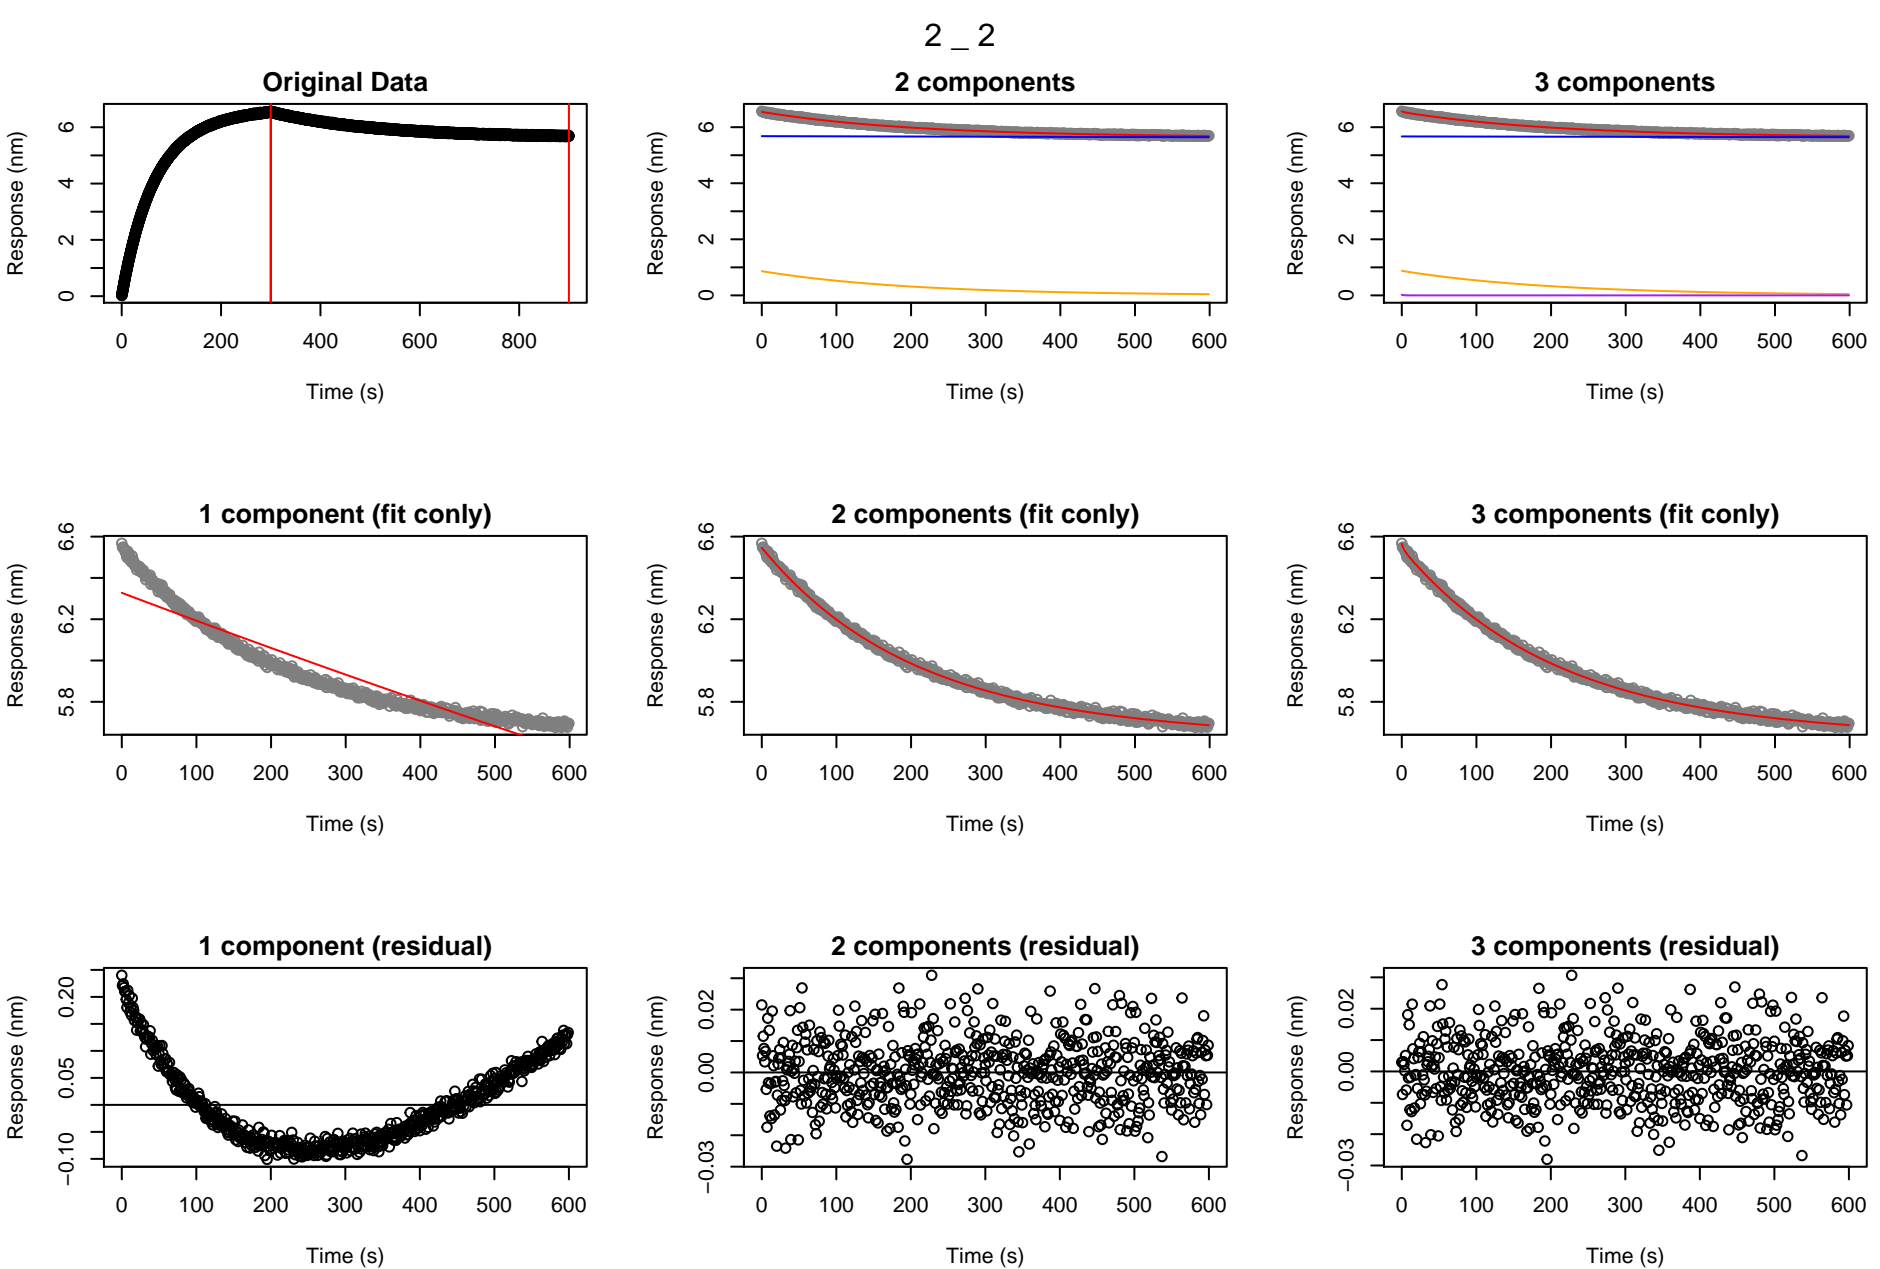

	Response	Std	Off rate	Std
#1	6.33	0.00639	2.16e-04	3.02e-06
#2	0.864	0.0182	5.03e-03	1.17e-04
#3	0.0213	0.00895	3.27e-01	2.52e-01
AIC	-1387.47			

	Response	Std	Off rate	Std
#1	5.68	0.0192	1.11e-05	4.83e-06
#2	0.864	0.0182	5.03e-03	1.17e-04
AIC	-3773.98			


	Response	Std	Off rate	Std
#1	5.67	0.0217	7.66e-06	5.35e-06
#2	0.876	0.0201	4.92e-03	1.30e-04
#3	0.0213	0.00895	3.27e-01	2.52e-01
AIC	-3777.01			

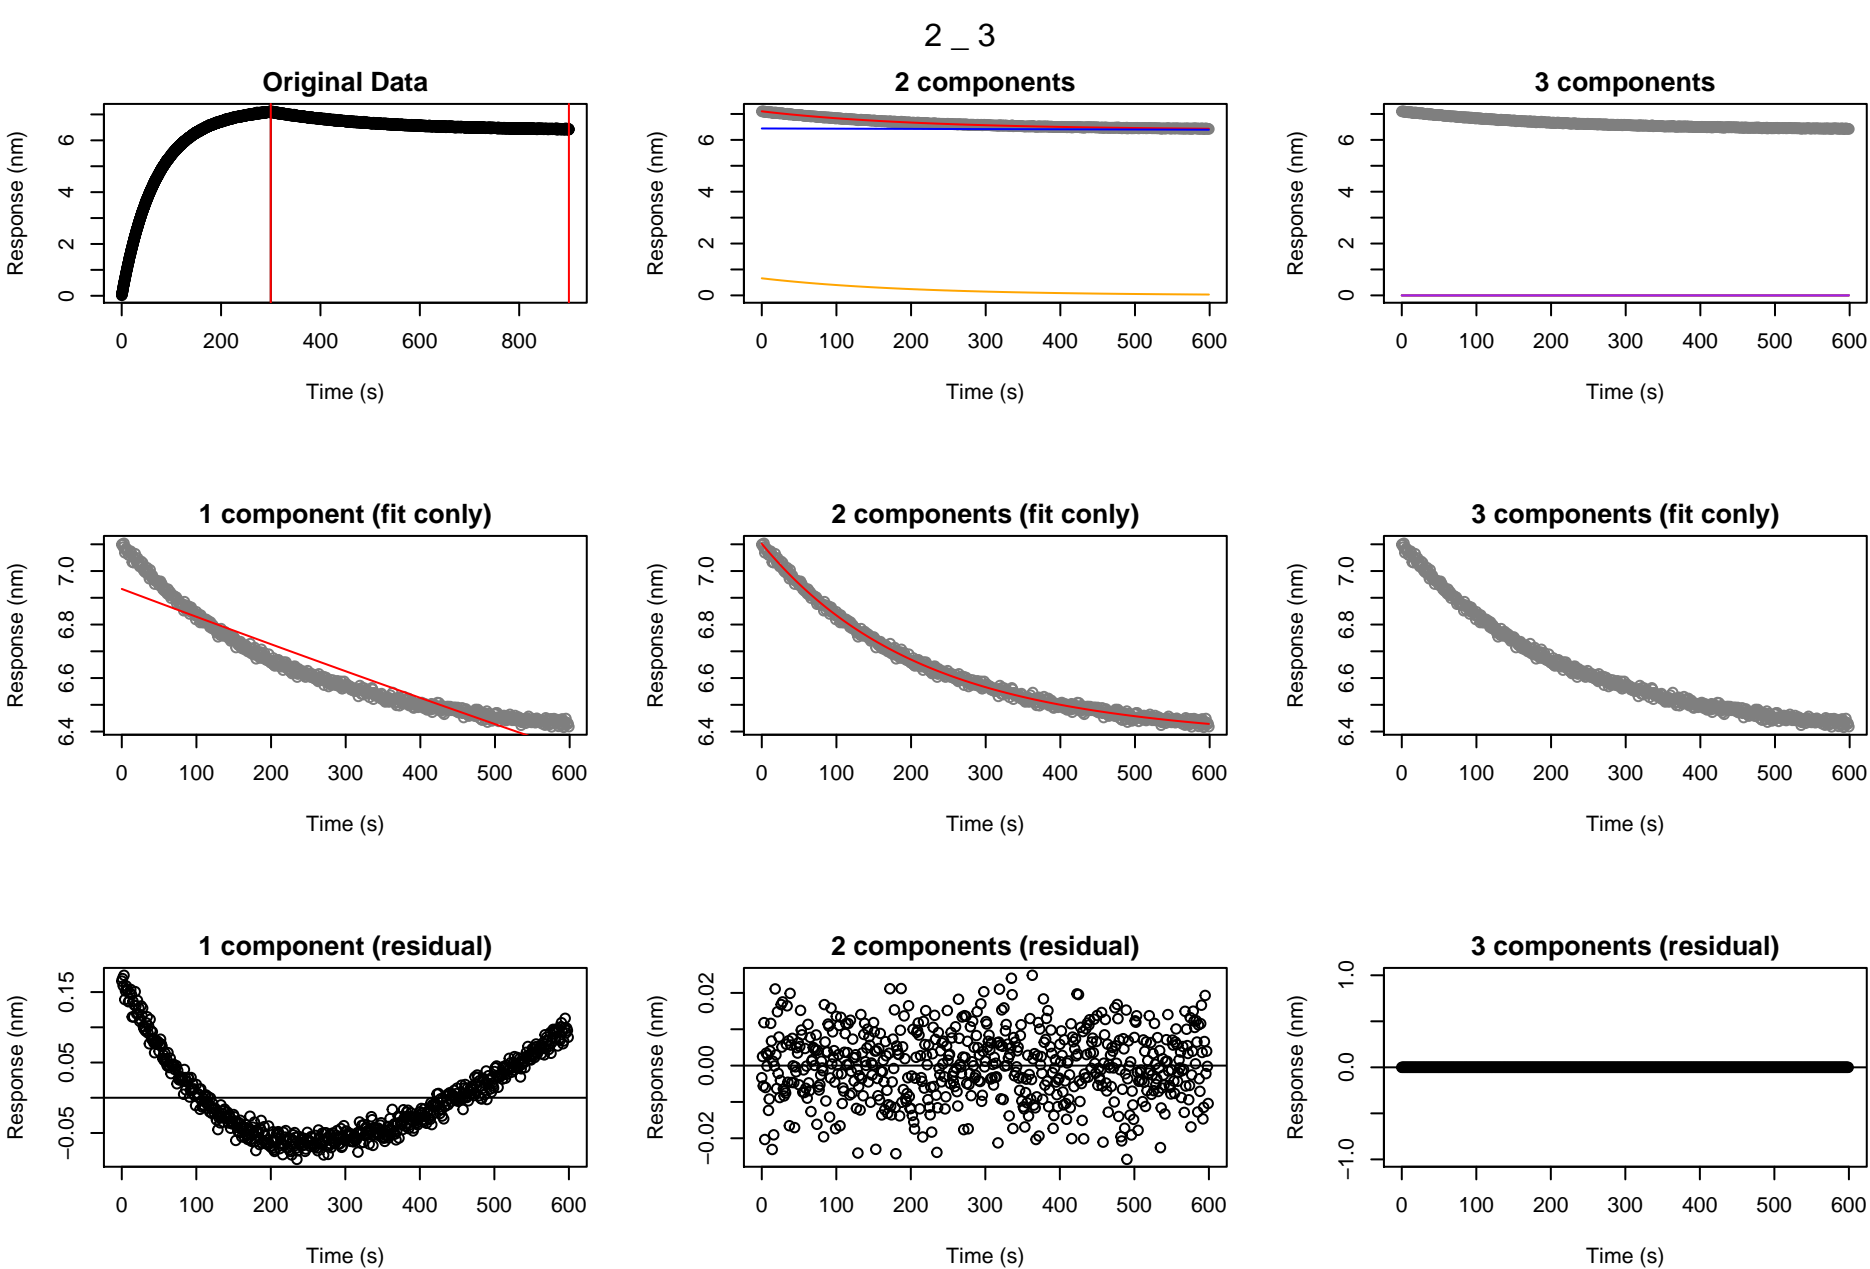

	Response	Std	Off rate	Std
#1	6.93	0.0049	1.51e-04	2.09e-06
.				
A/C	-1694.83			

	Response	Std	Off rate	Std
#1	6.44	0.0177	1.23e-05	3.91e-06
#2	0.659	0.0167	5.02e-03	1.41e-04
A/C	-3879.00			


	Response	Std	Off rate	Std
#1	0	0	1.00e-07	0.00e+00
#2	0	0	1.00e-07	0.00e+00
#3	0	0	1.00e-07	0.00e+00
A/C	0.00			

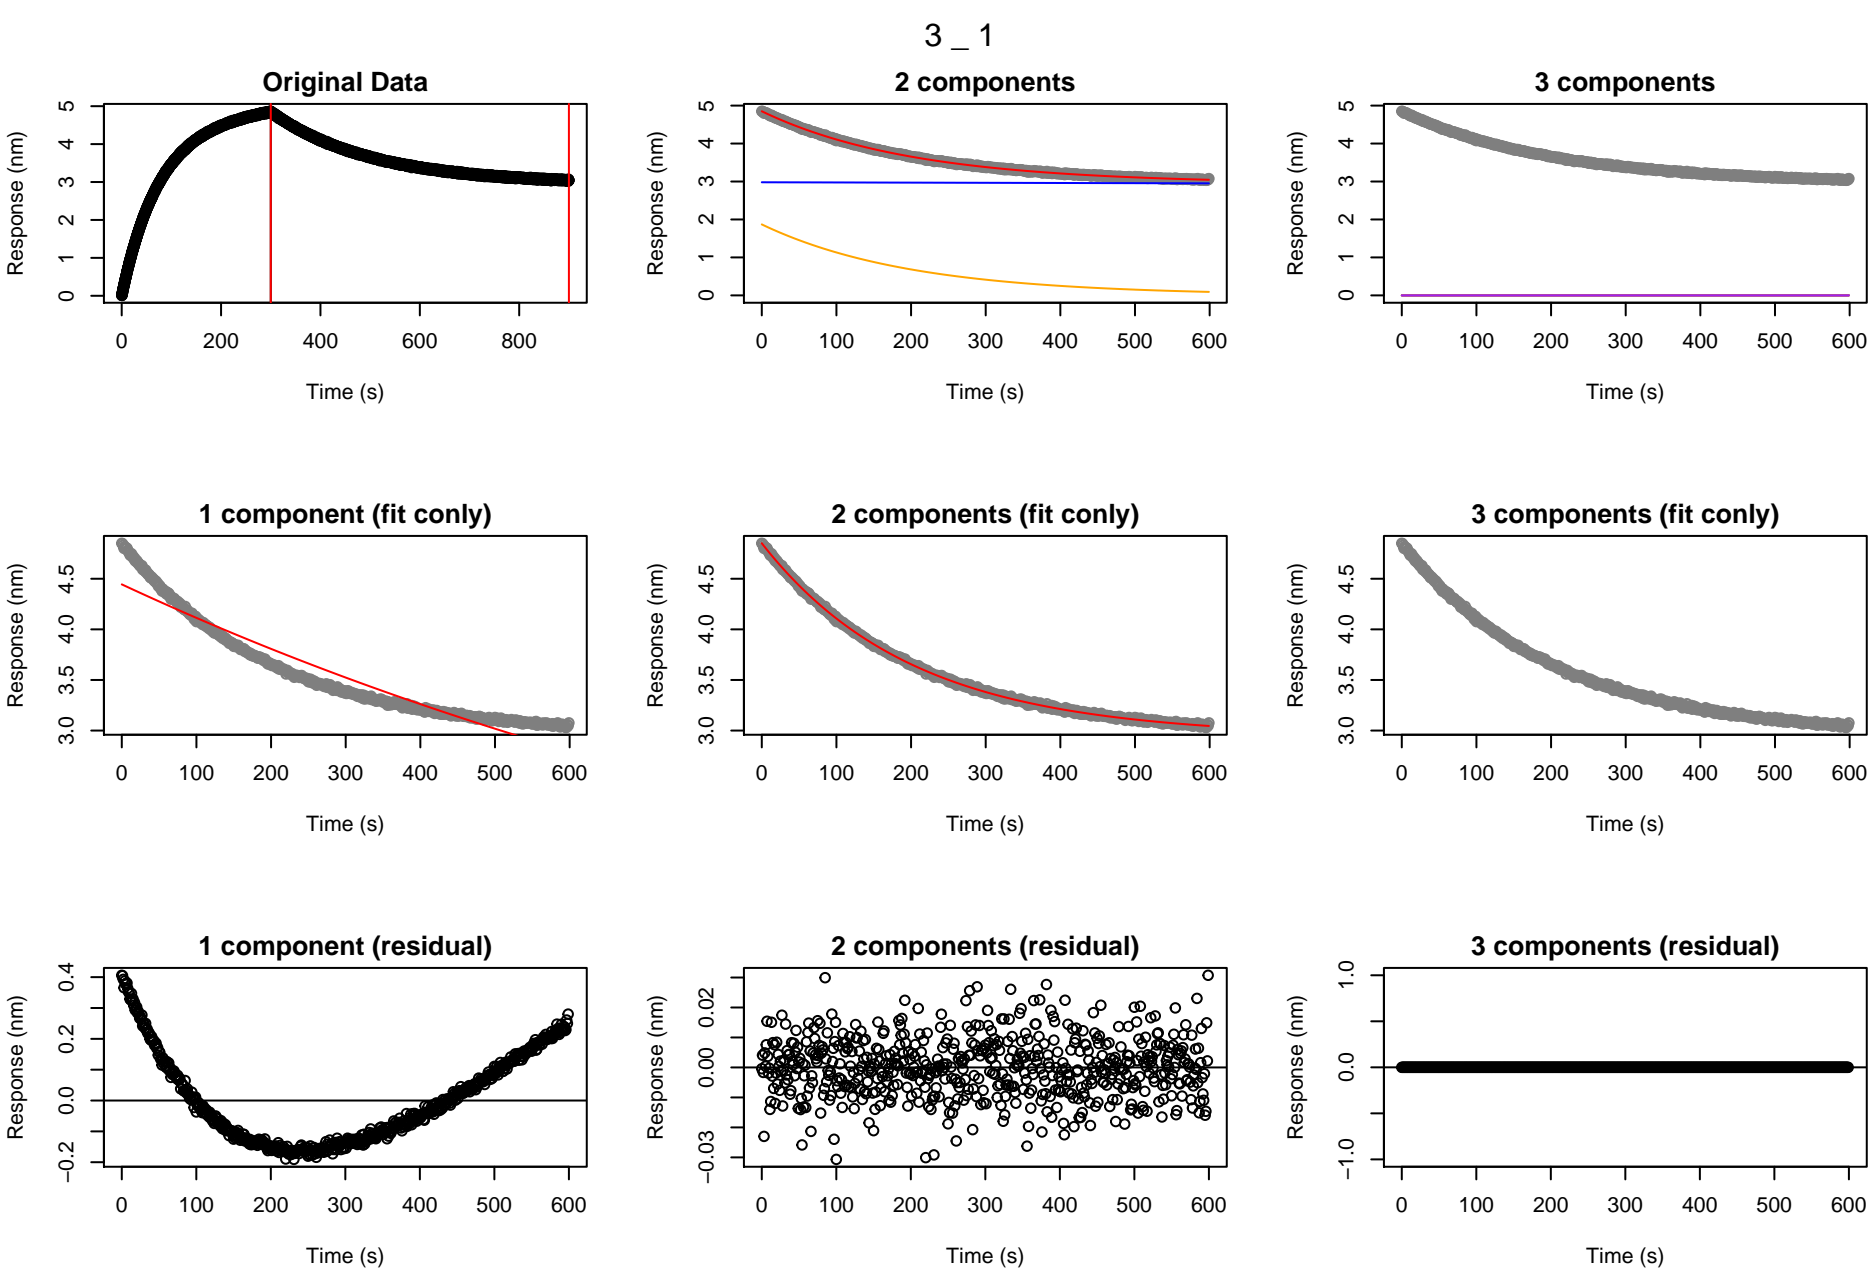

	Response	Std	Off rate	Std
#1	4.44	0.0131	7.74e-04	9.67e-06
.				
A/C	-618.27			

	Response	Std	Off rate	Std
#1	2.98	0.0185	1.58e-05	8.84e-06
#2	1.87	0.0174	5.03e-03	5.21e-05
A/C	-3822.45			


	Response	Std	Off rate	Std
#1	0	0	1.00e-07	0.00e+00
#2	0	0	1.00e-07	0.00e+00
#3	0	0	1.00e-07	0.00e+00
A/C	0.00			

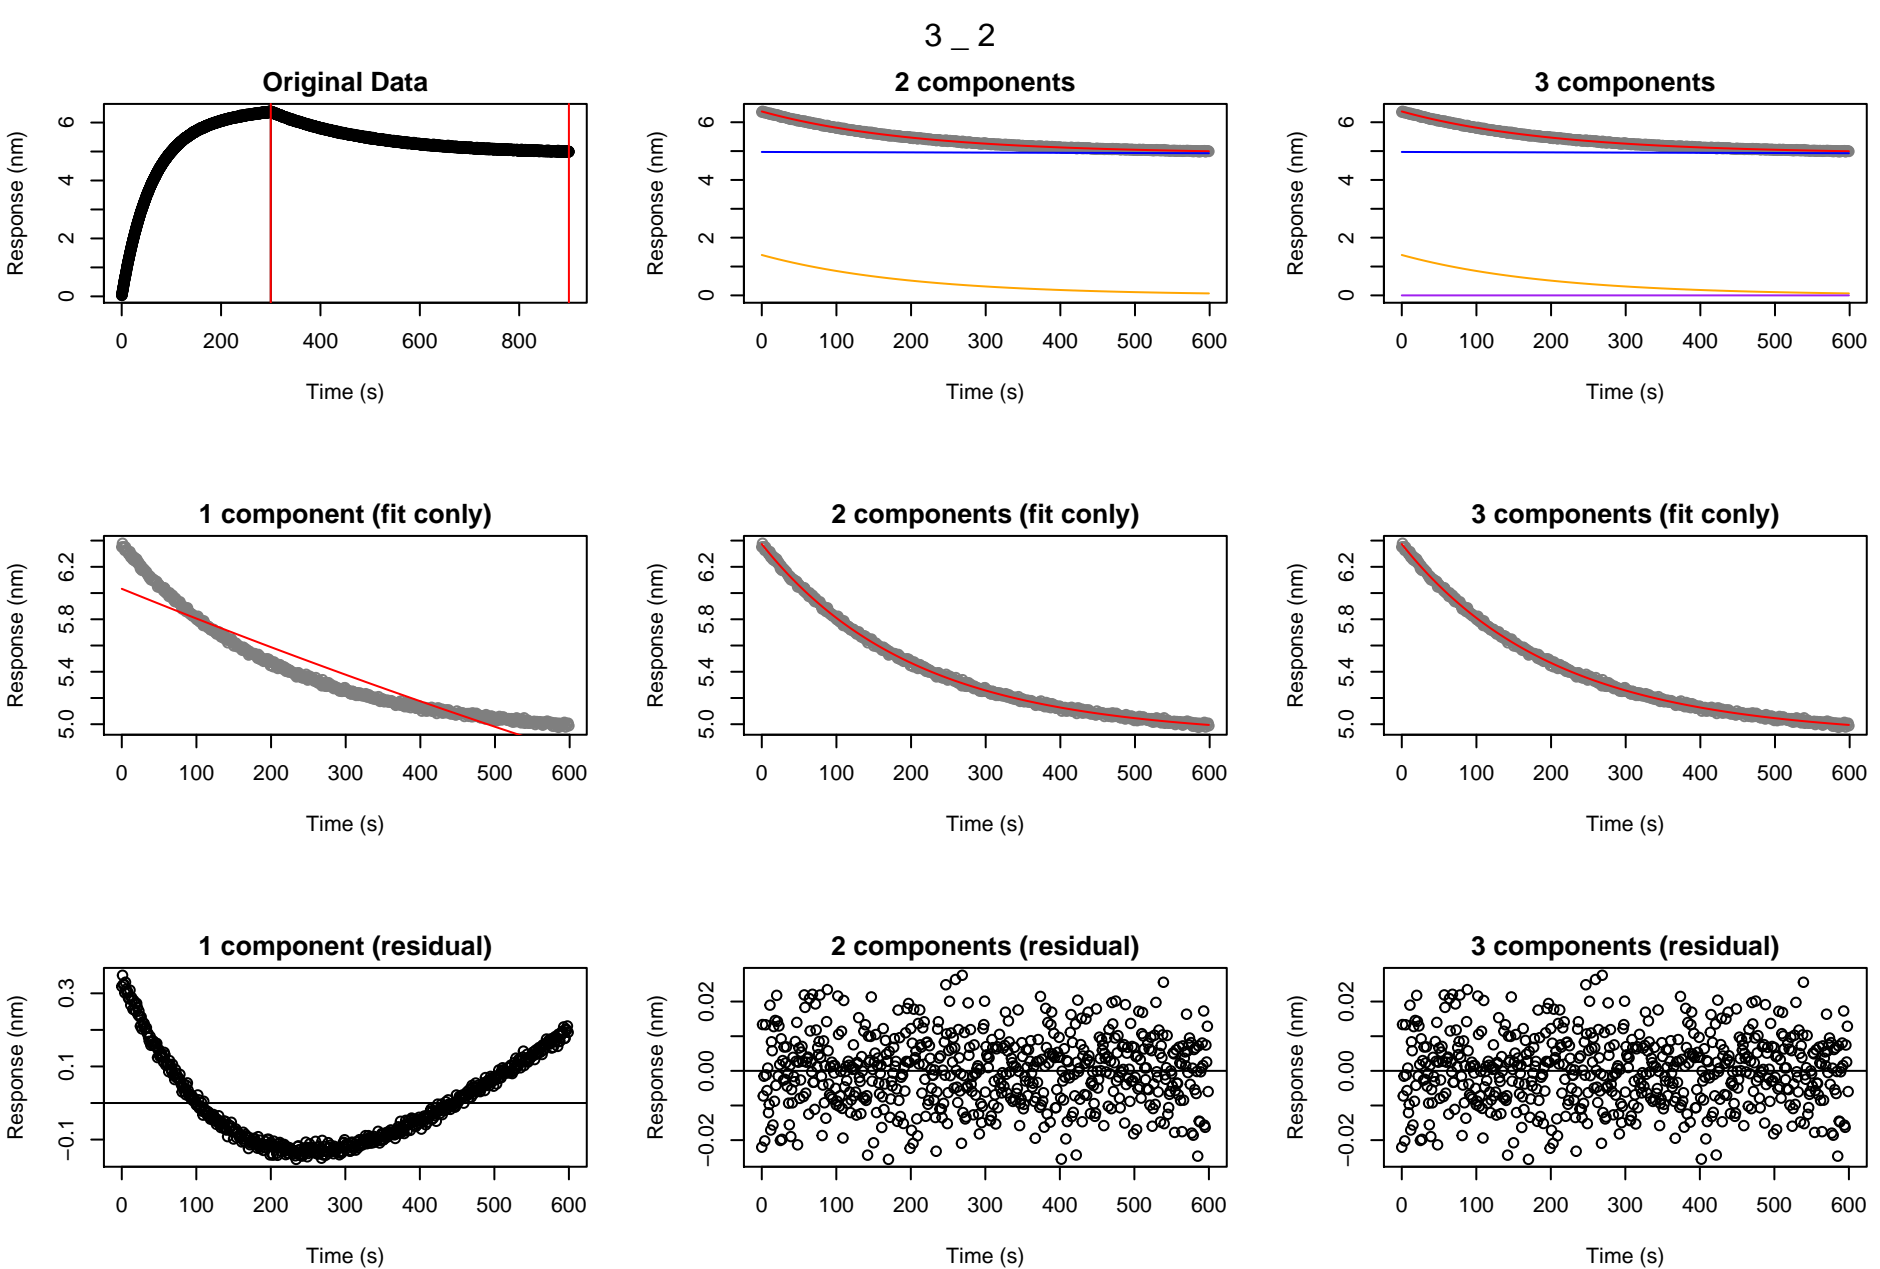

	Response	Std	Off rate	Std
#1	6.03	0.0102	3.83e-04	5.20e-06
.				
A/C	-852.38			

	Response	Std	Off rate	Std
#1	4.97	0.0187	1.48e-05	5.37e-06
#2	1.4	0.0176	5.04e-03	7.04e-05
A/C	-3803.33			


	Response	Std	Off rate	Std
#1	4.97	0.0193	1.48e-05	5.54e-06
#2	1.4	0.0181	5.04e-03	7.39e-05
#3	5.48e-08	0.0101	7.70e-01	2.93e+05
A/C	-3799.33			

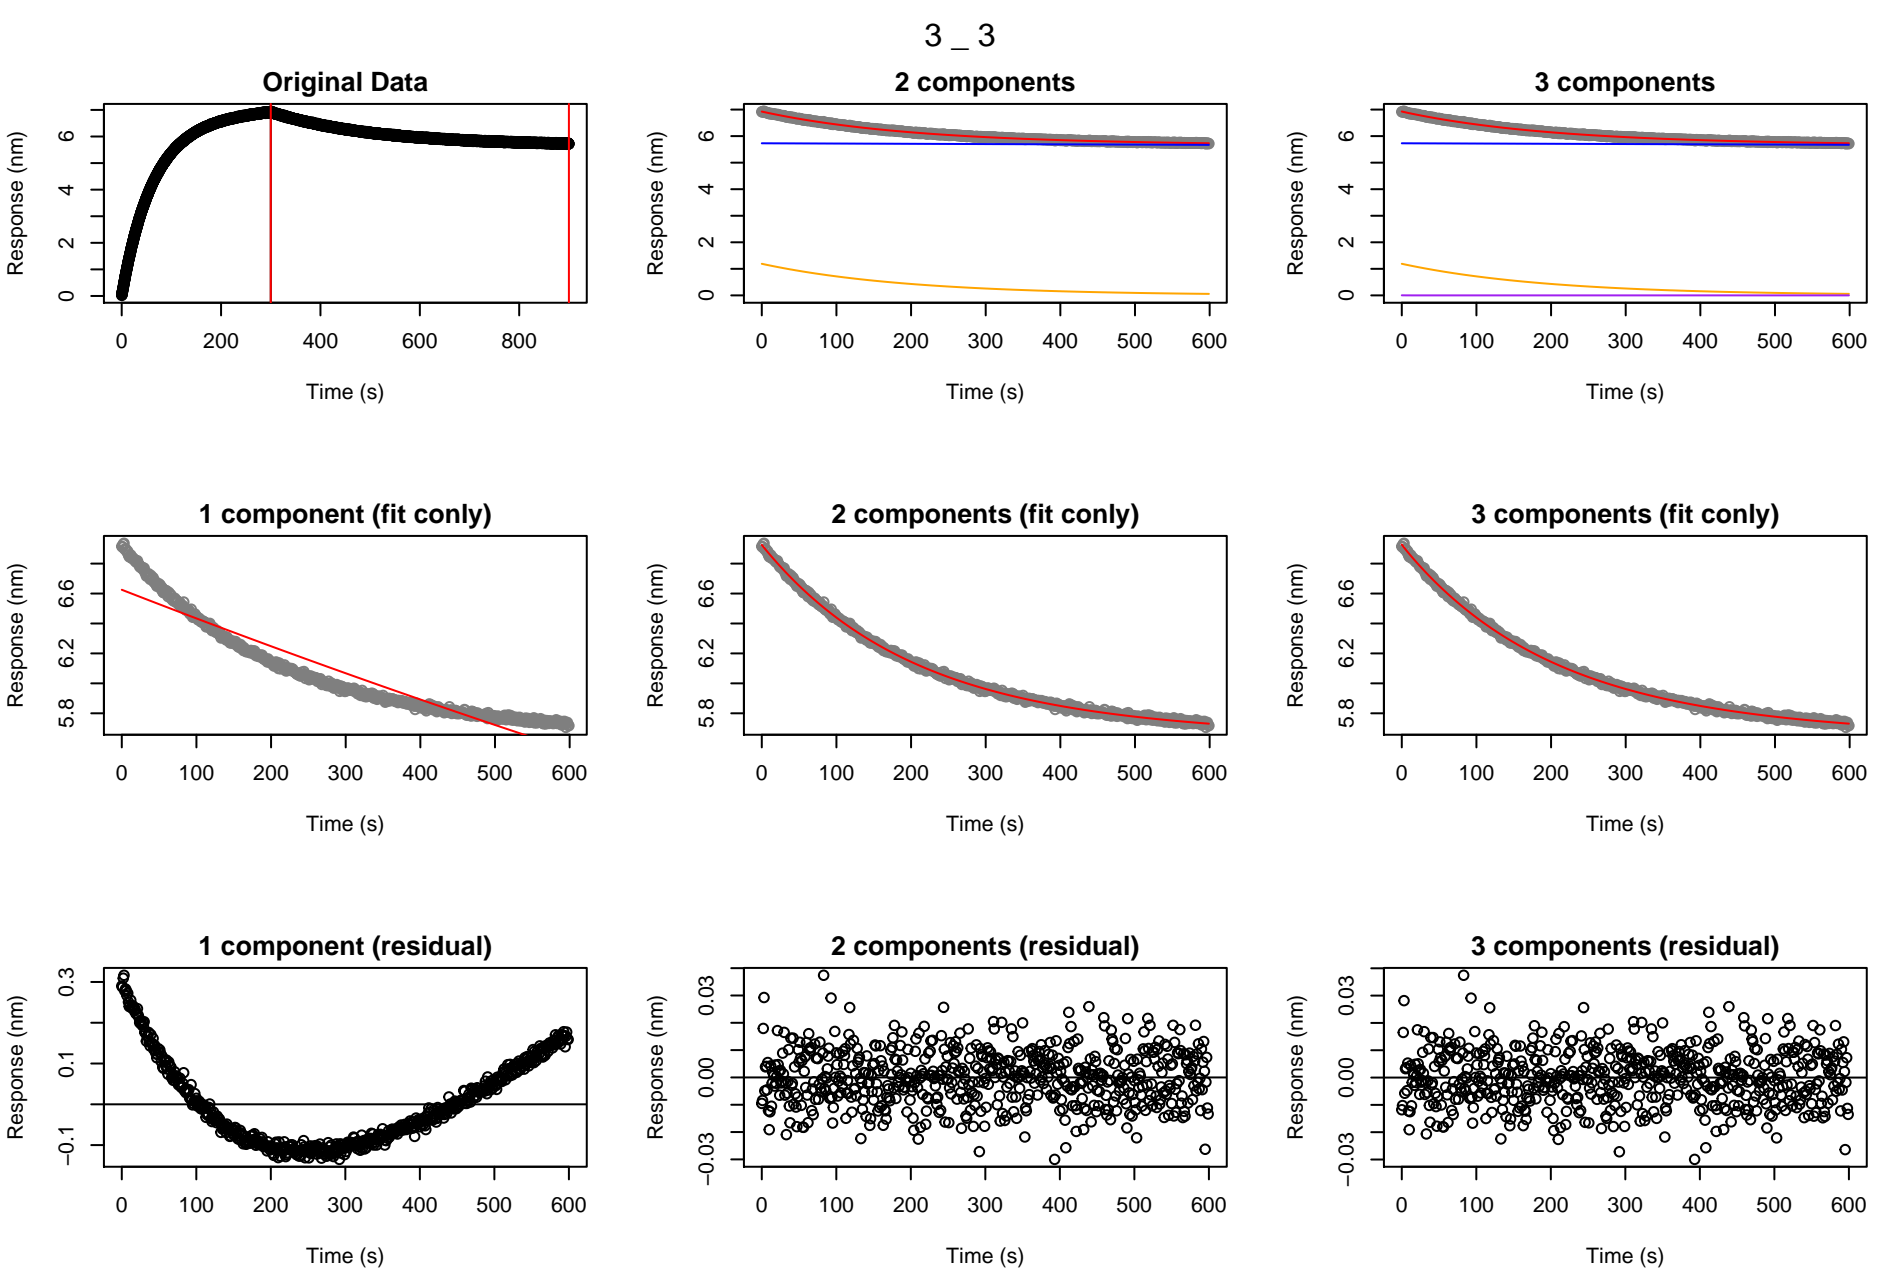

	Response	Std	Off rate	Std
#1	6.63	0.00882	2.93e-04	4.03e-06
.				
AIC	-1014.04			

	Response	Std	Off rate	Std
#1	5.73	0.018	1.73e-05	4.50e-06
#2	1.19	0.0169	5.09e-03	8.11e-05
AIC	-3822.87			

	Response	Std	Off rate	Std
#1	5.73	0.0208	1.66e-05	5.14e-06
#2	1.19	0.0189	5.08e-03	9.86e-05
#3	0.00288	0.00736	1.82e-01	8.70e-01
AIC	-3819.05			









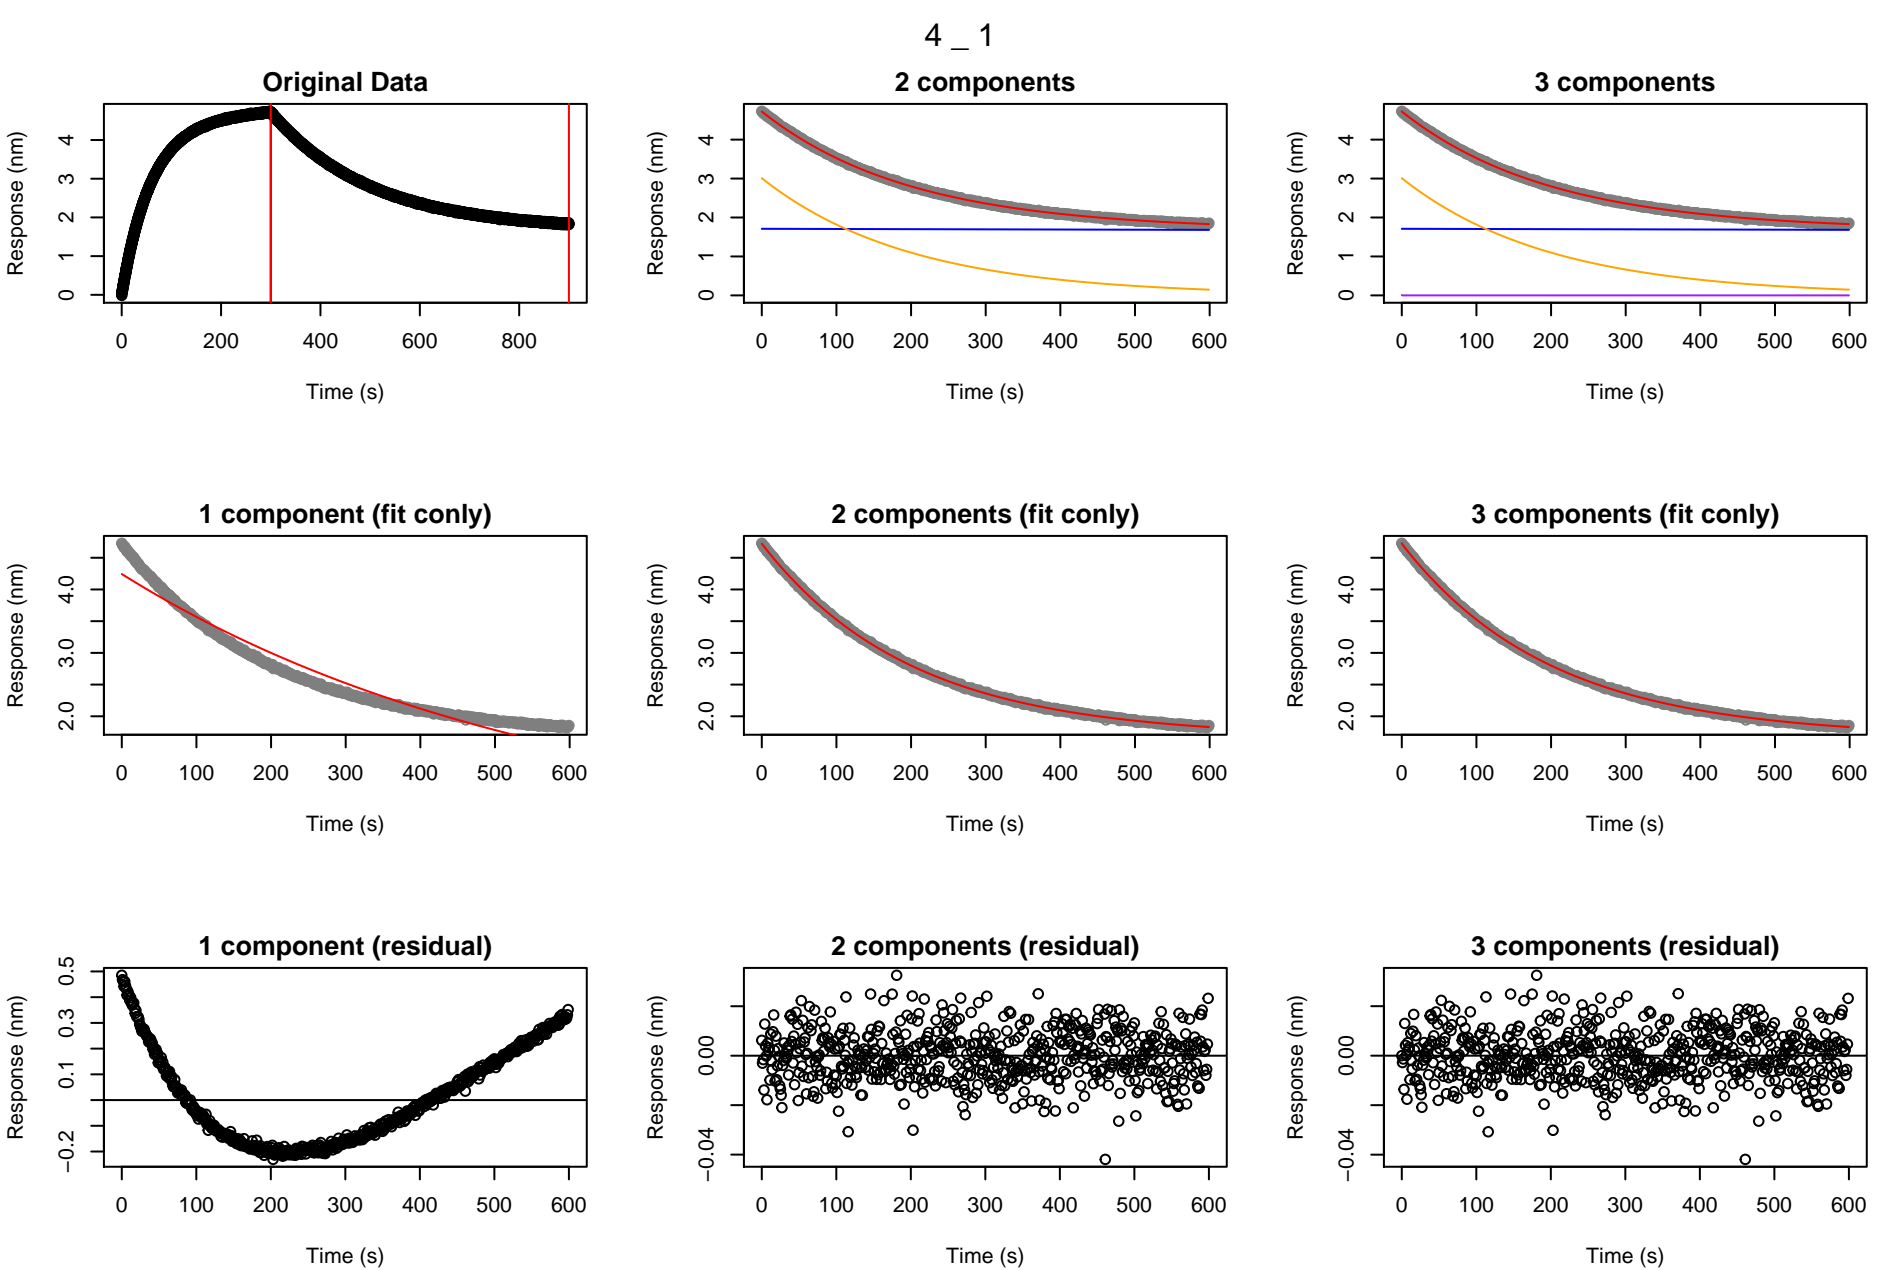


	Response	Std	Off rate	Std
#1	4.24	0.0184	1.73e-03	1.70e-05
.				
A/C	-356.09			

	Response	Std	Off rate	Std
#1	1.71	0.0191	2.75e-05	1.59e-05
#2	3.01	0.018	5.04e-03	3.34e-05
A/C	-3788.17			

	Response	Std	Off rate	Std
#1	1.71	0.0194	2.65e-05	1.61e-05
#2	3.01	0.0182	5.04e-03	3.40e-05
#3	0.00646	0.0105	9.80e+00	2.92e+04
A/C	-3784.56			

4_2

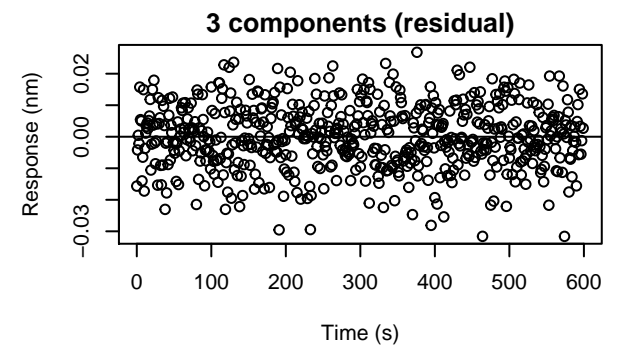
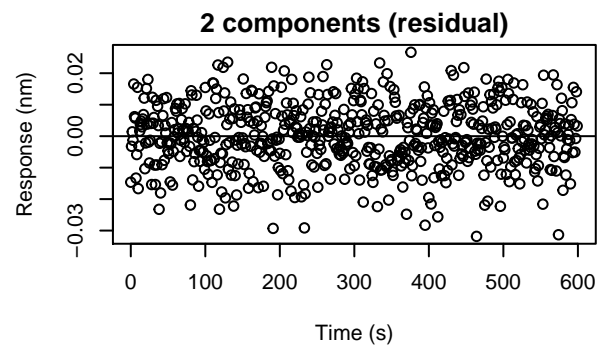
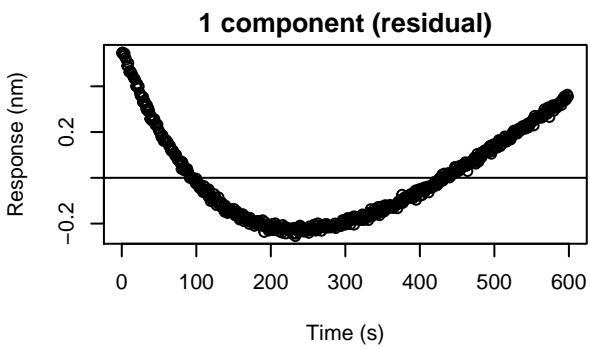
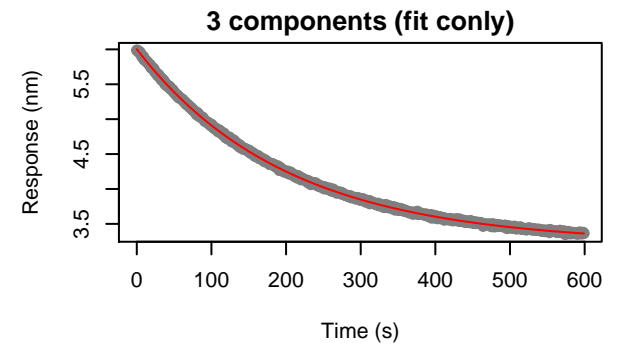
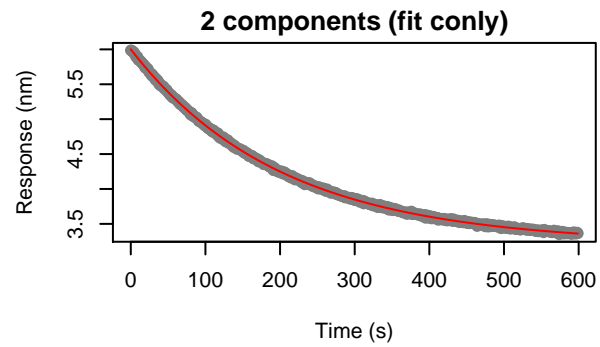
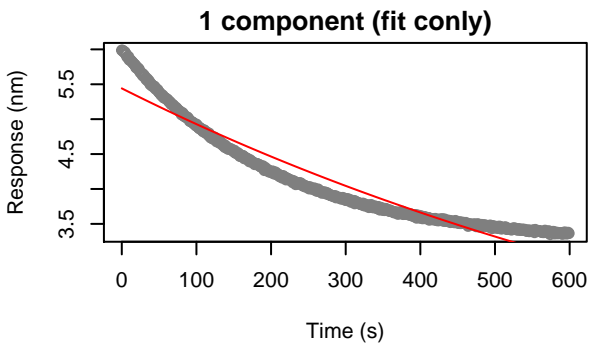
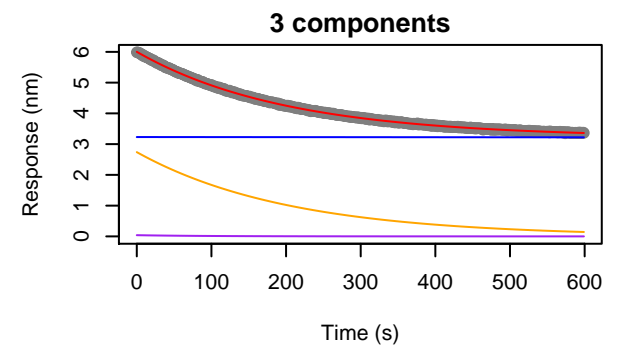
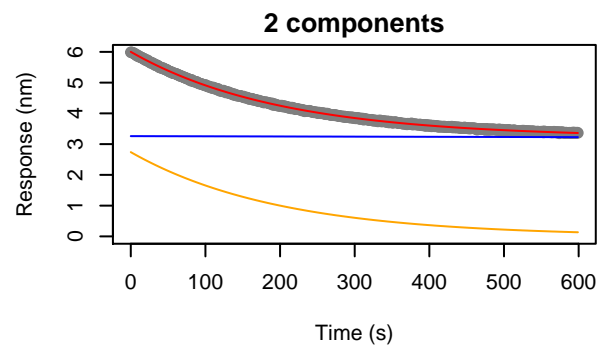
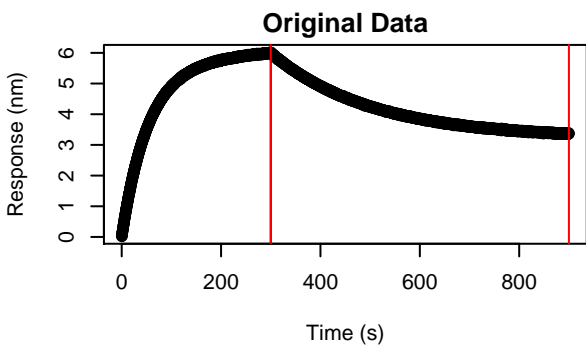


	Response	Std	Off rate	Std
#1	5.44	0.0188	9.89e-04	1.17e-05
.				
A/C	-221.00			

	Response	Std	Off rate	Std
#1	3.26	0.0188	1.69e-05	8.25e-06
#2	2.74	0.0178	5.04e-03	3.63e-05
A/C	-3795.15			

	Response	Std	Off rate	Std
#1	3.23	0.206	4.29e-06	7.16e-05
#2	2.74	0.556	4.93e-03	1.10e-03
#3	0.0391	0.754	1.09e-02	6.17e-02
A/C	-3791.52			

4_3

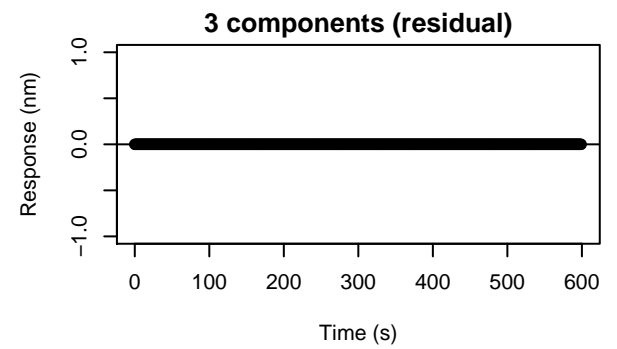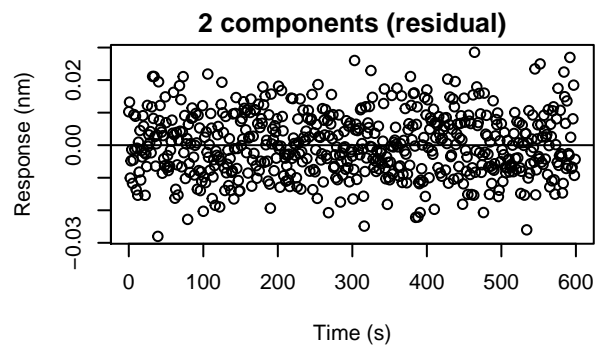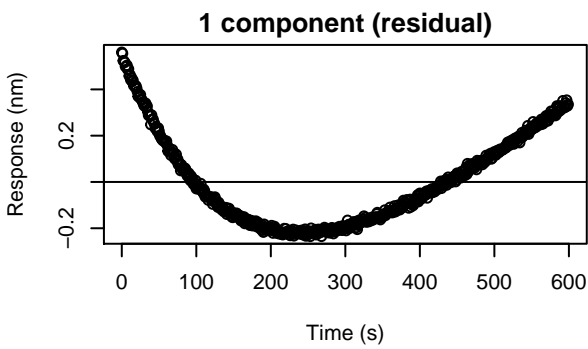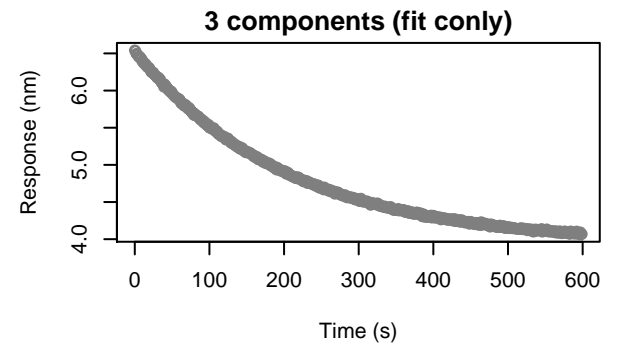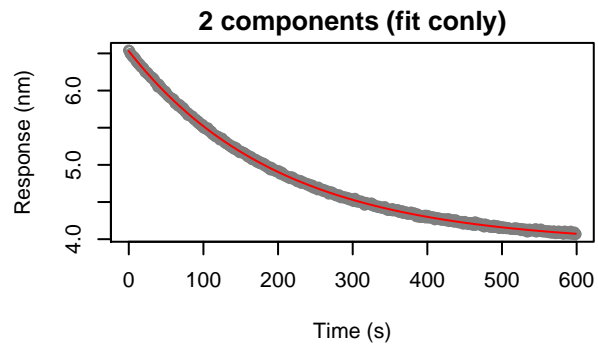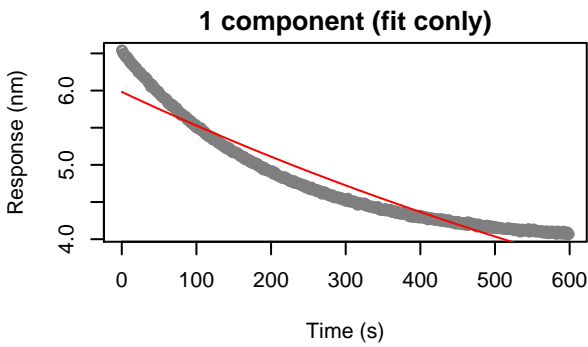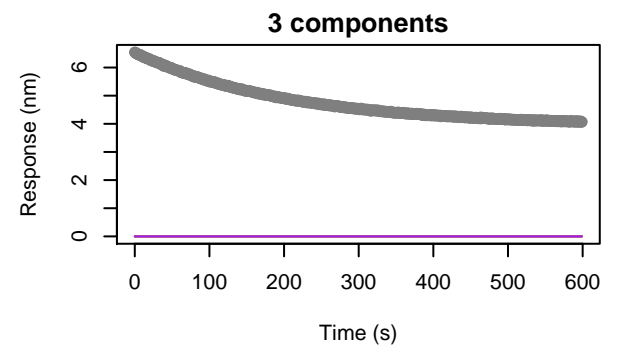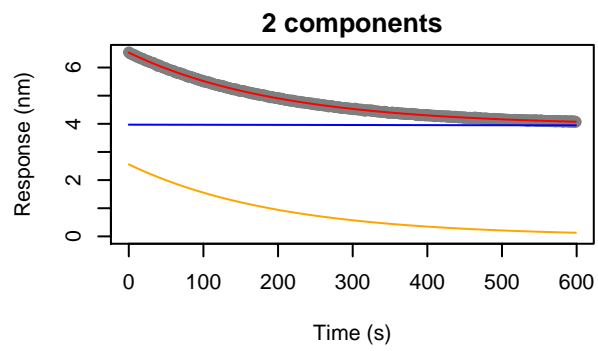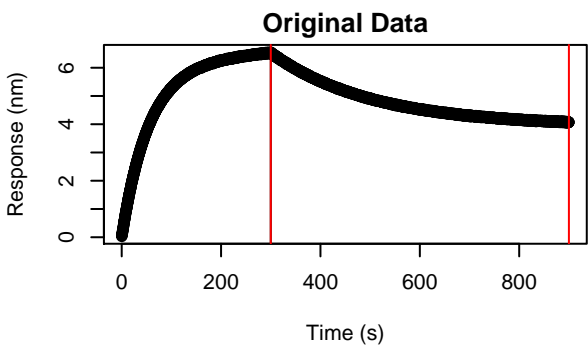

	Response	Std	Off rate	Std
#1	5.98	0.0178	7.87e-04	9.78e-06
.				
A/C	-253.11			

	Response	Std	Off rate	Std
#1	3.97	0.0182	1.02e-05	6.52e-06
#2	2.56	0.0172	4.99e-03	3.70e-05
A/C	-3856.79			

	Response	Std	Off rate	Std
#1	0	0	1.00e-07	0.00e+00
#2	0	0	1.00e-07	0.00e+00
#3	0	0	1.00e-07	0.00e+00
A/C	0.00			