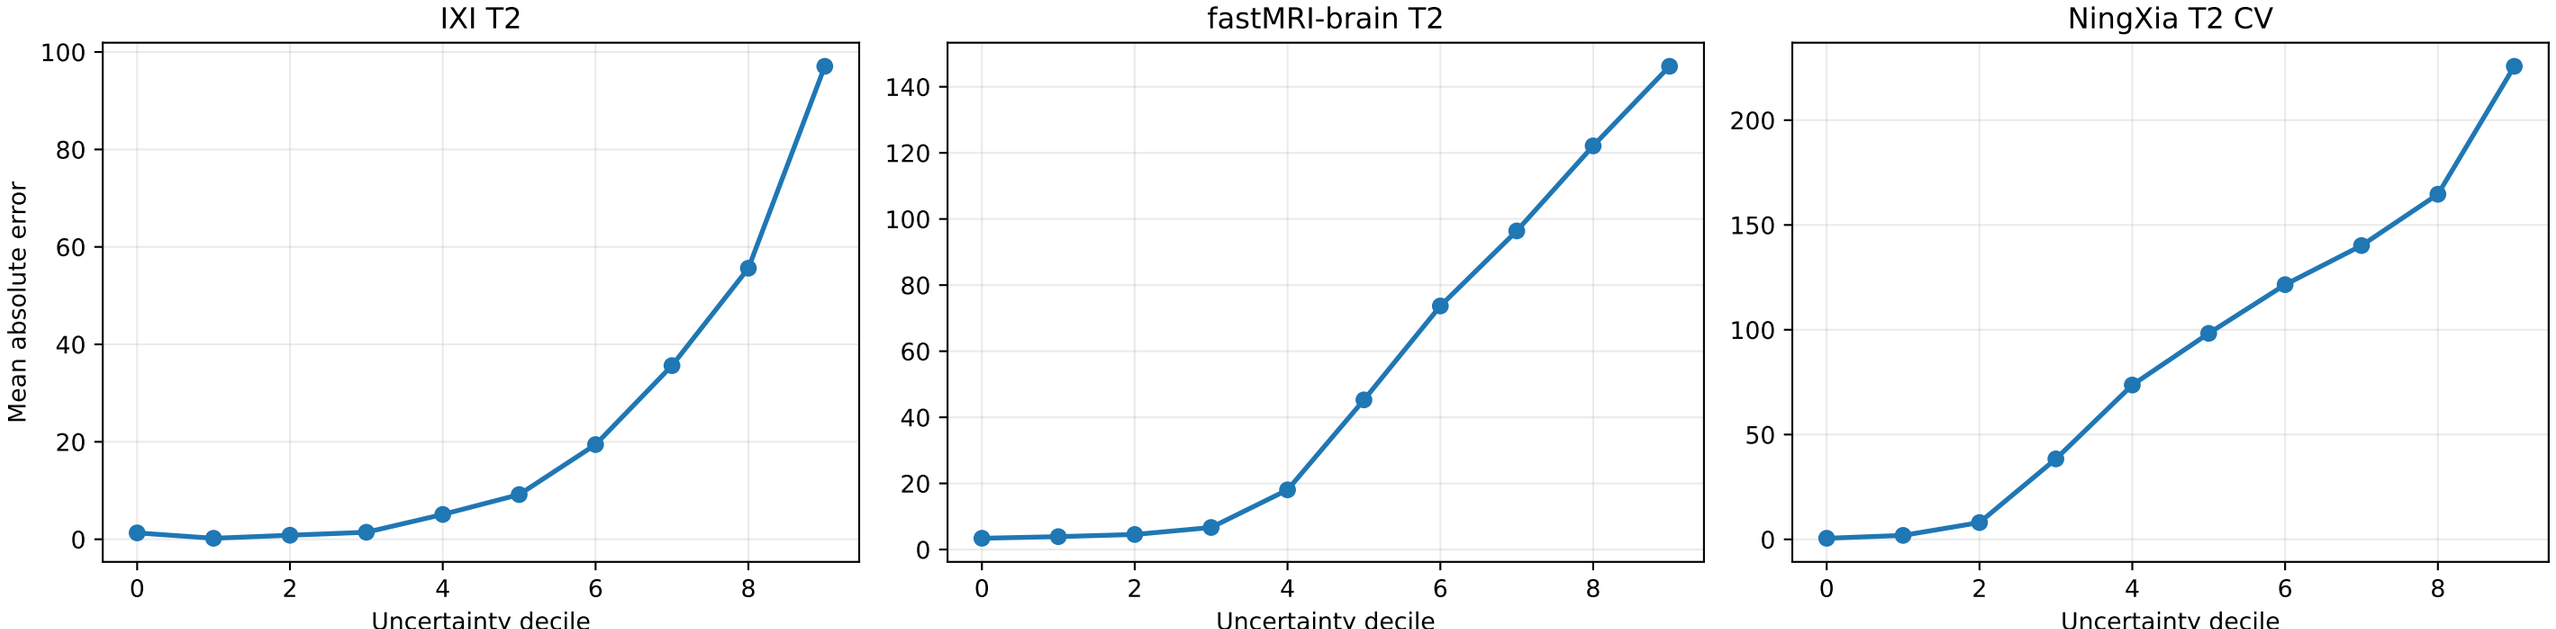
Calibration-style monotonicity by uncertainty decile
IXI T2
fastMRI-brain T2
NingXia T2 CV
Mean absolute error
Uncertainty decile
Uncertainty decile
Uncertainty decile
0
20
40
60
80
100
0
20
40
60
80
100
120
140
0
50
100
150
200
0
2
4
6
8