


DSC /(mW/mg)

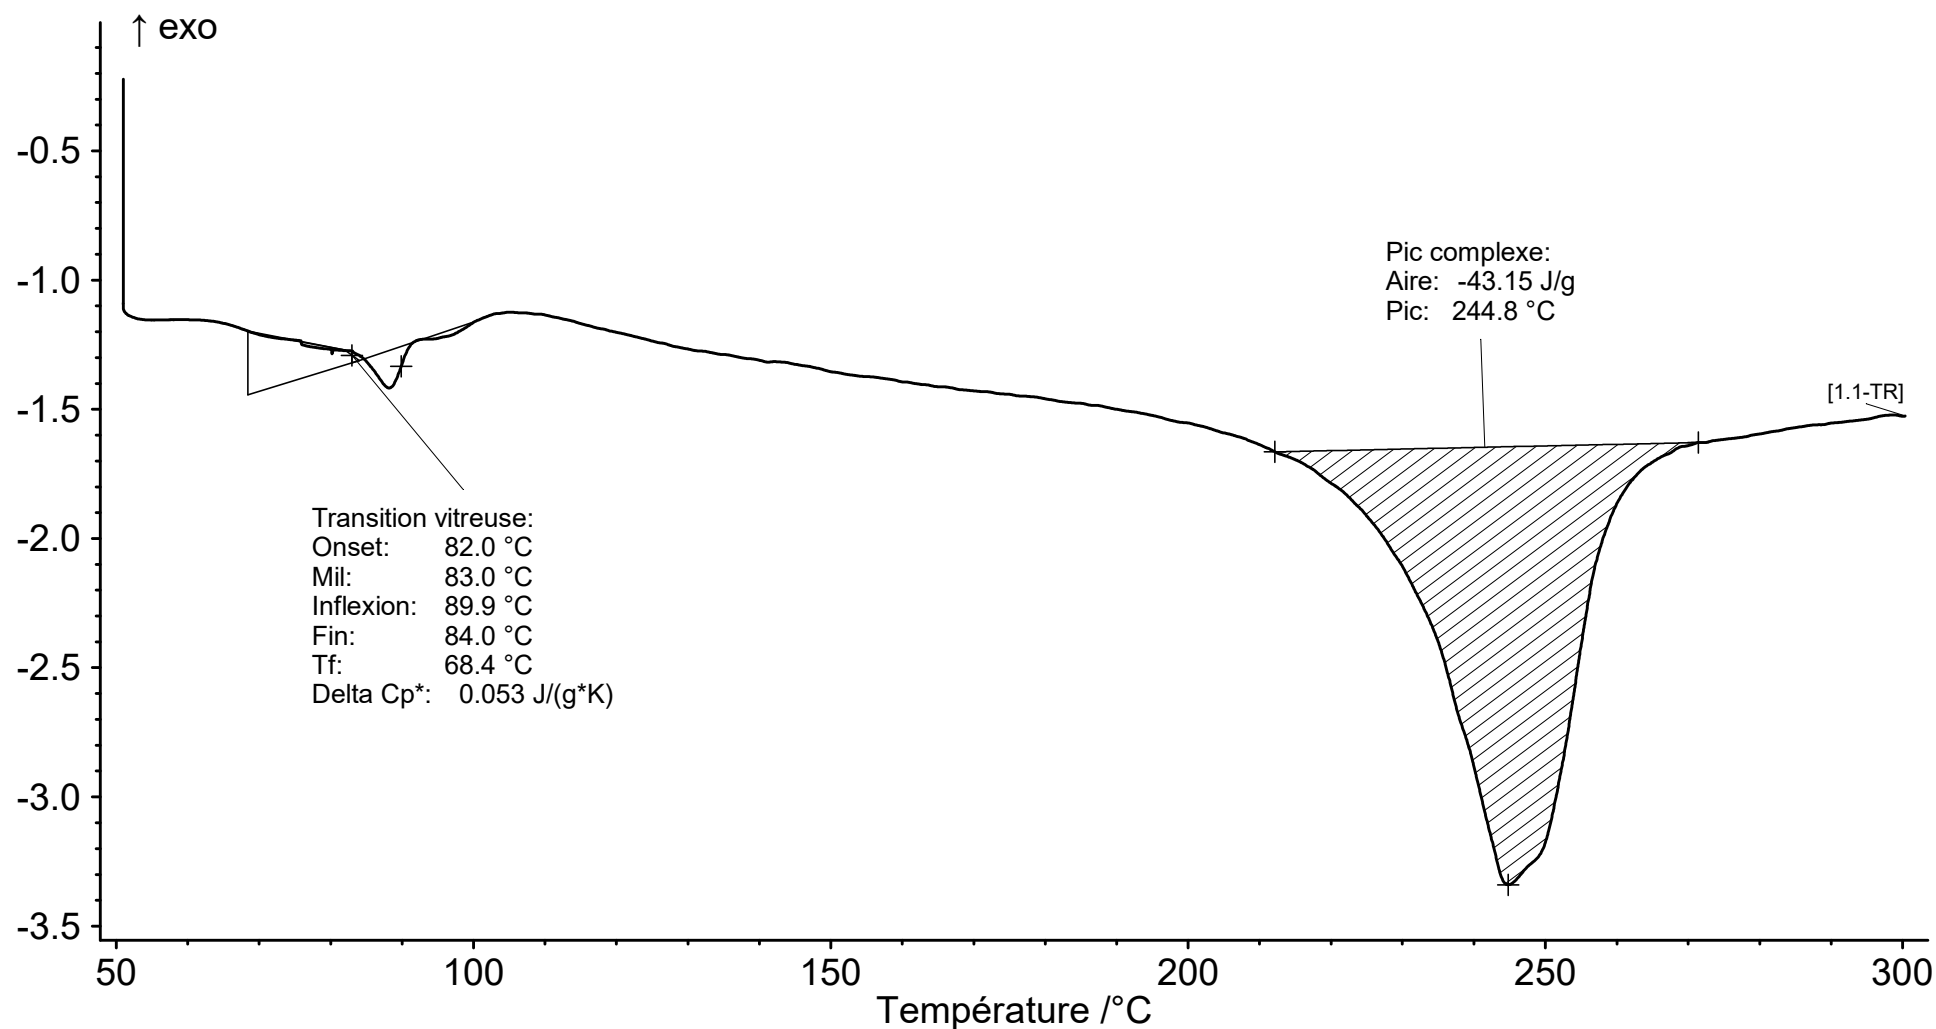

Principal 2025-11-20 11:23 Utilisateur: HEPIA 1

Instrument : NETZSCH DSC 214

Fichier : C:\NETZSCH\Proteus80\data\Pet_training_01_DAMASIO_SEITE.ngb-sdg

Projet : Test

Échantillon : Pet_DS, 2.8 mg

Gamme : 50°C/50.0(K/min)/300°C

Atmosphère : N2, 40.0ml/min / N2, 60.0ml/min

Identité : Test_DS_labM

Référence : Ref_DS,0 mg

Porte-éch./TC : DSC 214 Corona sensor / E

Corr/Gamme m : 0:5:0/5000 µV

Date/Heure : 20.11.2025 09:48:44

Matériau :

Mode/Type de mes. : DSC / Échantillon

Laboratoire : nano

Corr./Cal.temp : -- / 23-05-2024 08:38

Segments : 1/5

Opérateur : mdf

Fich.sens : 23-05-2024 08:36

Creuset : Concavus Al, pierced lid

Créé avec le logiciel Proteus de NETZSCH