


DSC /(mW/mg)

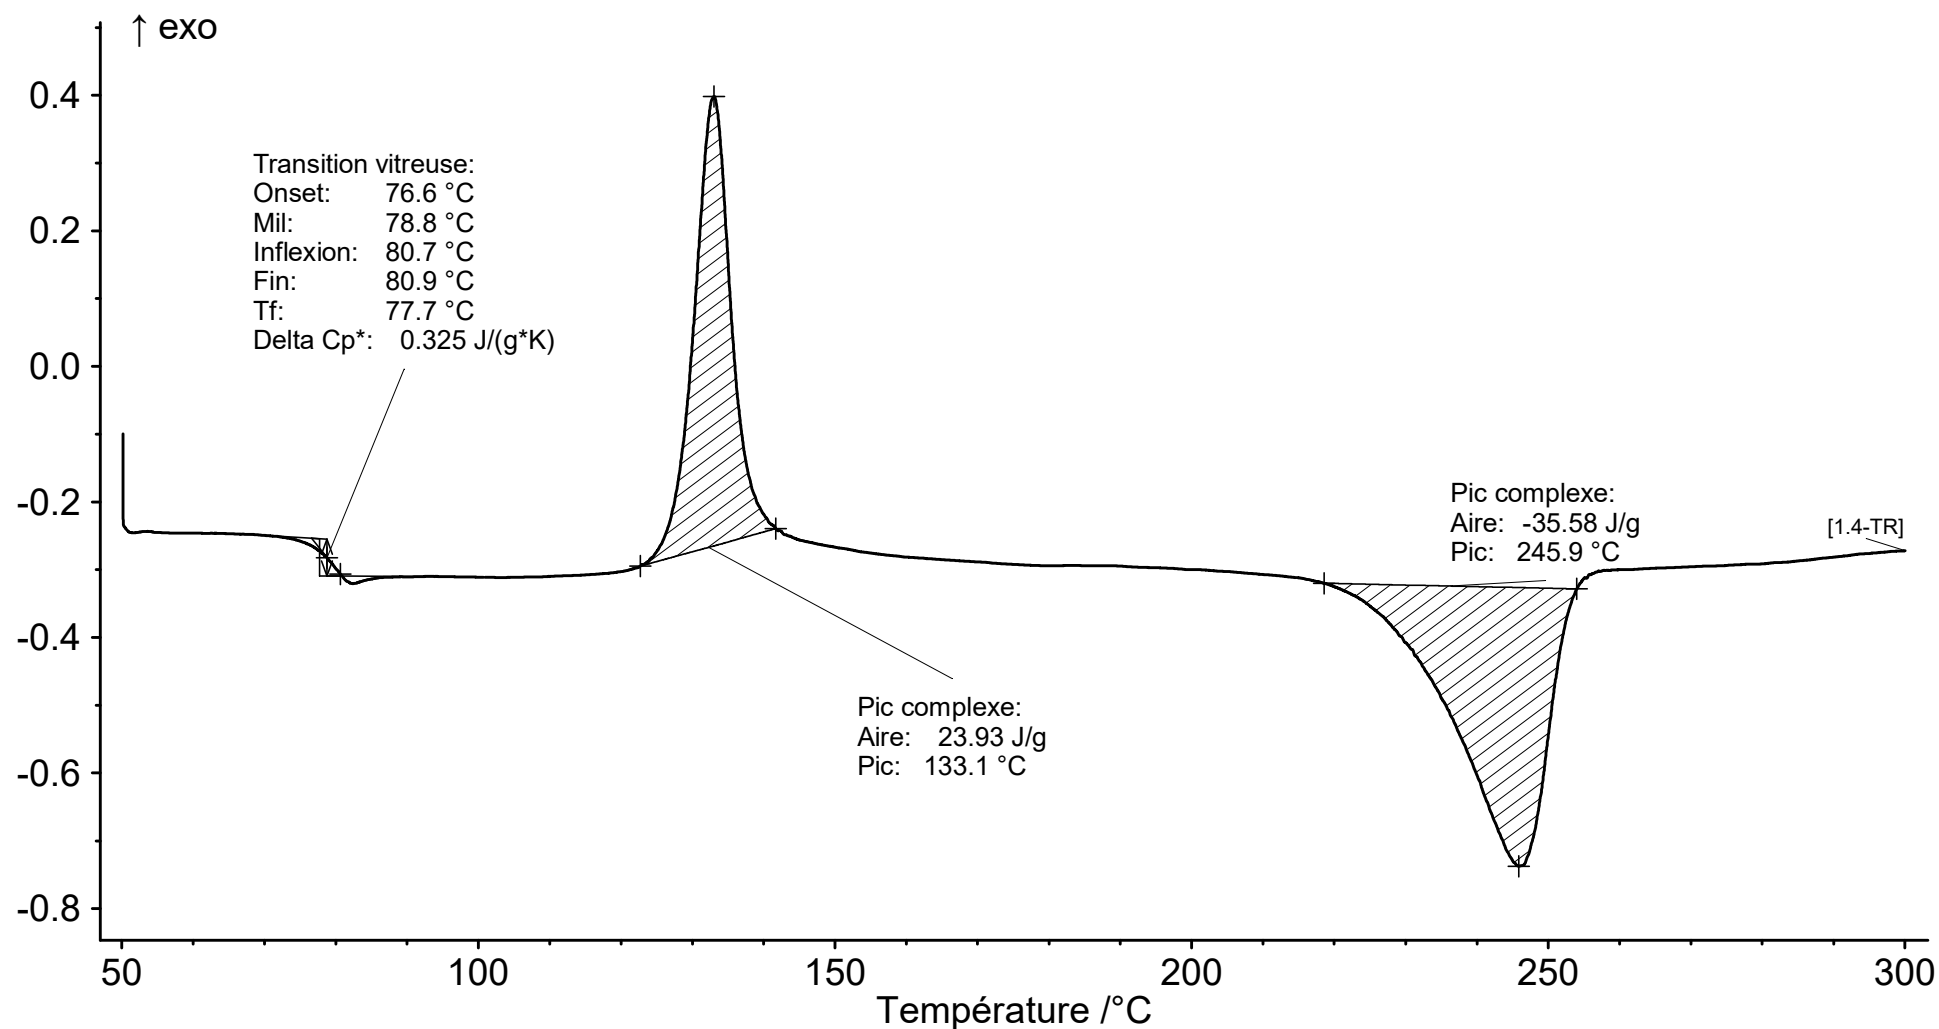

Principal 2025-11-20 11:35 Utilisateur: HEPIA 1

Instrument : NETZSCH DSC 214		Fichier : C:\NETZSCH\Proteus80\data\Pet_training_01_DAMASIO_SEITE.ngb-sdg		
Projet : Test	Échantillon : Pet_DS, 2.8 mg	Gamme : 50°C/10.0(K/min)/300°C	Atmosphère : N2, 40.0ml/min / N2, 60.0ml/min	
Identité : Test_DS_labM	Référence : Ref_DS,0 mg	Porte-éch./TC : DSC 214 Corona sensor / E	Corr/Gamme m : 0:5:0/5000 µV	
Date/Heure : 20.11.2025 09:48:44	Matériau :	Mode/Type de mes. : DSC / Échantillon		
Laboratoire : nano	Corr./Cal.temp : -- / 23-05-2024 08:38	Segments : 4/5		
Opérateur : mdf	Fich.sens : 23-05-2024 08:36	Creuset : Concavus Al, pierced lid		

Créé avec le logiciel Proteus de NETZSCH