
Fréquences d'échantillonnage par paramètre – Qc (2017–2019)
ATRAZINE
CHLORO

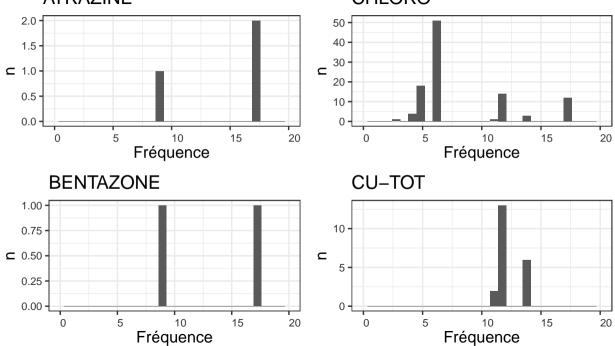

Fréquences d'échantillonnage par paramètre – Qc (2017–2019) **DICAMBA METOLACHLOR** 1.00 -2.0 -0.75 -1.5 -**C** 0.50 -**□** 1.0 **-**0.25 -0.5 -0.00 -0.0 -5 10 15 20 5 10 15 20 Fréquence Fréquence **HG-TOT** NH3-DISS 40 -10 -30 -⊂ <sub>20</sub> J  $\Box$ 5 10 -0 -0 -5 10 15 20 5 10 15 20 Fréquence Fréquence

Fréquences d'échantillonnage par paramètre – Qc (2017–2019) NI-TOT P-TOT 50 40 -10 -30 - $\subseteq$  $\subseteq$ 20 -5 10 -0 -10 15 20 10 15 20 Fréquence Fréquence **TURB** NO3-NO2-D 40 -40 -30 -30 -⊂ <sub>20</sub> . ⊂ <sub>20</sub> ↓ 10 -10 -0 -0 -10 15 20 5 10 15 20

Fréquence

Fréquence

Fréquences d'échantillonnage par paramètre – Qc (2017–2019)

## ZN-TOT

