


JEULIN

MESURE

THERMOMETRE TYPE K

REF : 251 042

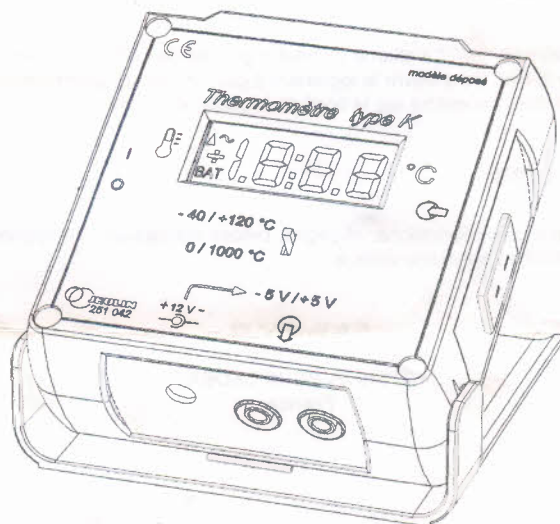

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

- Alimentation : 1 pile 9V type 6F22
ou 1 adaptateur secteur 12V réf : 281 243 (non fourni)
- Gammes : -40 à +120°C et 0 à 1000°C
- Précision : 2 % de la valeur lue + 2 unités de résolution, hors précision sonde
- Résolution : 0.1 °C sur la gamme -40 à +120°C
1.0°C sur la gamme 0 à 1000°C
- Sonde : thermocouple type K (non fournie)
- Sortie analogique : -5V à +5V proportionnelle à la température pour les 2 gammes, uniquement disponible lorsque l'appareil est alimenté par l'adaptateur secteur 12V.
Précision : 1% de la valeur affichée
- Dimensions : 100 x 100 x 40 mm



SA AU CAPITAL DE 3.233.762 €
CCP ROULEN 20041-01014-02929750035/58
SG EVREUX 30003-00866-0002004009772
APE 516 L RCS EVREUX B 387 901 044
N° TVA FR 61 387 901 044

SIÈGE SOCIAL
RUE JACQUES-MONOD
Z.I. N° 1 - NÉTREVILLE
ÉVREUX
FRANCE

ADRESSE POSTALE
BP 1900
27019 ÉVREUX CEDEX
FRANCE

0102

TÉL. NATIONAL : 02 32 29 40 00
INTERNAT. : +(33) 2 32 29 40 00
FAX NATIONAL : 02 32 29 40 99
INTERNAT. : +(33) 2 32 29 40 99
MINITEL 36 14 JEULIN
INTERNET : <http://www.jeulin.fr>

TEMPS DE CHAUFFE DE L'APPAREIL :

A la mise en marche, l'appareil a besoin de 7 minutes environ pour avoir sa justesse maximale. L'erreur "à froid", est de 1 à 1.5°C en moins par rapport à la valeur réelle.

CHANGEMENT DE PILE :

Lorsque le témoin "BAT" s'allume en haut à gauche de l'afficheur, il est recommandé de changer la pile. Pour ouvrir le logement à pile, utiliser un petit tournevis, en l'engageant dans l'encoche sur le bord de la porte, et en faisant levier.

SERVICE APRES VENTE

Pour toutes réparations, réglages, pièces concernant cet appareil pendant ou après la garantie , adressez-vous à :

**S.A.V. JEULIN
BP 1900
27019 EVREUX CEDEX
France**