SISTEMAS ARS	SYSTEMS AND INSTRUMENTS	ARTHROMED	BONSS MEDICAL MEXICO

Nombre: Sistema de radiofrecuencia ARS	**Marca:** Bonss Medical
Modelos: ARS600, ARS700, ARS800	

Descripción

Sistema electroquirúrgico de plasma por radiofrecuencia, indicado para electrodos bipolares y multipolares. Cuenta con funciones para la ablación, corte, coagulación y hemostasia de tejidos humanos.

Características técnicas

Peso	6 kg	**Voltaje**	100-120VAC, 220-240VAC
Temperatura de funcionamiento	10~40℃	**Radiofrecuencia**	100 KHz
Dimensiones del generador	Altura 13cm Ancho 37cm Longitud 46cm	**Tipo de fusible**	T10AH250V, T5AH250V
Componentes	Cable de suministro eléctrico (CA-CC)	**Garantía**	1 año
	Un interruptor de pie (AJ120)	**Cumple con la norma**	MDD 93/42/EEC
	Unidad de control de flujo salino (solo para ARS 700)		

Funcionamiento

Modo ABLATE: Resección y ablación de tejido, controlado por panel y pedal de color amarillo y ajuste de potencia de 9 niveles.

Modo COAG: Coagulación y hemostasia, controlado por panel y pedal de color azul y ajuste de potencia de 9 niveles.

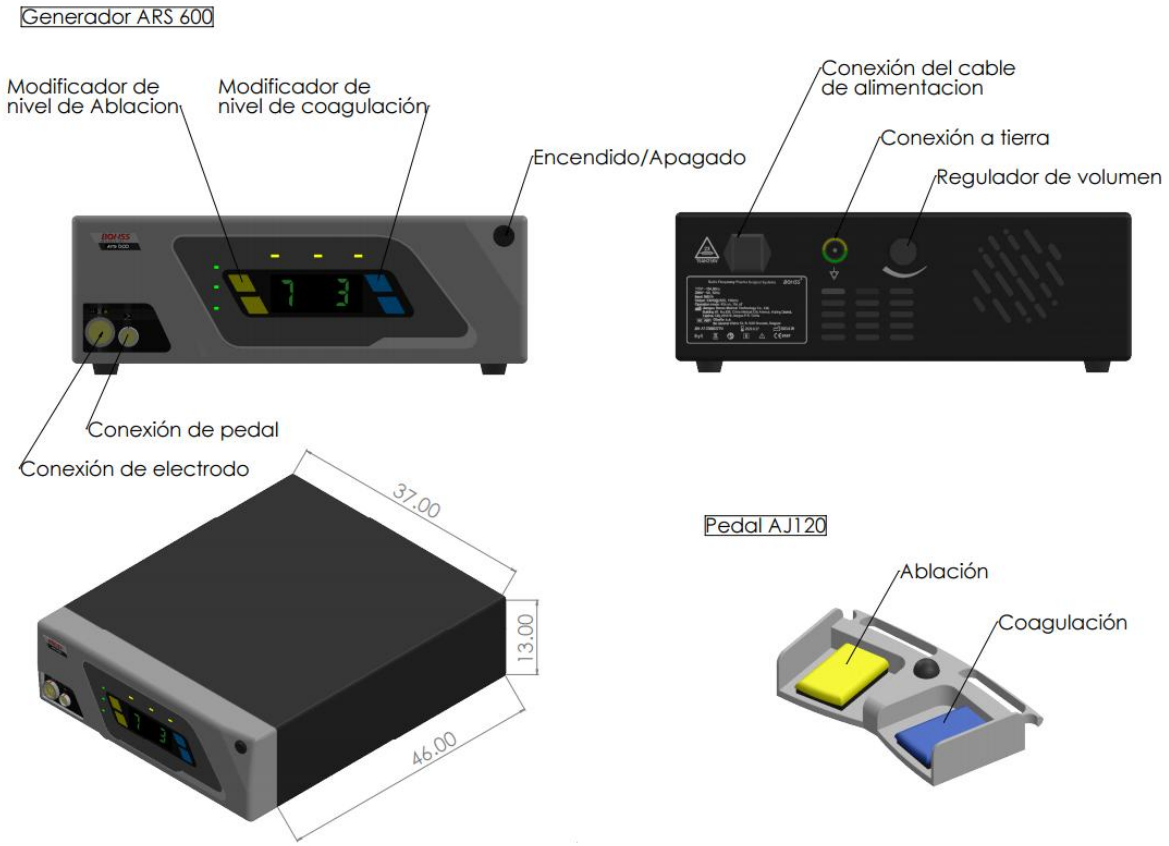

Sistemas 600, 700, 800	
Cada sistema cuenta con sus propios electrodos ya que unos no son compatibles con otras consolas, por el tipo de conexión y por la potencia (W) y voltaje (V) de salida de cada consola.	
Sistema 600	• Indicado para procesos de Ortopedia (spine y UBE) y Artroscopia (Sport medicine).
Sistema 700	• Indicado para procesos de Otorrinolaringología (ENT) • Cuenta con una unidad de control salino
Sistema 800	• Indicado para procesos de Ginecología y Urología (Gyn&Uro)

Contra indicaciones y precauciones de uso

- Evitar el uso en pacientes con marcapasos o dispositivos implantables similares sin consultar previamente con un médico.
- Evitar el contacto directo con fluidos sobre los conectores eléctricos.
- Pacientes con marcapasos o implantes electrónicos no deben ser tratados ni estar cerca del dispositivo mientras está en funcionamiento.
- No abra la cubierta del generador a menos que sea realizada por personal capacitado para reparaciones.

Recomendaciones de mantenimiento y cuidado

- Realice inspecciones regularmente a cables y conexiones.
- Mantenga los electrodos alejados de objetos metálicos cuando no esté en uso.
- No abra la cubierta del generador a menos que sea realizada por personal capacitado para reparaciones.
- Después del año de garantía transcurrido, consulte a su proveedor para dar un mantenimiento preventivo.

Ventajas

- Opera a temperaturas bajas (~30℃)
- Trabaja con solución fisiológica (NaCl 9%).
- No genera daño térmico ni carboniza el tejido, propiciando una recuperación veloz y reduciendo el tiempo de estancia hospitalaria.
- Capacidad de coagulación mejorada qué evita o reduce significativamente el sangrado durante el procedimiento.
- La tecnología bipolar y multipolar no requiere placas de retorno, lo que da mayor seguridad al paciente, evitando arcos eléctricos y quemaduras.