| FICHA TÉCNICA | ENT | ARTHROMED | BONSS MEDICAL MEXICO |
|---|---|---|---|
| **Nombre** | Turbin EX | **Marca** | Bonss Medical |
| **Modelo** | 304 | **Código del producto** | A4845S |

**Descripción**

Dispositivo médico de alta precisión utilizado en procedimientos quirúrgicos para ablación, coagulación y resección de tejidos mediante tecnología de radiofrecuencia. Diseñada para el procedimiento de reducción de cornetes por canalización.

**Características técnicas**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Material** | Aleación biocompatible de alta conductividad | **Equivalente a (competidor)** | Reflex ULTRA PTR |
| **Longitud de eje** | 110mm | **Diámetro de punta** | 1.5mm |
| **Longitud de cable** | 3m | **Longitud del mango** | 165mm |
| **Rango de frecuencia** | 100 kHz | **Potencia máxima** | **ABLATE**:380W **COAG**: 60W |
| **Tipo de electrodo** | Bipolar | **Reutilizable:** No | **Función:** Ablación, Coagulación. |
| **Valores predeterminados** | **Ablación**:4 **coagulación**: 2 | **Vencimiento:** 3 años | **Dispositivo medico:** Clase II |
| **Indicaciones de uso** | Cada 5 segundos de activación de la ablación, el dispositivo ARS emitirá una alarma sonora con un tono diferente. Esto sirve para recordar a los cirujanos el tiempo que lleva funcionando la ablación. | | |

**Dibujo técnico**

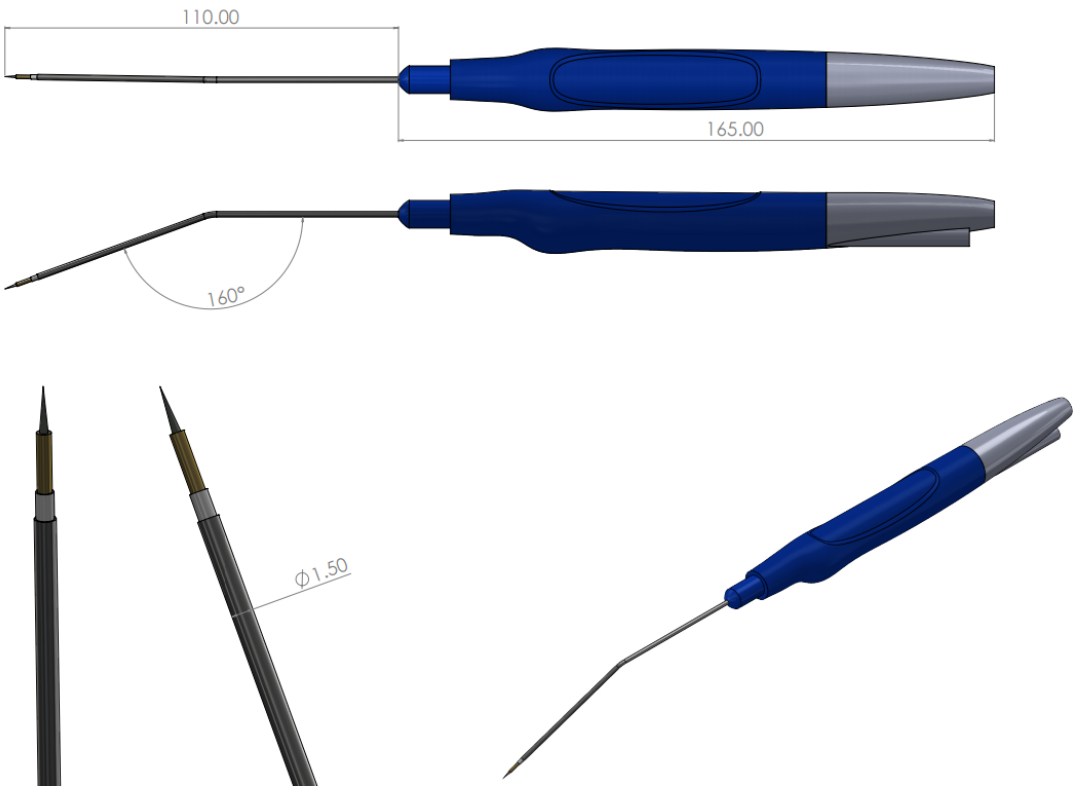


Av. Zacatecas #128, Constituyentes del 17
San Nicolás de los Garza, CP 66410
Nuevo León, México.

Tel. 81 2752 6075
81 8688 9100
servicio@arthromed.mx

| FICHA TÉCNICA | ENT | ARTHROMED | BONSS MEDICAL MEXICO |
|---|---|---|---|
| **Nombre** | Palat EX | **Marca** | Bonss Medical |
| **Modelo** | 305 | **Código del producto** | A4855S |

**Descripción**

Dispositivo médico de alta precisión utilizado en procedimientos quirúrgicos para ablación, coagulación y resección de tejidos mediante tecnología de radiofrecuencia. Diseñada para la ablación por canalización del paladar blando, ablación por canalización de la base de la lengua, Úvula, UPPP, Ronquido, SAOS (Síndrome de Apnea Obstructiva del Sueño). Cada 5 segundos de activación de la ablación, el dispositivo ARS emitirá una alarma sonora con un tono diferente, esto ayuda para indicar el tiempo que lleva funcionando la ablación.

**Características técnicas**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Material** | Aleación biocompatible de alta conductividad | **Equivalente a (competidor)** | Reflex55 |
| **Longitud de eje** | 100mm | **Diámetro de punta** | 1.8mm |
| **Longitud de cable** | 3m | **Longitud del mango** | 165mm |
| **Rango de frecuencia** | 100 kHz | **Potencia máxima** | **ABLATE**:380W **COAG**: 60W |
| **Tipo de electrodo** | Bipolar | **Reutilizable:** No | **Función:** Ablación, Coagulación. |
| **Valores predeterminados** | **Ablación**:4 **coagulación**: 2 | **Vencimiento:** 3 años | **Dispositivo medico:** Clase II |
| **Indicaciones de uso** | Cada 5 segundos de activación de la ablación, el dispositivo ARS emitirá una alarma sonora con un tono diferente. Esto sirve para recordar a los cirujanos el tiempo que lleva funcionando la ablación. | | |

**Dibujo técnico**

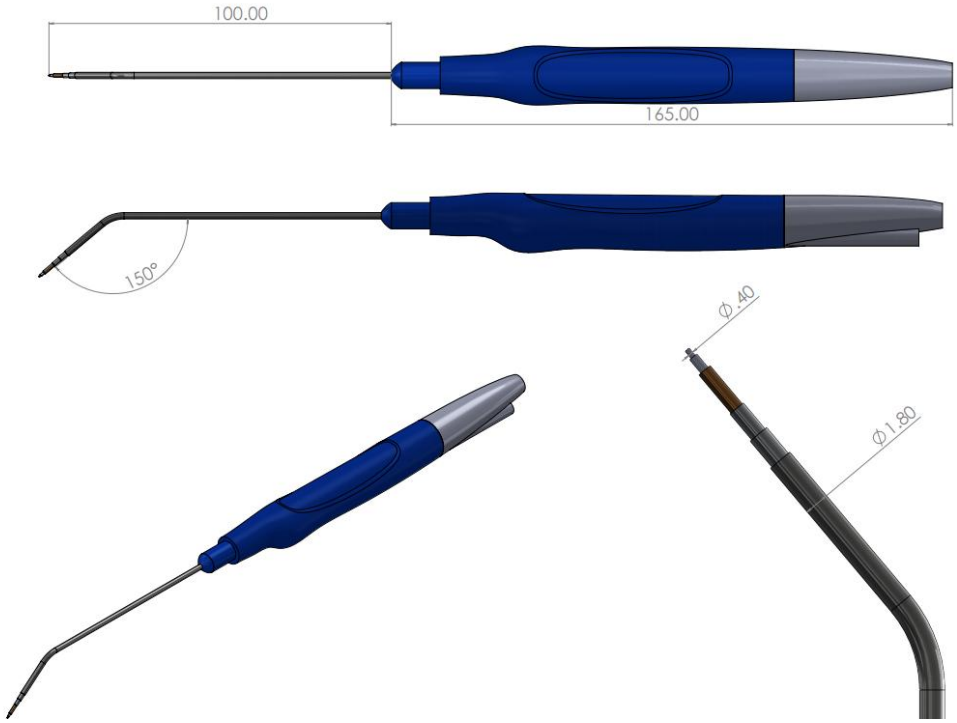


Av. Zacatecas #128, Constituyentes del 17
San Nicolás de los Garza, CP 66410
Nuevo León, México.

Tel. 81 2752 6075
81 8688 9100
servicio@arthromed.mx