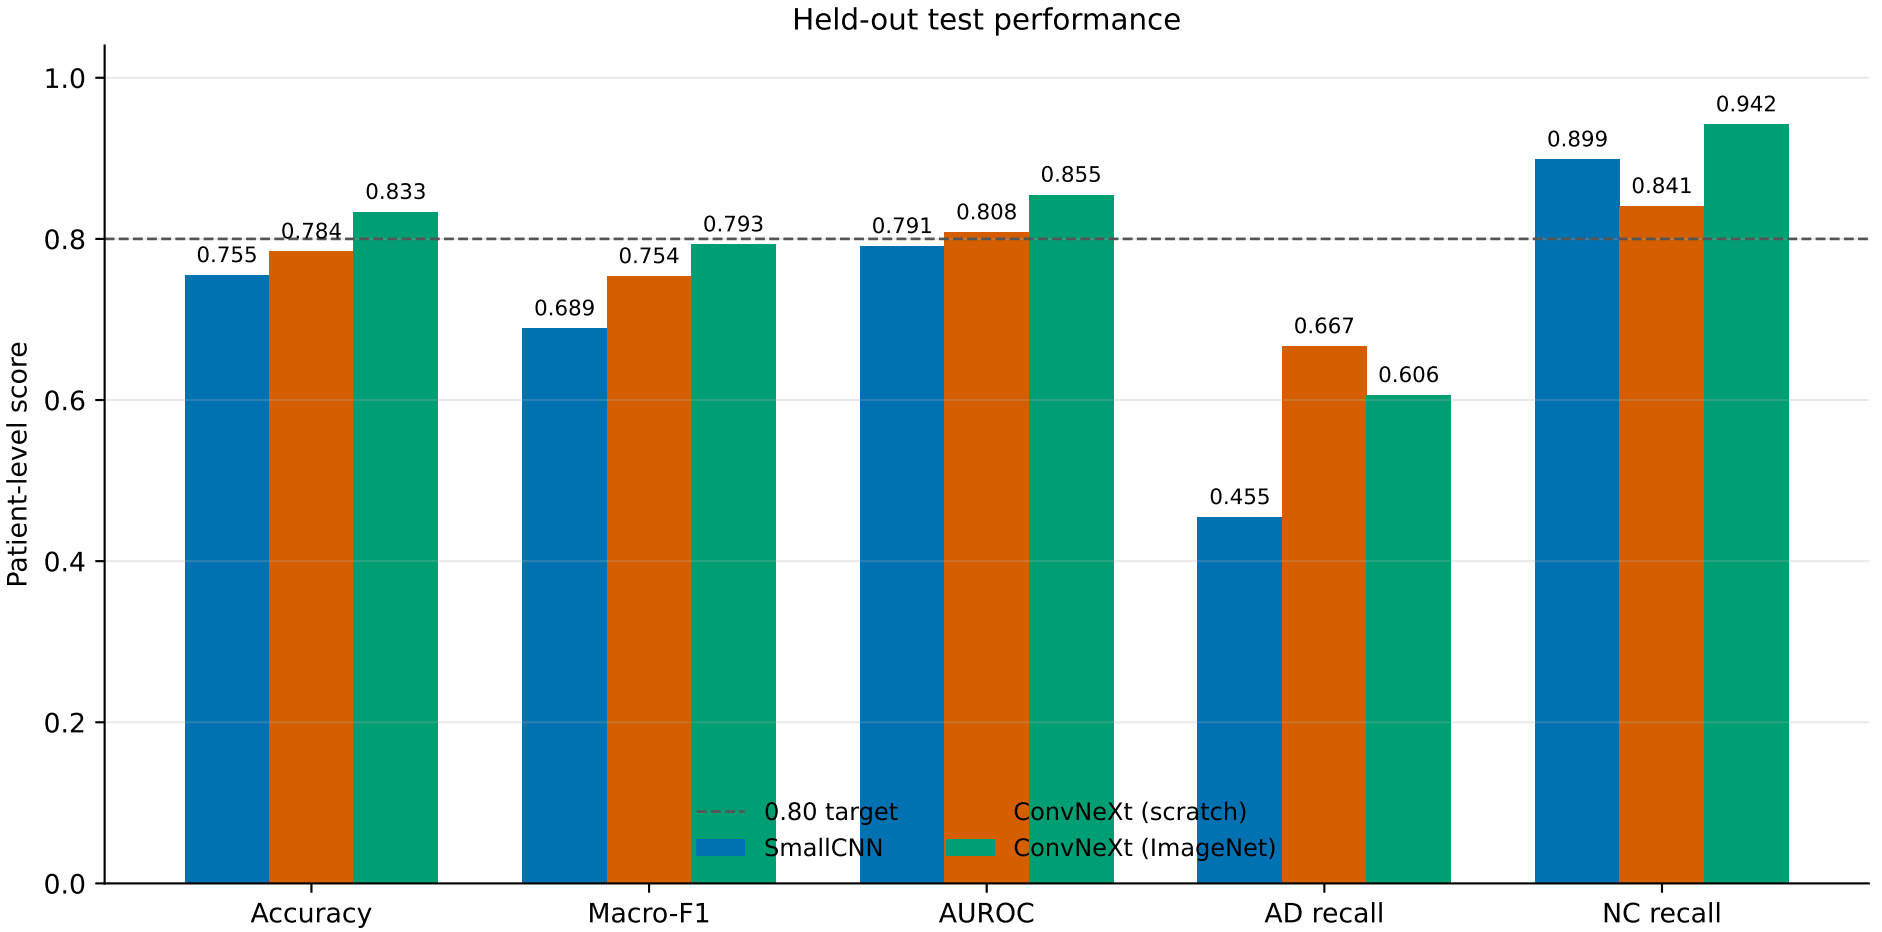
Held-out test performance
Patient-level score
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
0.755
0.784
0.833
0.689
0.754
0.793
0.791
0.808
0.855
0.455
0.667
0.606
0.899
0.841
0.942
0.80 target
SmallCNN
ConvNeXt (scratch)
ConvNeXt (ImageNet)
Accuracy
Macro-F1
AUROC
AD recall
NC recall