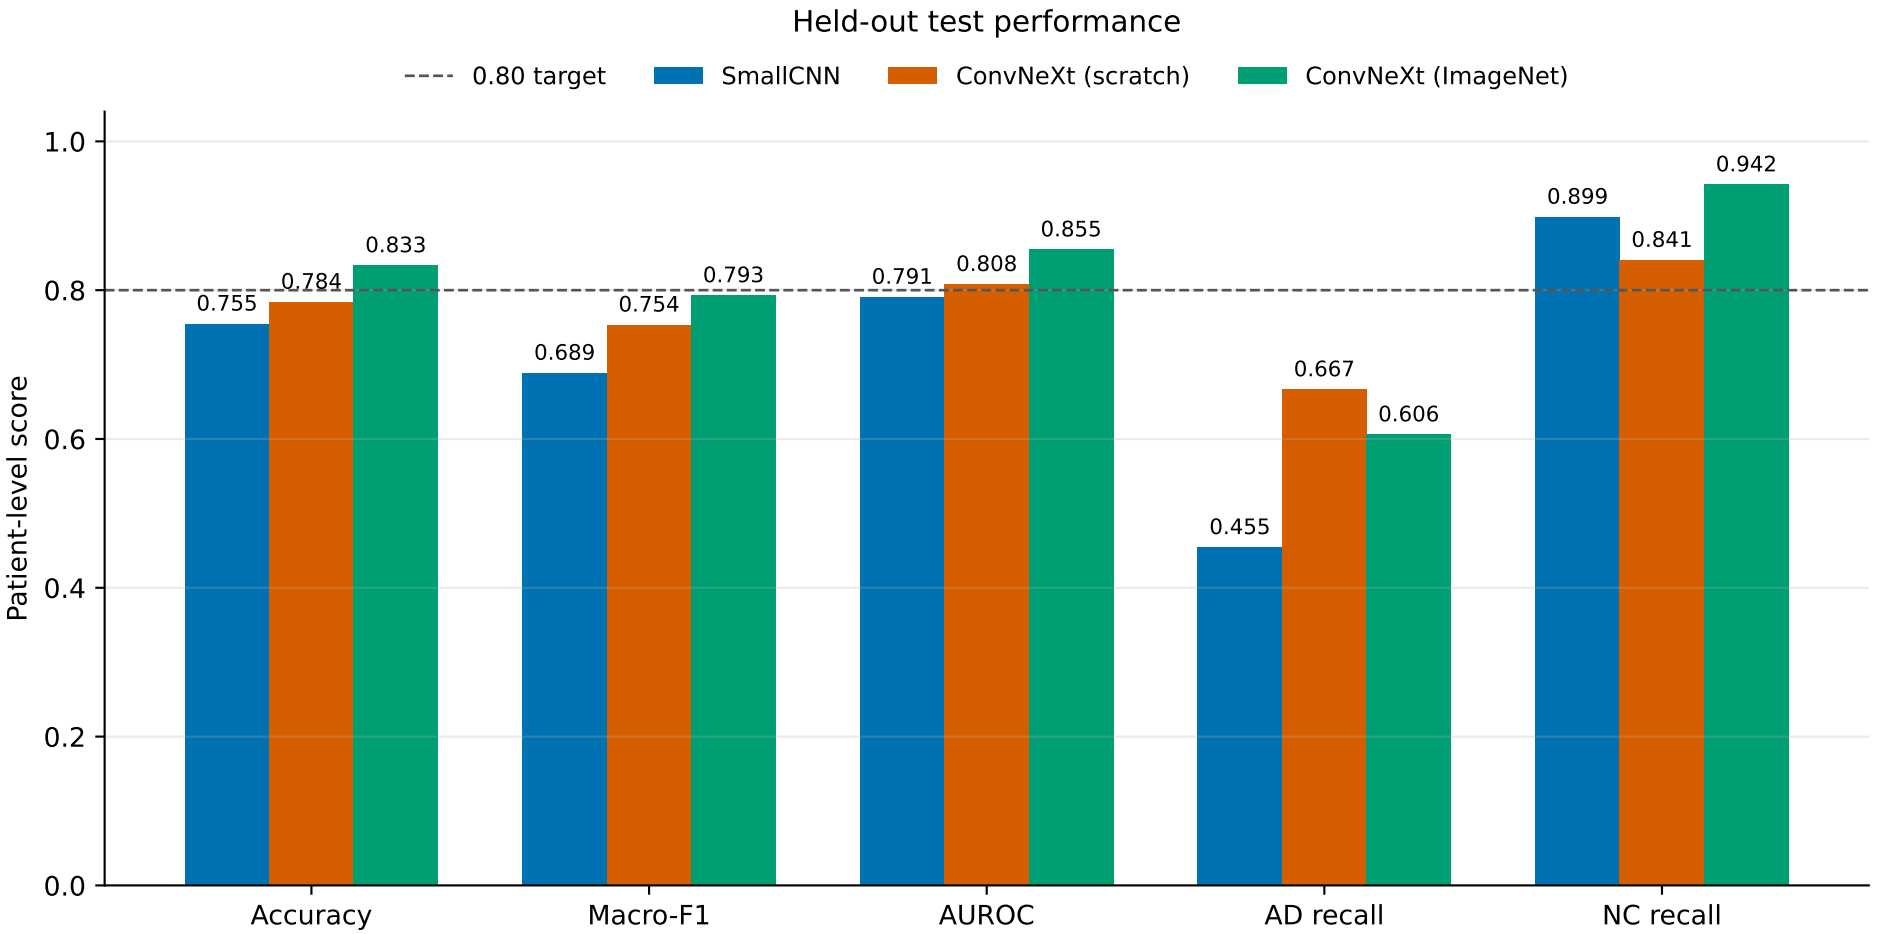
Held-out test performance
0.80 target
SmallCNN
ConvNeXt (scratch)
ConvNeXt (ImageNet)
Patient-level score
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
0.755
0.784
0.833
0.689
0.754
0.793
0.791
0.808
0.855
0.455
0.667
0.606
0.899
0.841
0.942
Accuracy
Macro-F1
AUROC
AD recall
NC recall