


COSY\_ncl DMSO {C:\Data\MSc} Macnab 46

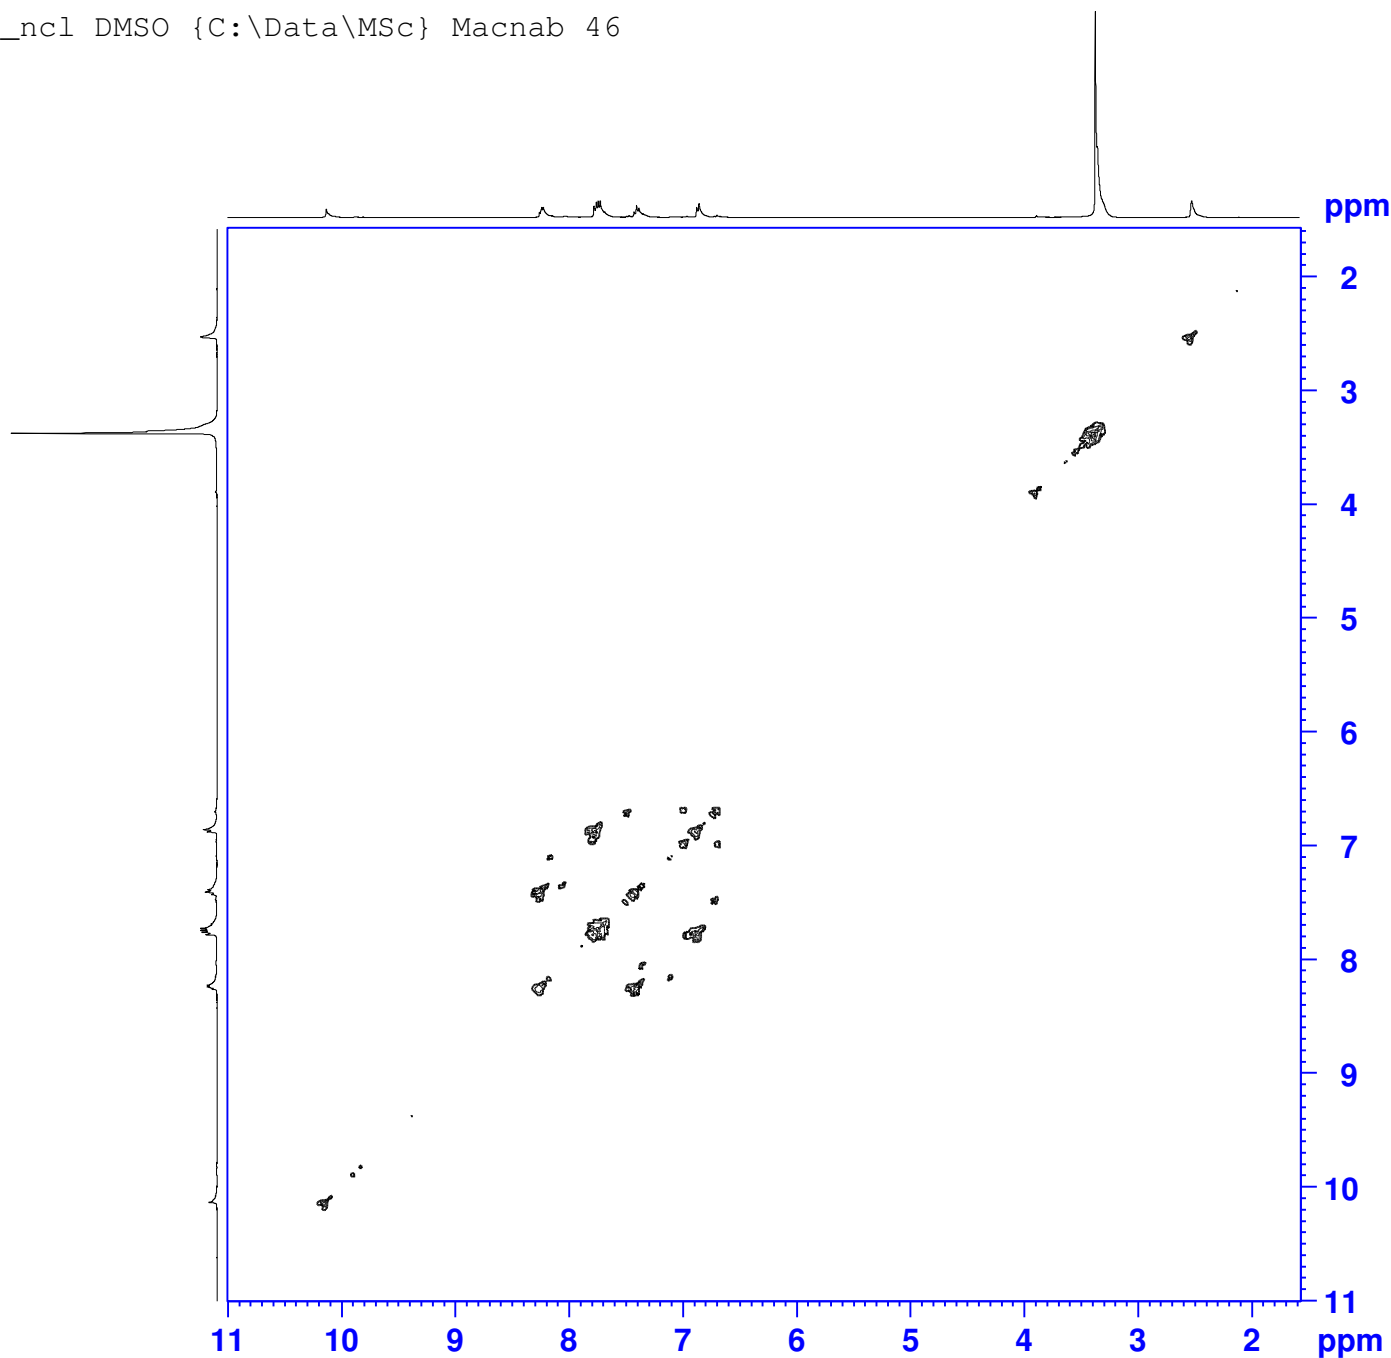

Current Data Parameters  
NAME EMKM-51P1  
EXPNO 11  
PROCNO 1

F2 - Acquisition Parameters  
Date\_ 20190809  
Time 9.50  
INSTRUM spect  
PROBHD 5 mm PABBO BB/  
PULPROG cosygpppqf  
TD 2048  
SOLVENT DMSO  
NS 1  
DS 8  
SWH 3770.739 Hz  
FIDRES 1.841181 Hz  
AQ 0.2715648 sec  
RG 128  
DW 132.600 usec  
DE 6.50 usec  
TE 298.0 K  
D0 0.00000300 sec  
D1 1.90497303 sec  
D11 0.03000000 sec  
D12 0.00002000 sec  
D13 0.00000400 sec  
D16 0.00020000 sec  
IN0 0.00026520 sec

===== CHANNEL f1 =====  
SF01 399.7825141 MHz  
NUC1 1H  
P0 15.00 usec  
P1 15.00 usec  
P17 2500.00 usec  
PLW1 13.00000000 W  
PLW10 3.25000000 W

===== GRADIENT CHANNEL =====  
GPNAM[1] SMSQ10.100  
GPZ1 10.00 %  
P16 1000.00 usec

F1 - Acquisition parameters  
TD 256  
SF01 399.7825 MHz  
FIDRES 14.729449 Hz  
SW 9.432 ppm  
FnMODE QF

F2 - Processing parameters  
SI 1024  
SF 399.7800000 MHz  
WDW QSINE  
SSB 0  
LB 0 Hz  
GB 0  
PC 1.40

F1 - Processing parameters  
SI 1024  
MC2 QF  
SF 399.7800000 MHz  
WDW QSINE  
SSB 0  
LB 0 Hz  
GB 0