


Proton_8_ncl.icon CDCl3 {C:\Data\MSc} Macnab 25

7.56
7.56
7.55
7.54
7.54
7.53
7.52
7.52
7.51
7.51
7.50
7.49
7.44
7.42
7.34
7.32
7.31
7.30
7.29
7.28
7.27
7.26
7.25
7.24
7.21
7.18
7.18
7.17
7.15
7.09
7.06
6.97
6.96
6.95
6.94
6.93
6.92
6.90
6.88
6.87
6.84
5.31
3.93
3.90
3.89
3.86
3.84
3.83
3.81
3.80
3.79
3.78
3.77
3.76
3.75
3.74
2.19

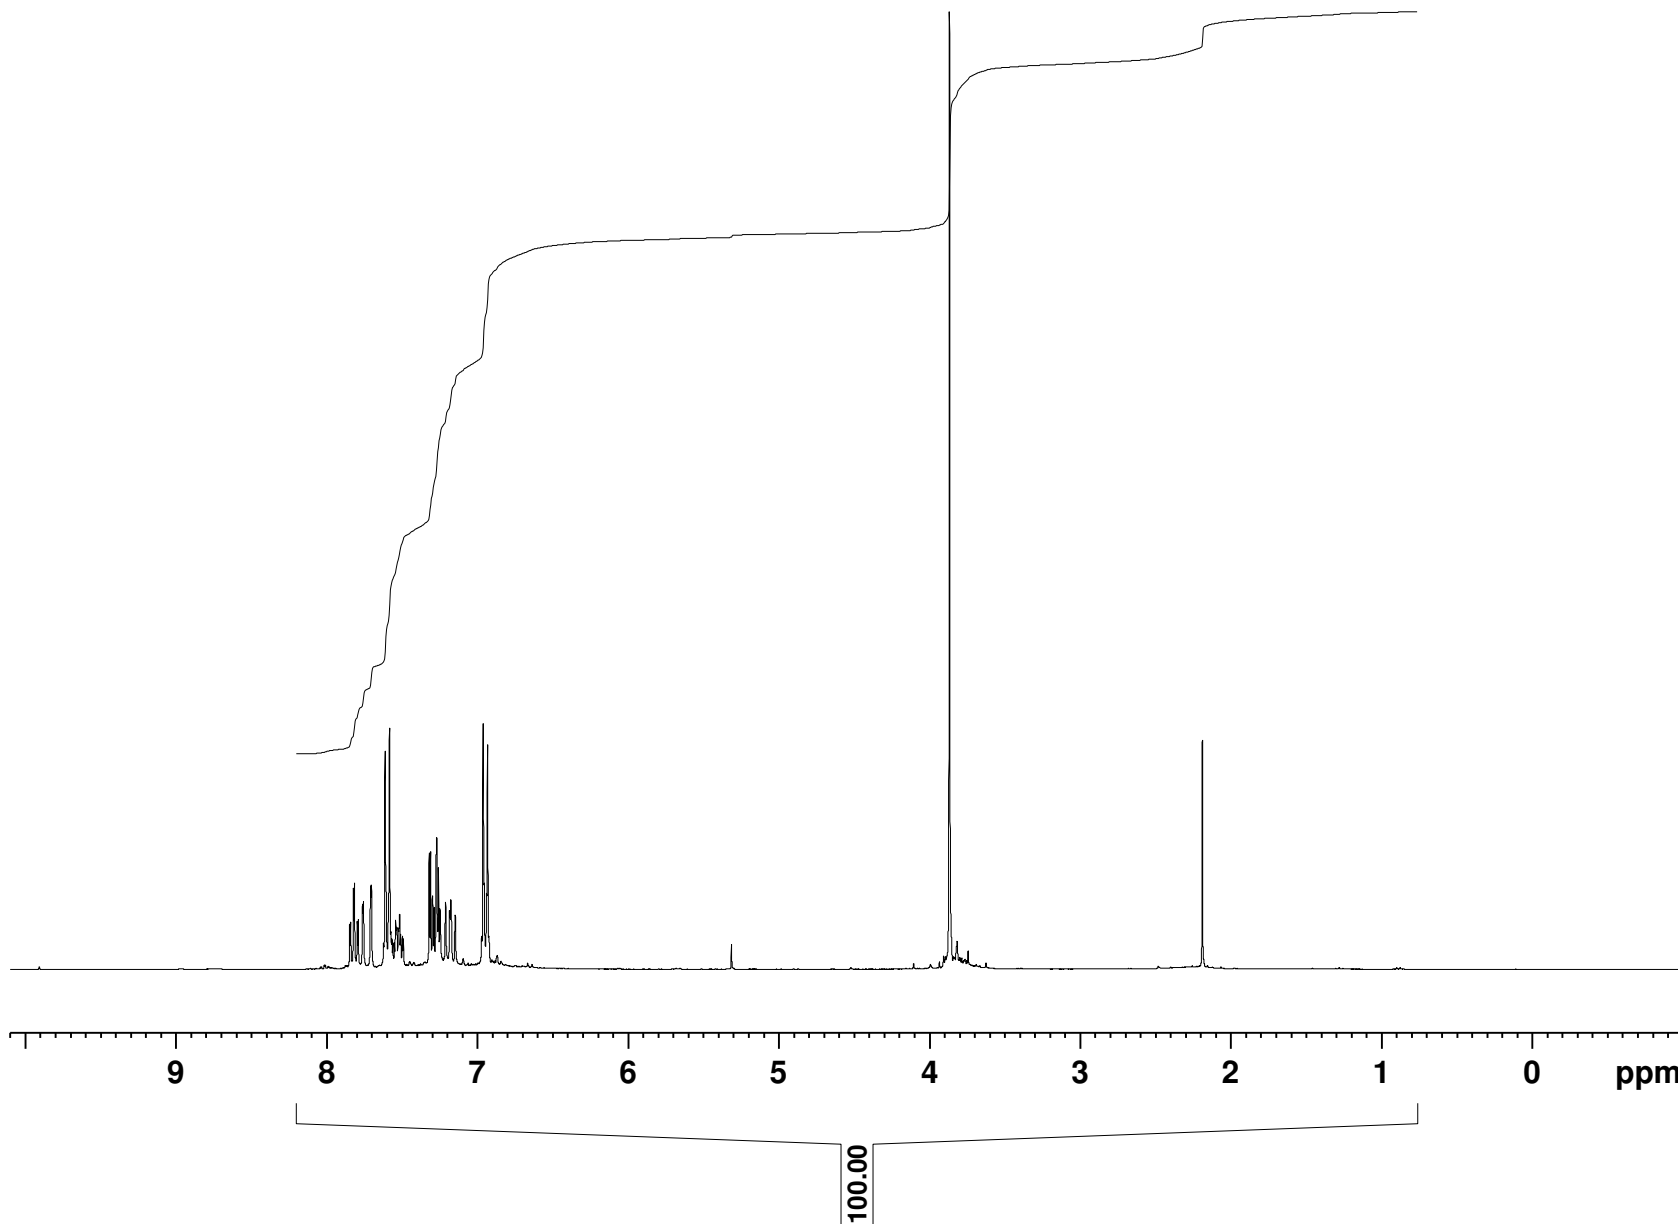

Current Data Parameters
NAME EMKM-45RM
EXPNO 1
PROCNO 1

F2 - Acquisition Parameters
Date_ 20190730
Time 10.06
INSTRUM AVIII300
PROBHD 5 mm PABBO BB-
PULPROG zgpg30
TD 65536
SOLVENT CDCl3
NS 8
DS 0
SWH 6002.401 Hz
FIDRES 0.091589 Hz
AQ 5.4591489 sec
RG 52.19
DW 83.300 usec
DE 13.05 usec
TE 298.0 K
D1 0.10000000 sec
TD0 1

===== CHANNEL f1 =====
SF01 300.1321009 MHz
NUC1 1H
P1 13.25 usec
PLW1 7.62960005 W

F2 - Processing parameters
SI 131072
SF 300.1300000 MHz
WDW EM
SSB 0
LB 0.20 Hz
GB 0
PC 1.00