



AZECOLAB
RELIABLE DATA - SOUND DECISION!

AZECOLAB COMPANY LLC

Salyan Highway 32, St5/b25, Sabail d, Baku,
AZ1023, Azerbaijan
Tel: +99412 3100200/3100300
E-mail: calibration@azecolab.com
Website: www.azecolab.com



KALİBRASIYA SERTİFİKATI
Calibration Certificate

0238K-0425-00023

Cihazın sahibi/ ünvanı:

Customer/ adress

PRIME COTTON

Qafqaz Biznes Mərkəzi, H.Əliyev pr., 95; AZ1029; Bakı, Azərbaycan

Sifariş nömrəsi:

Order no

23219-02

Cihaz:

Device

Thermometer

İstehsalçı:

Manufacture

Testo

Tip:

Type

Testo 635

Seriya nömrəsi:

Serial number

64622733

Etiket nömrəsi (daxili):

Label number (internal)

Kalibrasiya tarixi:

Date of calibration

22.04.2025

Sertifikatın səhifə sayı:

Number of pages of the Certificate

3

Bu kalibrasiya sertifikatı, Beynəlxalq Vahidlər Sisteminə əsaslanan beynəlxalq standartlarla izlənilə bilinir.

This calibration certificate documents the traceability to national standards, which realize the unit of measurement according to the International System of Units (SI).

Kalibrasiya laboratoriyası olaraq fəaliyyət göstərən Azecolab Company LLC, TÜRKAK'tan AB-0238-K ilə TS EN ISO/IEC 17025:2017 standardına görə akreditə edilmişdir.

Azecolab Company LLC accredited by TÜRKAK under registration number AB-0238-K for TS EN ISO/IEC 17025:2017 as Calibration Laboratory.

Türk Akreditə Qurumu(TÜRKAK) kalibrasiya sertifikatlarının tanınması barədə Avropa Akreditə Birliyi (EA) ilə çox tərəfli razılaşma və Beynəlxalq Laboratoriya Akreditə Birliyi(ILAC) ilə qarşılıqlı tanıma razılaşması imzalamışdır.

Turkish Accreditation Agency (TURKAK) is a signatory to the European cooperation for Accreditation (EA) Multilateral Agreement (MLA) and to the International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) Mutual Recognition Arrangement (MRA) for the recognition of calibration certificates

Ölçüm nəticələri, genişləndirilmiş ölçüm qeyri-müəyyənliyi və kalibrasiya metodları bu sertifikatın tamamlayıcı qismi olan növbəti səhifələrdə verilmişdir.

The measurements, the uncertainties with confidence probability and calibration methods are given on the following pages which are part of this certificate.

Möhür
Seal



Yayın tarixi:
Issue date

01/05/2025

Kalibrasiyanı icra edən:
Calibrated by

Tarana Afandiyeva

Calibration Responsible

Təsdiq edən/ Approval
Tarix/ Date

Abulfat Karimov

QC Manager

01/05/2025

Bu sertifikatın natamam şəkli laboratoriyanın icazəsi olmadan çoxaldıla və ya təqdim edilməz. İmzasız və möhürsüz sertifikatlar etibarlı deyil.
This certificate shall not be reproduced other than in full except with the permission of the laboratory. Calibration certificates without signature and seal are not valid.

1. Cihaz haqqında məlumatlar

Information About The object

Oxunabilirlik/ Görüntü imkanı:

0.1 °C

Sensorun Tipi

K type

Scale division /Resolution:

Type of probe

2. Kalibrasiya metodu

Calibration method

Cihaz Temperatur dry blok kalibratorda Azecolab SOP 8017 -yə əsasən qarşılaşdırma metodu ilə kalibrasiya edilmişdir

Devices was calibrated by comparison method in dry block calibrator according to Azecolab SOP8017.

3. Kalibrasiyada istifadə olunan referens cihazlar

The references which are used at calibration

İstinad cihaz Reference device	Serial nömrəsi Serial number	Sertifikat nömrəsi Certificate number	Son kalibrənmə tarixi Last calibration date	İzləniləbilirlik Traceability
ET Reference Plus	D18171016 / E9351	2423641	08/05/24	AB-0012-K
Thermohygrometer	581502	2423632	07/05/24	AB-0012-K

4. Kalibrasiyanın edildiyi yer/ Place of calibration

CalLab

5. Ətraf mühit şərtləri/ Environmental Conditions

Havanın temperaturu 22.5 °C

Nəmlilik : 49 %rh

Ambient temperature

Humidity

6. Ümumi yoxlanış / General inspection

Vizual yoxlanış:

Visual check:

uyğun/applicable

Funksional yoxlanış

Functional check

uyğun/applicable

7. Ölçüm nəticələri/ Measurement results

Referans Cihaz Ortalama Dəyəri Ref. Device Average Value	Test cihazı ortalama dəyəri Test Device Average Value	Sapma / Deviation	Ölçüm qeyri müəyyənliyi Measurement Uncertainty
°C	°C	°C	±°C
-10.17	-10.40	-0.23	0.28
15.08	15.00	-0.08	0.28
30.04	29.80	-0.24	0.28

8. Ölçüm qeyri müəyyənliyi / Measurement uncertainty

Digər səhifələrdə verilmişdir / Given in the following pages

AZECOLAB COMPANY LLC

Paage 3/3

0238K-0425-00023

8. Ölçüm qeyri müəyyənliyi / Measurement uncertainty

Qeyd olunan genişlədirilmiş qeyri-müəyyənlik standart qeyri-müəyyənliyin $k=2$ faktoru ilə hasilindən əldə edilərək normal paylanma üçün 95% əminlik təşkil edir.

The reported expanded uncertainty of measurement is stated as the standard uncertainty of measurement multiplied by the coverage factor $k=2$ which for a normal distribution corresponds to a coverage probability of approximately 95%.

9. Qərar qaydasının təsviri (uyğunluq bəyanatına müştəri tələbi olarsa).

Definition of Decision Rule (when conformity assessment is requested by customer).

10. Qeydlər/ notes

Bu sertifikatdakı test nəticələri yalnız testlərin icra oldunduğu tarixində cihazın vəziyyətinə aiddir.

Statement: The reported test results in this certificate refer to the condition of the instrument on the test date.

11. Cihazın vəziyyəti ilə bağlı digər qeydlər:

Other notes related to the instrument condition:

12. İmtina bəyanatı/ Disclaimer

Müştəri tərəfindən təmin edilmiş məlumatların düzgünlüyünə və dəqiqliyinə müştəri məsuliyyət daşıyır.

Correctness and accuracy of information provided by customer is the responsibility of the customer.

-THE END OF THE CERTIFICATE-



AZECOLAB
RELIABLE DATA - SOUND DECISION!

AZECOLAB COMPANY LLC

Salyan Highway 32, St5/b25, Sabail d, Baku,
AZ1023, Azerbaijan
Tel: +99412 3100200/3100300
E-mail: calibration@azecolab.com
Website: www.azecolab.com



TURKAK BDS NO
K-BE30-0AA0

KALİBRASIYA SERTİFİKATI

Calibration Certificate

0238K-0425-00022

Cihazın sahibi/ ünvanı:

Customer/ adress

PRIME COTTON

Qafqaz Biznes Mərkəzi, H.Əliyev pr., 95; AZ1029; Bakı, Azərbaycan

Sifariş nömrəsi:

Order no

23219-01

Cihaz:

Device

Termohygrometer

İstehsalçı:

Manufacture

Testo

Tip:

Type

Testo 635

Seriya nömrəsi:

Serial number

64622733

Kalibrasiya tarixi:

Date of calibration

17.04.2025

Sertifikatın səhifə sayı:

Number of pages of the Certificate

3

Bu kalibrasiya sertifikatı, Beynəlxalq Vahidlər Sisteminə əsaslanan beynəlxalq standartlarla izlənilə bilinir.

This calibration certificate documents the traceability to national standards, which realize the unit of measurement according to the International System of Units (SI).

Kalibrasiya laboratoriyası olaraq fəaliyyət göstərən Azecolab Company LLC, TÜRKAK'tan AB-0238-K ilə TS EN ISO/IEC 17025:2017 standardına görə akreditə edilmişdir.

Azecolab Company LLC accredited by TÜRKAK under registration number AB-0238-K for TS EN ISO/IEC 17025:2017 as Calibration Laboratory.

Türk Akreditə Qurumu(TÜRKAK) kalibrasiya sertifikatlarının tanınması barədə Avropa Akreditə Birliyi (EA) ilə çox tərəfli razılaşma və Beynəlxalq Laboratoriya Akreditə Birliyi(ILAC) ilə qarşılıqlı tanıma razılaşması imzalamışdır.

Turkish Accreditation Agency (TURKAK) is a signatory to the European cooperation for Accreditation (EA) Multilateral Agreement (MLA) and to the International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) Mutual Recognition Arrangement (MRA) for the recognition of calibration certificates

Ölçüm nəticələri, genişləndirilmiş ölçüm qeyri-müəyyənliyi və kalibrasiya metodları bu sertifikatın tamamlayıcı qismi olan növbəti səhifələrdə verilmişdir.

The measurements, the uncertainties with confidence probability and calibration methods are given on the following pages which are part of this certificate.

Möhür:

Seal

Yayın tarixi:


Issue date

Kalibrasiyanı icra edən:

Calibrated by

Təsdiq edən/ Approval

Tarix/ Date

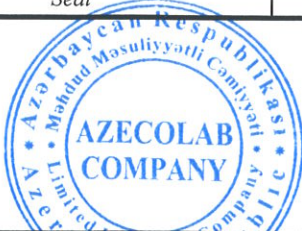

Araz Asgarli

Laboratory Manager

Abulfat Karimov

QC Manager

01/05/2025

01/05/2025

Bu sertifikatın nəfəsinə şəkli laboratoriyanın icazəsi olmadan çoxaldıla və ya təqdim edilməz. İmzasız və möhürsüz sertifikatlar etibarlı deyil.

This certificate shall not be reproduced other than in full except with the permission of the laboratory. Calibration certificates without signature and seal are not valid.

1. Cihaz haqqında məlumatlar

Information About The object

Oxunabilirlik/ Görüntü imkanı:	Temperature:	0.1 °C
Scale division /Resolution:	Humidity:	0.1 % rh

2. Kalibrasiya metodu

Calibration method

Cihaz Temperatur Nəm kabinetində Azecolab SOP 8020 -ə əsasən qarşılaşdırma metodu ilə kalibrasiya edilmişdir.

Devices was calibrated by comparison method in climatic chamber according to Azecolab SOP8020.

3. Kalibrasiyada istifadə olunan referens cihazlar

The references which are used at calibration

İstinad cihaz Reference device	Serial nömrəsi Serial number	Sertifikat nömrəsi Certificate number	Son kalibrənmə tarixi Last calibration date	İzləniləbilirlik Traceability
Thermohygrometer Vaisala	V0310059	2423646	31/05/24	AB-0012-K
Reference thermometer/ ETI reference plus	D18171015	2423637	08/05/24	AB-0012-K

4. Kalibrasiyanın edildiyi yer/ Place of calibration

Laboratory

5. Ətraf mühit şərtləri/ Environmental Conditions

Havanın temperaturu: 22.6 °C Nəmlik : 44 %rh
Ambient temperature Humidity

6. Ümumi yoxlanış / General inspection

Vizual yoxlanış:

Visual check:

uyğun/applicable

Funksional yoxlanış

Functional check

uyğun/applicable

7. Ölçüm nəticələri/ Measurement results

Nəm/ Humidity

Referans Cihaz Ortalama Dəyəri Ref. Device Average Value		Test cihazı ort. dəyəri Test Device Average Value	Sapma / Deviation	Ölçüm qeyri müəyyənliyi Measurement Uncertainty
°C	%rh	%rh	%rh	%rh
20.00	20.2	20	0.3	3.7
20.00	49.2	49	-0.1	3.7
20.00	82.8	83	-0.3	3.7

8. Ölçüm qeyri müəyyənliyi / Measurement uncertainty

Digər səhifələrdə verilmişdir / Given in the following pages

Ölçüm nəticələri (Davamı)
Measurement results (Cont.)

Temperatur/ Temperature

Referans Cihaz Ortalama Dəyəri Ref. Device Average Value		Test cihazı ort. dəyəri Test Device Average Value	Sapma / Deviation	Ölçüm qeyri müəyyənliyi Measurement Uncertainty
%rh	°C	°C	°C	°C
50	15.53	15.6	0.05	0.3
50	20.62	20.7	0.08	0.3
50	29.60	29.7	0.10	0.3

8. Ölçüm qeyri müəyyənliyi / Measurement uncertainty
Qeyd olunan genişlədirilmiş qeyri-müəyyənlik standart qeyri-müəyyənliyin k=2 faktoru ilə hasilindən əldə edilərək normal paylanma üçür 95% əminlik təşkil edir.
The reported expanded uncertainty of measurement is stated as the standard uncertainty of measurement multiplied by the coverage factor k=2 whi for a normal distribution corresponds to a coverage probability of approximately 95%.

9. Qərar qaydasının təsviri (uyğunluq bəyanatına müştəri tələbi olarsa).
Definition of Decision Rule (when conformity assessment is requested by customer).

10. Qeydlər/ notes
Bu sertifikatdakı test nəticələri yalnız testlərin icra olduğu tarixində cihazın vəziyyətinə aiddir.
Statement: The reported test results in this certificate refer to the condition of the instrument on the test date.

11. Cihazın vəziyyəti ilə bağlı digər qeydlər:
Other notes related to the instrument condition:

12. İmtina bəyanatı/ Disclaimer
Müştəri tərəfindən təmin edilmiş məlumatların düzgünlüyünə və dəqiqliyinə müştəri məsuliyyət daşıyır.
Correctness and accuracy of information provided by customer is the responsibility of the customer.

-THE END OF THE CERTIFICATE-