


# Voltage\_fft

- △ DB(|Vfft(M\_PROBE.VP1,0,3,100,3,20,0,4,0)|) [\*] (L, dB)  
TD\_DMP\_Multi.AP\_TR.\$F\_SPEC
- DB(|Vfft(V\_METER.VM1,0,3,100,3,20,0,4,0)|) [\*] (R, dB)  
TD\_DMP\_Multi.AP\_TR.\$F\_SPEC

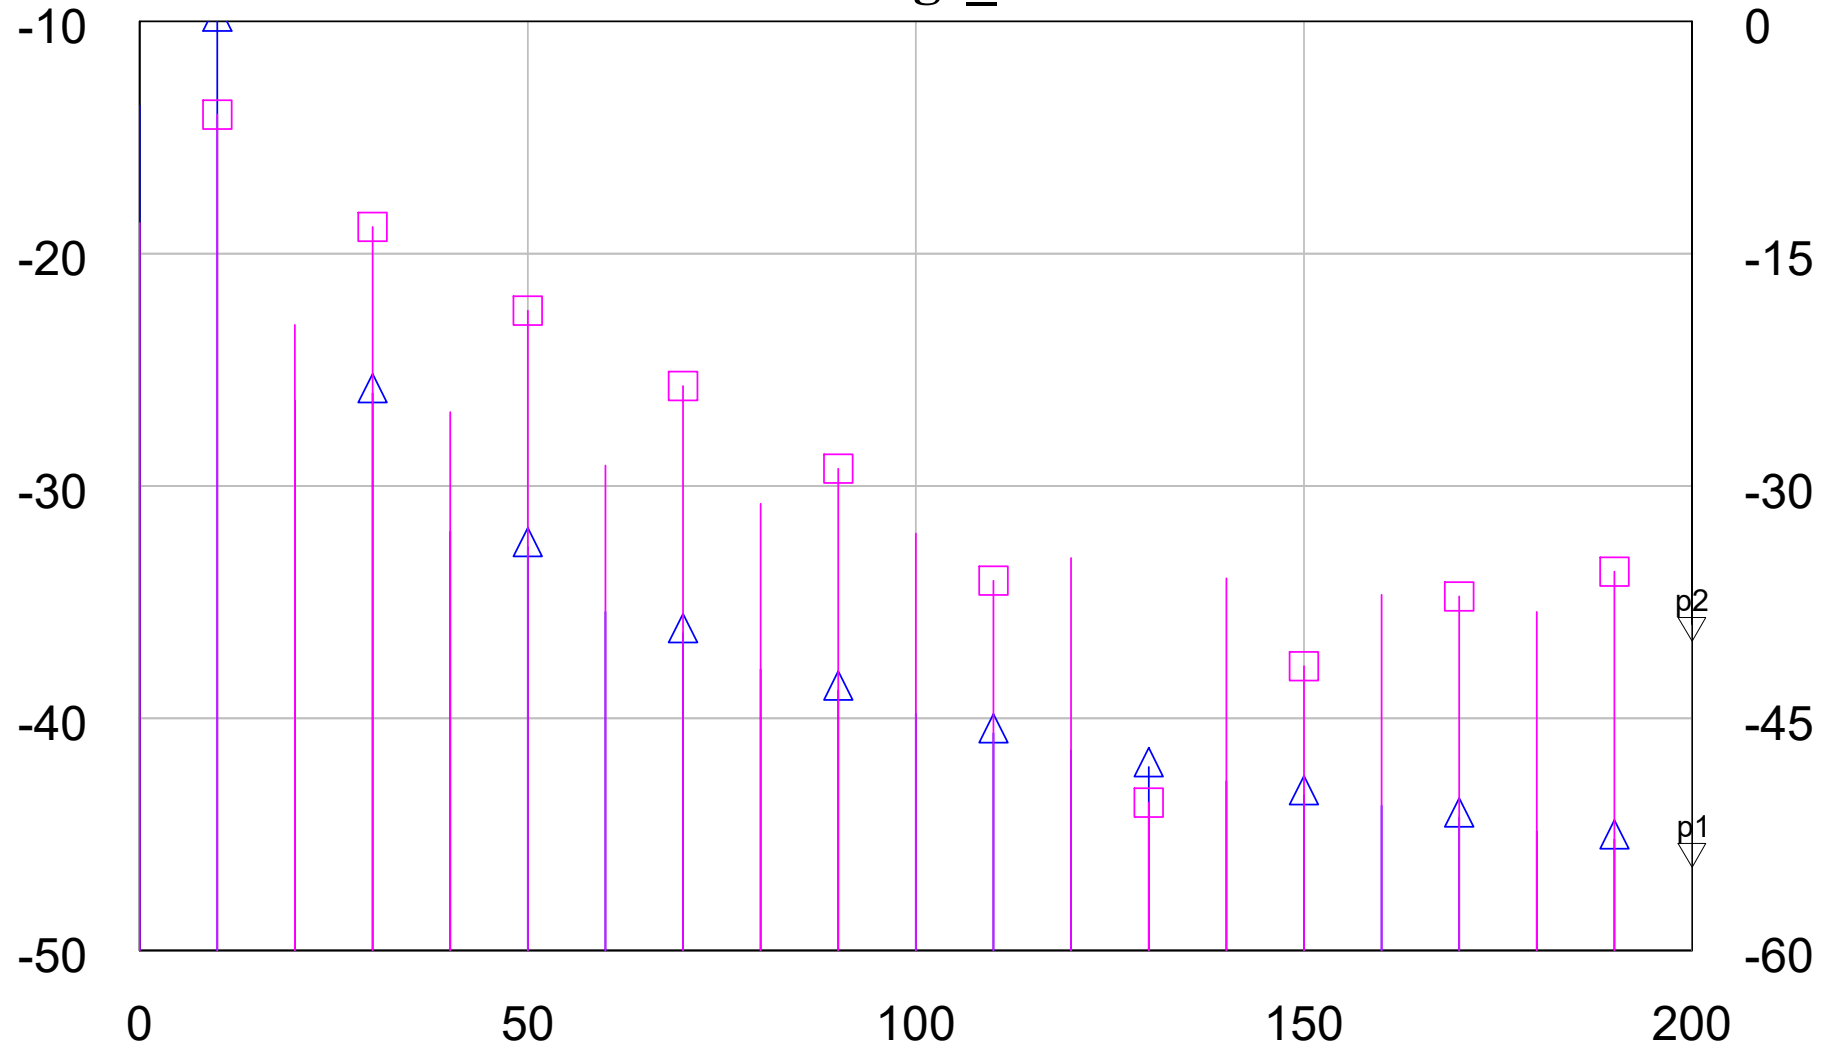

p1: FREQ = 10 MHz  
p2: FREQ = 10 MHz