


Voltage_fft

△ DB(|Vfft(M_PROBE.VP1,0,3,100,3,20,0,4,0)|)[*] (L, dB)
TD_DMP_Multi.AP_TR.\$F_SPEC

□ DB(|Vfft(V_METER.VM1,0,3,100,3,20,0,4,0)|)[*] (R, dB)
TD_DMP_Multi.AP_TR.\$F_SPEC

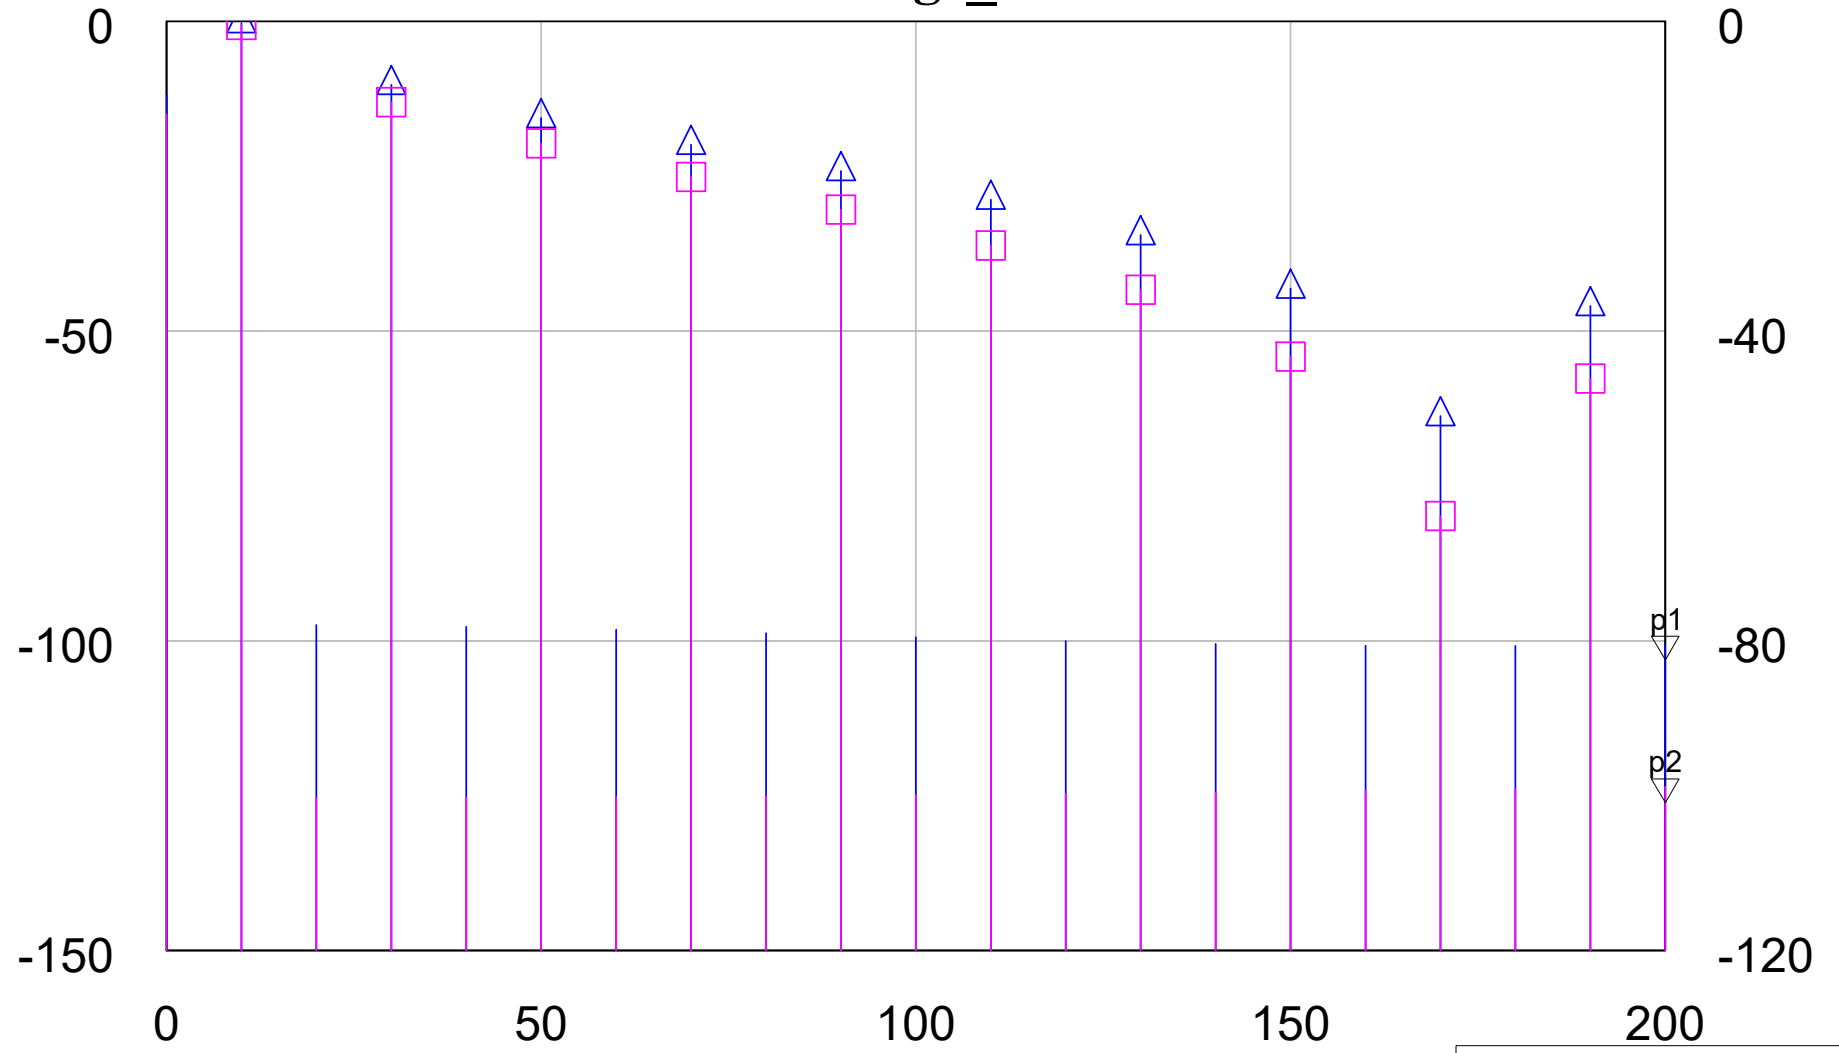

p1: FREQ = 10 MHz
p2: FREQ = 10 MHz