


TD_CMP_Vfft

◇ DB(|Vfft(M_PROBE.VP1,0,3,100,3,20,0,4,0))|[*] (L, dB)
TD_CMP_Multi.AP_TR.\$F_SPEC
□ DB(|Vfft(V_METER.VM1,0,3,100,3,20,0,4,0))|[*] (R, dB)
TD_CMP_Multi.AP_TR.\$F_SPEC

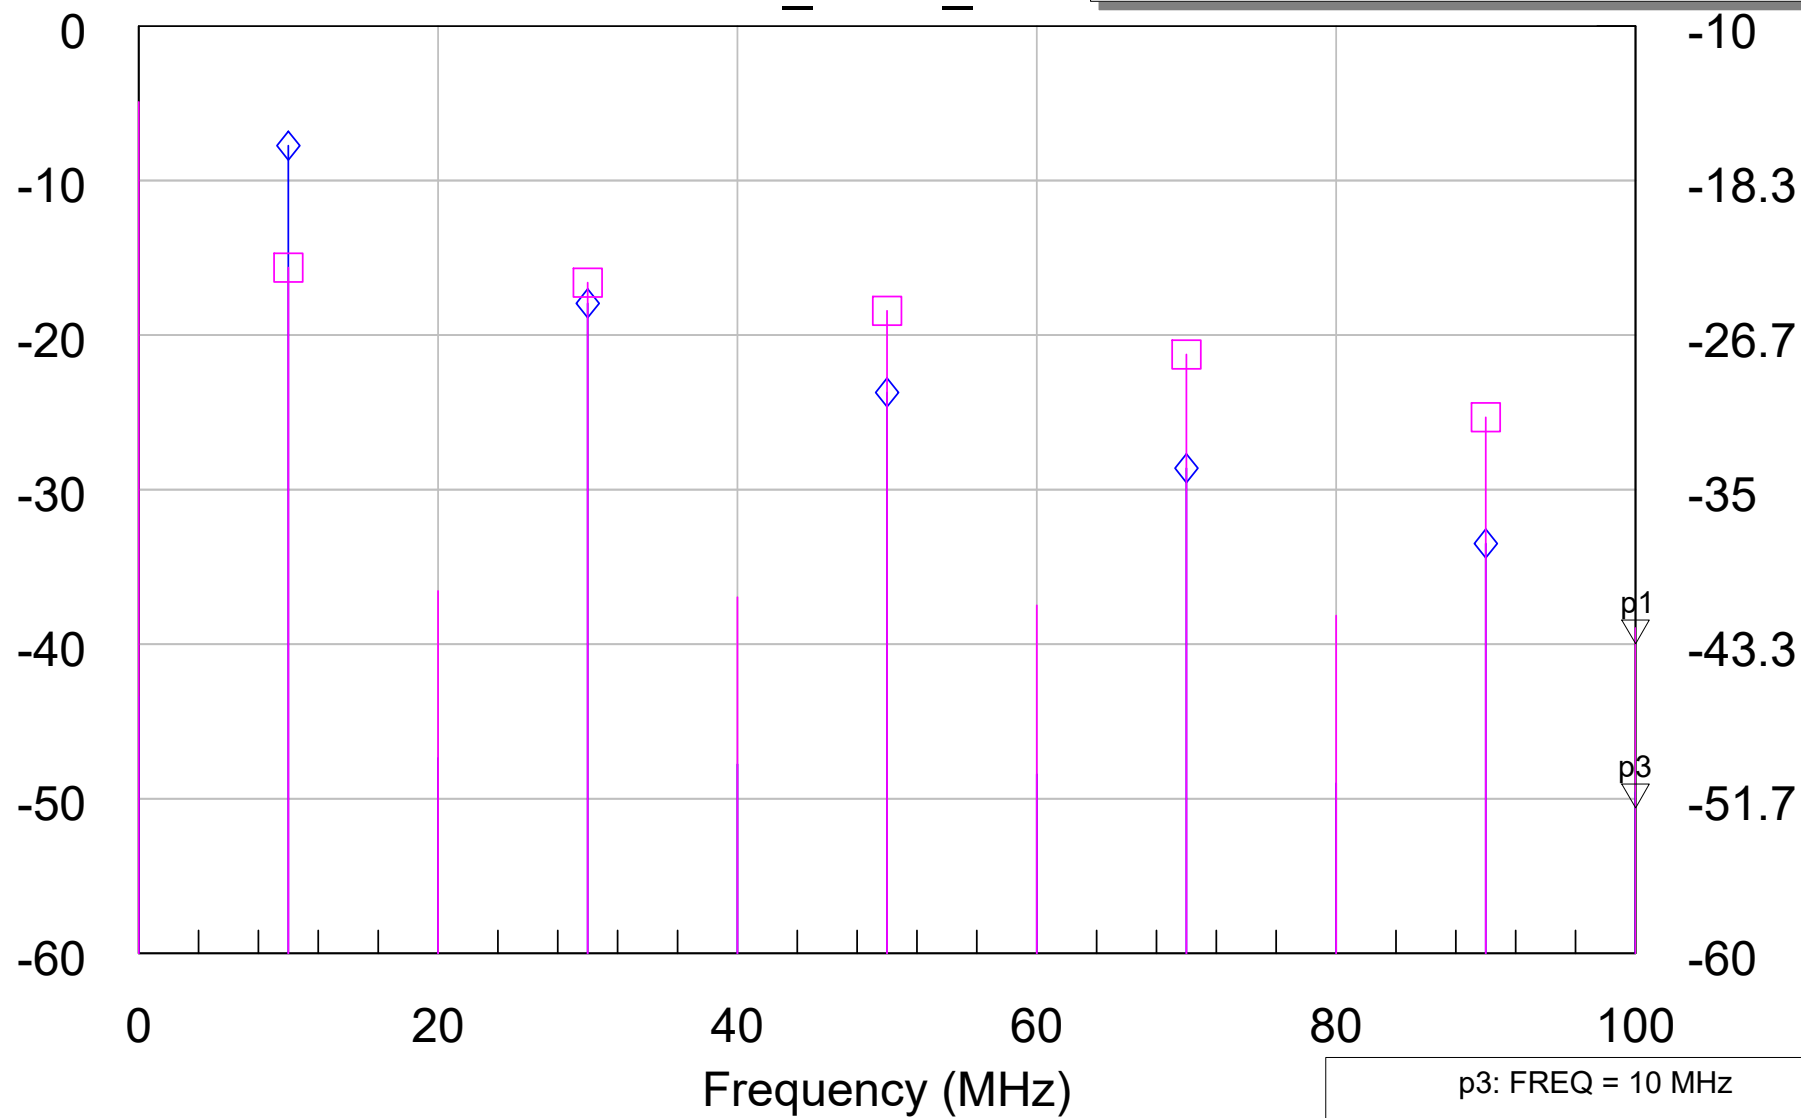

p3: FREQ = 10 MHz

p1: FREQ = 10 MHz