



EHT : 3 σ 判別のための誤差予算 (ring σ と $\kappa\sigma$ のトレードオフ ; $\kappa \approx 1$)

M87*

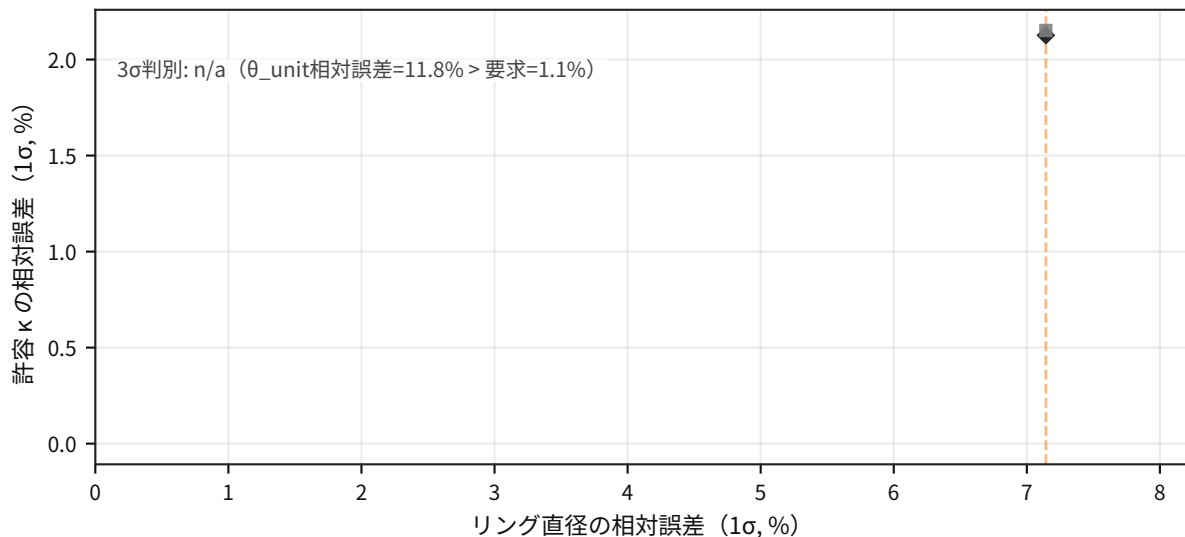

Sgr A*

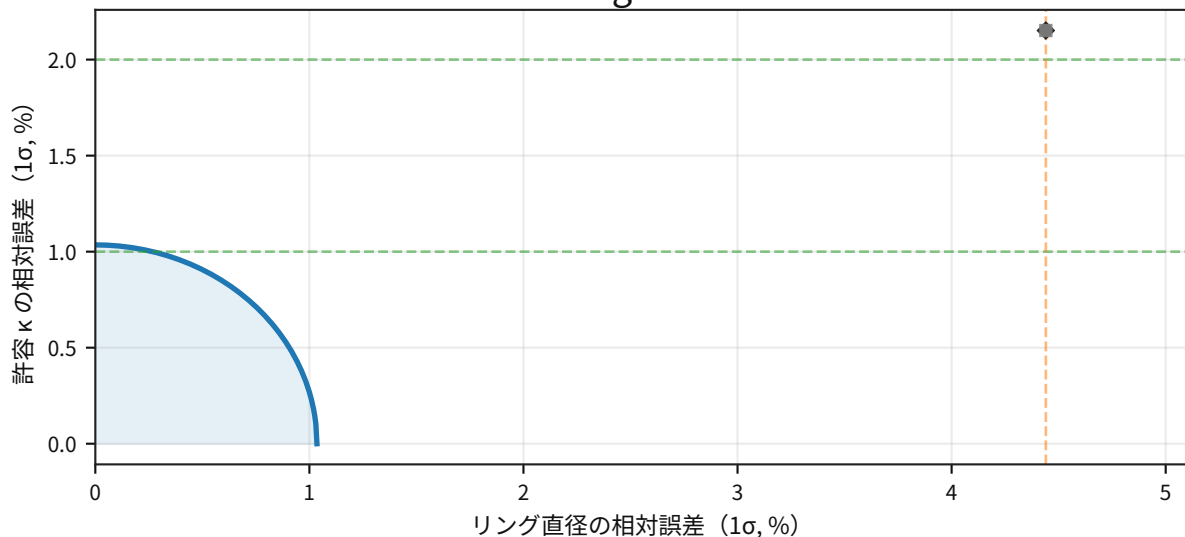

--- 現状 ring σ /diameter

■ 参考: Kerr κ 系統 (full)

◆ 参考: Kerr κ 系統 (constrained)

— 3 σ 判別の許容域 (下側)