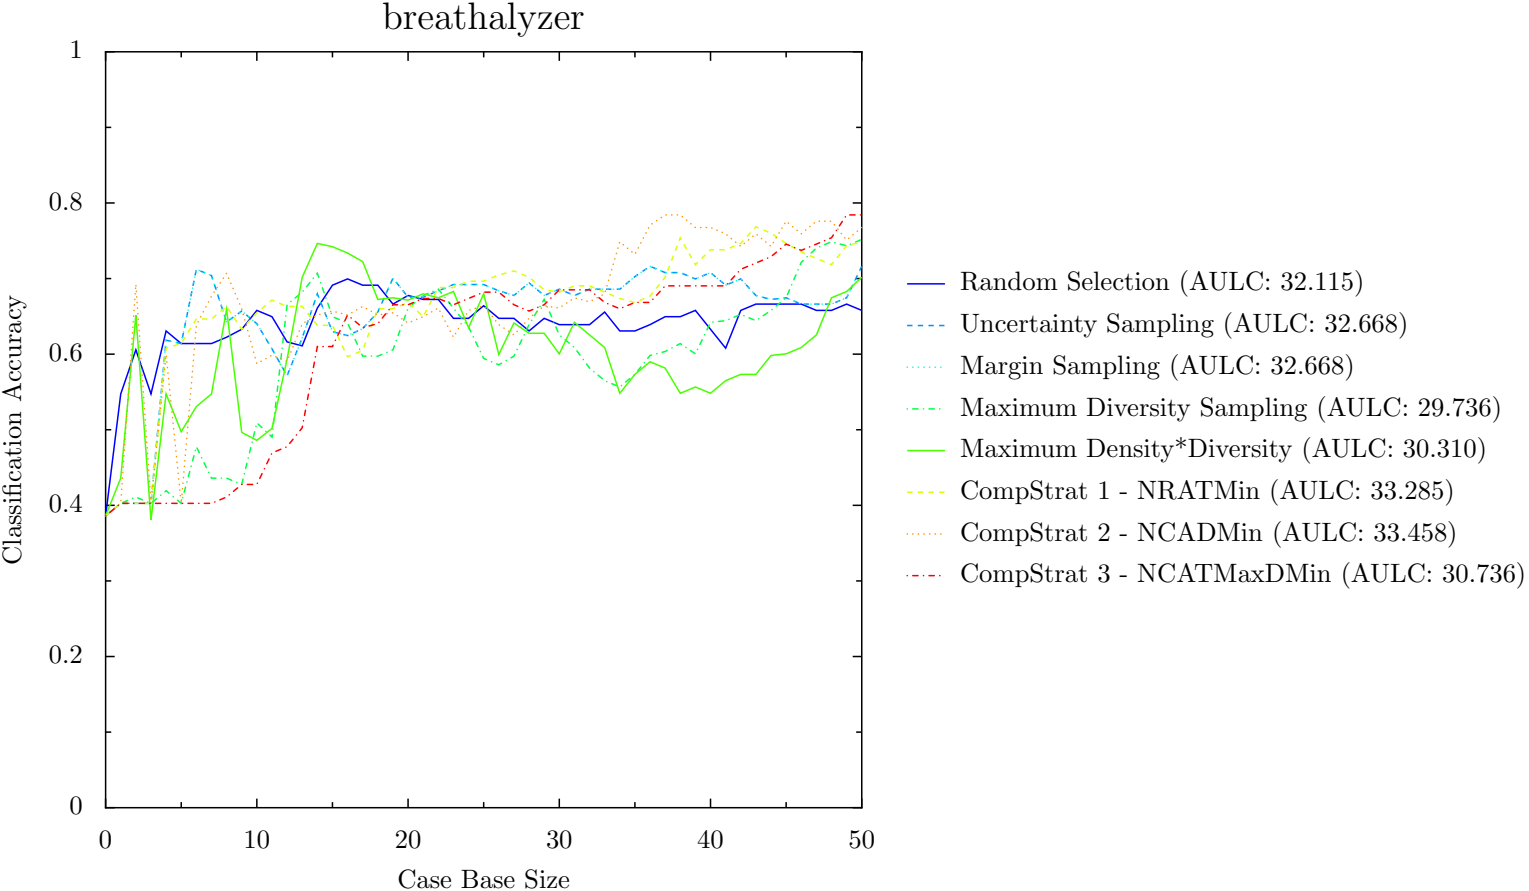
breathalyzer
Classification Accuracy
Case Base Size
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
0
10
20
30
40
50
Random Selection (AULC: 32.115)
Uncertainty Sampling (AULC: 32.668)
Margin Sampling (AULC: 32.668)
Maximum Diversity Sampling (AULC: 29.736)
Maximum Density*Diversity (AULC: 30.310)
CompStrat 1 - NRATMin (AULC: 33.285)
CompStrat 2 - NCADMin (AULC: 33.458)
CompStrat 3 - NCATMaxDMin (AULC: 30.736)