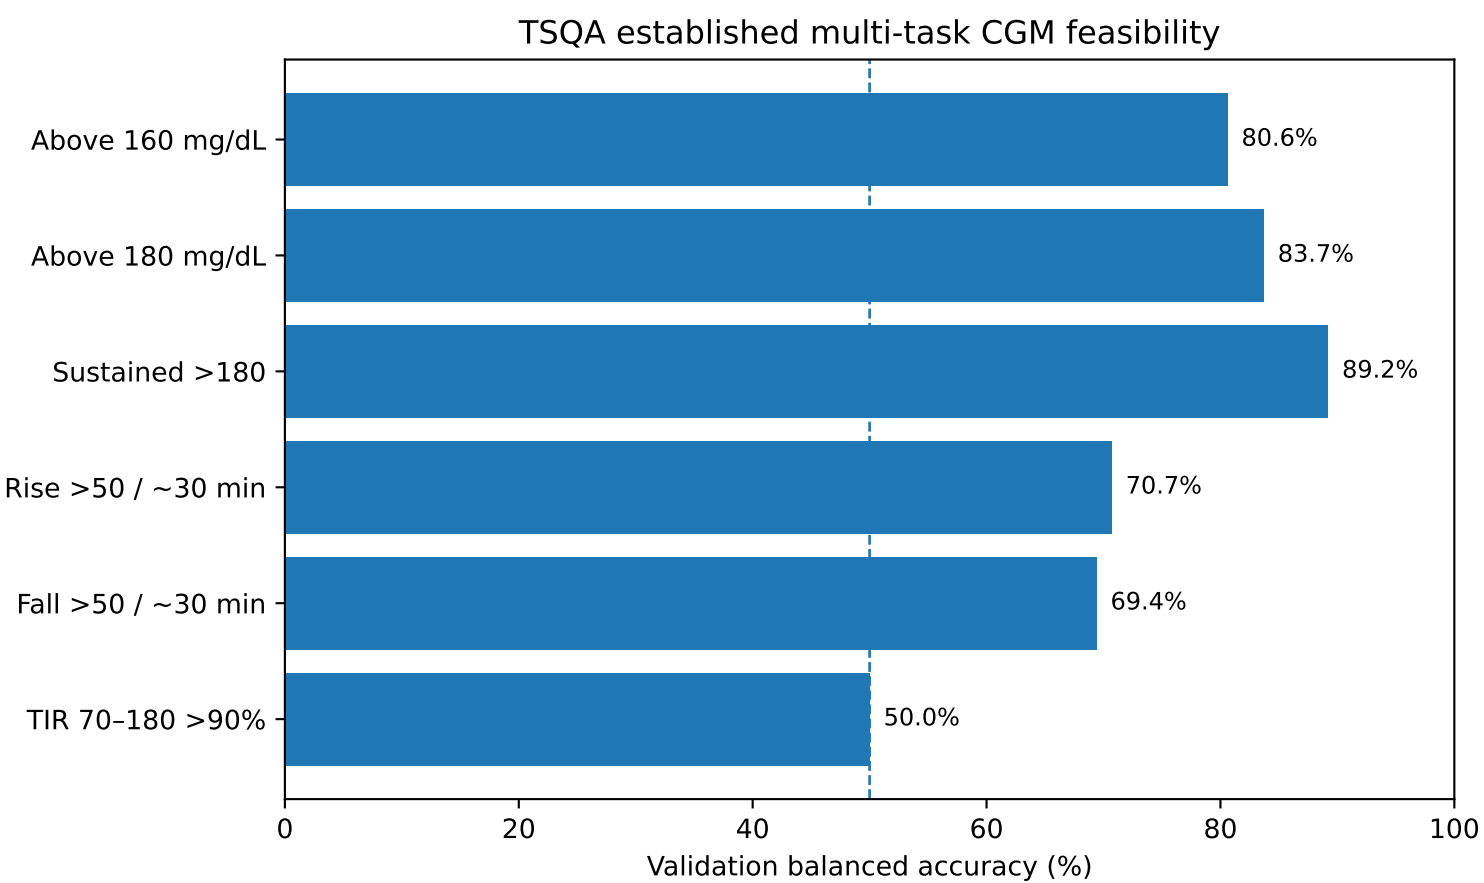
TSQA established multi-task CGM feasibility
Above 160 mg/dL
Above 180 mg/dL
Sustained >180
Rise >50 / ~30 min
Fall >50 / ~30 min
TIR 70–180 >90%
80.6%
83.7%
89.2%
70.7%
69.4%
50.0%
0
20
40
60
80
100
Validation balanced accuracy (%)