인증번호 제 PIA-02-2025-3 호

간이측정기 성능인증서

상 호 (사업장 명칭)	주식회사 에프티랩	
성 명 (대표자)	고재준	
사업장 소재지	경기도 안산시 단원구 해봉로330번길 8 (신길동, 정우벤처타운1) 503호 (전화번호 : 070-4906-4702)	
인증내용	제조사 주식회사 에프티랩	제조국가 대한민국
	기기명칭 라돈 간이측정기	측정방식 펄스형 이온화챔버
	상품명(고유명칭) EF100	측정범위 최소: 7 Bq/m³ 최대: 1 000 Bq/m³
	최소눈금(단위) 1 Bq/m³	공인측정 오차범위 16.1 % (상대정확도)
	성능인증 등급	1등급

「환경분야 시험 · 검사 등에 관한 법률」 제9조의3제1항 및 같은 법 시행규칙 제6조의6제2항에 따라 위와 같이 성능인증서를 발급합니다.

2025년 12월 10일

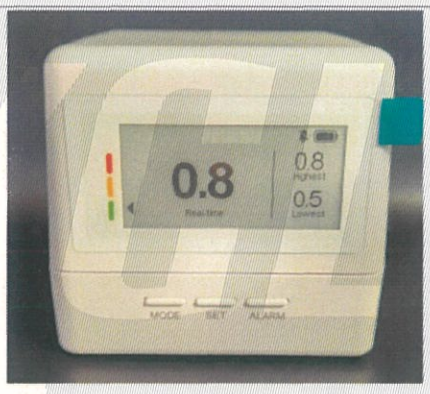
한국건설생활환경시험연구원장

인증번호 제 PIA-02-2025-3 호

성능평가결과

(실내공기질분야/라돈)

반복성 (실내)	평가결과 (최대값)	9.4	%	평가일	2025.11.28	평가자	고광현	등급	1
지시오차 (실내)	평가결과 (최대값)	11.3	%	평가일	2025.11.28	평가자	고광현	등급	1
상대정확도 (실외)	평가기간	2025.11.28 ~ 2025.12.04							
	평가결과 (최대값)	16.1	%	평가자	고광현		등급	1	

인증신청자(상호명)		㈜에프티랩
시험품 정보	제작사	㈜에프티랩
	상품명 (고유명칭)	EF100
	 <사진>	

인증등급	등급기준

☑ 1 등급

○ 대기분야, 실내공기질 분야(이산화탄소)

등급	반복성(실내)	직선성(실내)	상대정확도(실외)
1등급	≤ 10.00 %	≤ 15.00 %	≤ 30 %
등급 외	> 10.00 %	> 15.00 %	> 30 %

☐ 등급외

○ 실내공기질 분야(라돈)

등급	반복성(실내)	지시오차(실내)	상대정확도(실외)
1등급	≤ 20 %	≤ 20 %	≤ 30 %
등급 외	> 20 %	> 20 %	> 30 %

EI-QP-06-02