

Durchlasstest

Hersteller

Produktname

Probenname

Datum


n.a.

Mask

K06-03

2020-07-10 12:53:41.400000

Anzahl Regenerationszyklen	0.0
Differenzdruck Maske	2.4 mbar
Volumenstrom	95.0 L/min
Nozzle Pressure	200.0 mbar
NaCl Konzentration	3.0 w%
Setup	Maskenteststand v1.0
Charge	-
Durchlass	12.02
Aerosolkonzentration	22.57 mg/m ³
Messzeit	180 sec

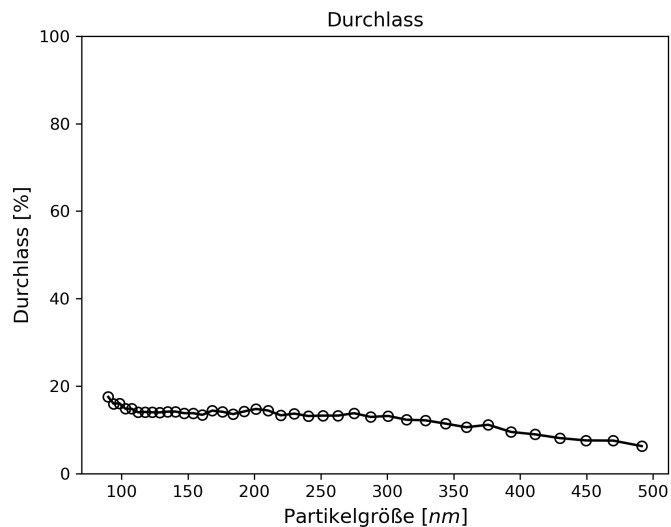

Optische Mängel:

Anmerkungen: