

## Durchlasstest

Hersteller

Produktname

Probenname

Datum


n.a.

Mask

K06-02

2020-07-10 12:47:08.390000

Anzahl Regenerationszyklen	0.0
Differenzdruck Maske	2.8 mbar
Volumenstrom	95.0 L/min
Nozzle Pressure	200.0 mbar
NaCl Konzentration	3.0 w%
Setup	Maskenteststand v1.0
Charge	-
Durchlass	9.07
Aerosolkonzentration	22.57 mg/m <sup>3</sup>
Messzeit	180 sec

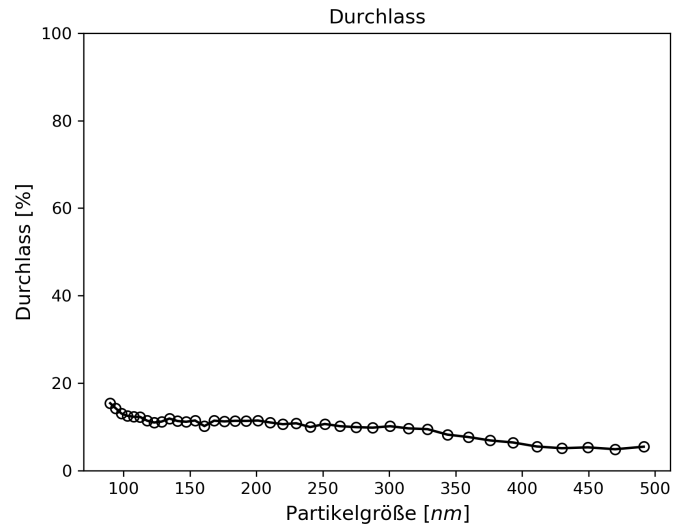

Optische Mängel:

Anmerkungen: