

Durchlasstest

Hersteller

Produktname

Probenname

Datum


3M

Aura 9322+

S004

2020-04-15 08:45:55.260000

Anzahl Regenerationszyklen	1.0
Differenzdruck Maske	32.9 mbar
Differenzdruck ohne Maske	31.2 mbar
Volumenstrom	94.7 L/min
Nozzle Pressure	200.0 mbar
NaCl Konzentration	3.0 w%
Setup	Maskenteststand v1.0
Charge	-
Durchlass	5.81
Aerosolkonzentration	22.65 mg/m ³
Messzeit	180 sec
Druckverlust	1.7 mbar

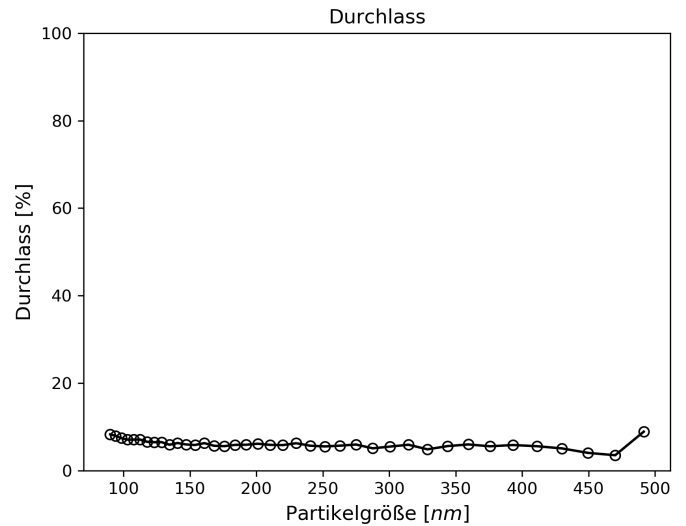

Optische Mängel:

Anmerkungen:

"AVT" auf Maske gekennzeichnet gewesen