

## Durchlasstest

Hersteller

Produktname

Probenname

Datum


3M

Aura 9322+

S004

2020-04-17 10:46:56.270000

Anzahl Regenerationszyklen	1.0
Differenzdruck Maske	23.2 mbar
Differenzdruck ohne Maske	24.7 mbar
Volumenstrom	95.7 L/min
Nozzle Pressure	200.0 mbar
NaCl Konzentration	3.0 w%
Setup	Maskenteststand v1.0
Charge	-
Durchlass	0.69
Aerosolkonzentration	22.41 mg/m <sup>3</sup>
Messzeit	180 sec
Druckverlust	-1.5 mbar

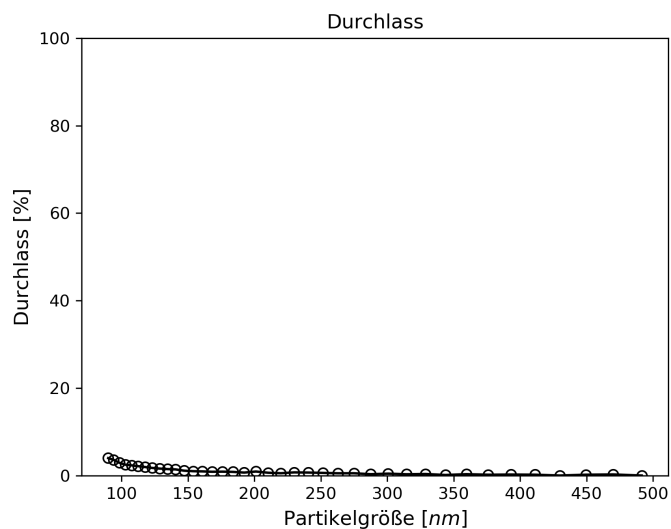

Optische Mängel:

Anmerkungen:

"AVT" auf Maske gekennzeichnet