

Durchlasstest

Hersteller

Produktname

Probenname

Datum


3M

9501V+

LH326

2020-05-13 10:12:37.080000

Anzahl Regenerationszyklen	0.0
Differenzdruck Maske	2.3 mbar
Volumenstrom	14.2 L/min
Nozzle Pressure	150.0 mbar
NaCl Konzentration	3.0 w%
Setup	Maskenteststand v1.0
Charge	-
Durchlass	3.61
Aerosolkonzentration	128.95 mg/m ³
Messzeit	180 sec

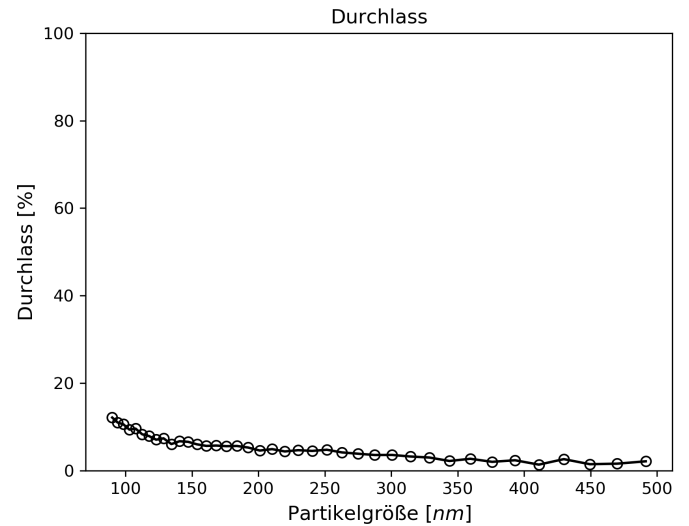

Optische Mängel:

Anmerkungen: