


## Durchlasstest

Hersteller	Produktname	Probenname	Datum
Makrite	Sekura-321	H2_1_3	2020-04-21 09:14:35.590000

Anzahl Regenerationszyklen	0.0
Differenzdruck Maske	24.3 mbar
Differenzdruck ohne Maske	22.0 mbar
Volumenstrom	94.7 L/min
Nozzle Pressure	150.0 mbar
NaCl Konzentration	3.0 w%
Setup	Maskenteststand v1.0
Charge	-
Durchlass	2.82
Aerosolkonzentration	20.44 mg/m <sup>3</sup>
Messzeit	180 sec
Druckverlust	2.3 mbar

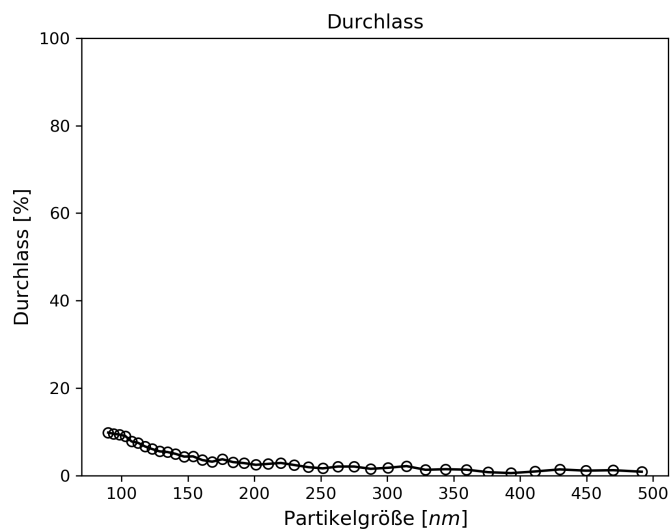

Optische Mängel:

Anmerkungen: