

Durchlasstest

Hersteller

Produktname

Probenname

Datum


3M

Aura 9322+

S005_2

2020-05-22 13:46:40.310000

Anzahl Regenerationszyklen	1.0
Differenzdruck Maske	1.172 mbar
Volumenstrom	95.4 L/min
Nozzle Pressure	200.0 mbar
NaCl Konzentration	3.0 w%
Setup	Maskenteststand v1.0
Charge	-
Durchlass	0.37
Aerosolkonzentration	22.48 mg/m ³
Messzeit	180 sec

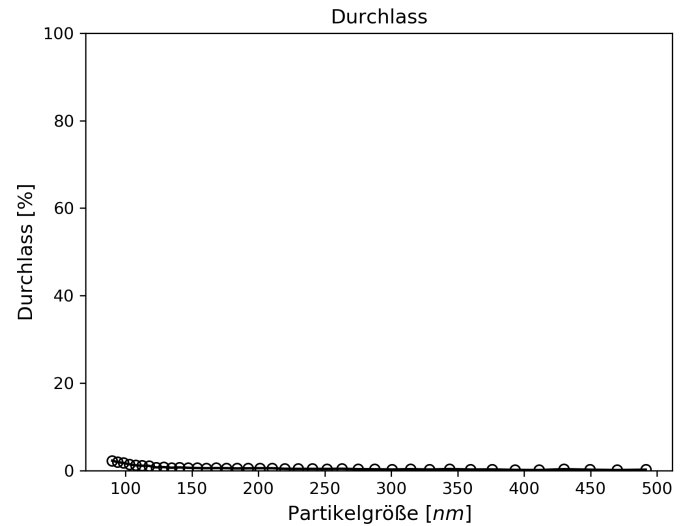

Optische Mängel:

Anmerkungen: