

## Durchlasstest

Hersteller

Produktname

Probenname

Datum


3M

Aura 9322+

S004\_2

2020-05-22 13:39:31.310000

Anzahl Regenerationszyklen	1.0
Differenzdruck Maske	1.12 mbar
Volumenstrom	95.0 L/min
Nozzle Pressure	200.0 mbar
NaCl Konzentration	3.0 w%
Setup	Maskenteststand v1.0
Charge	-
Durchlass	0.24
Aerosolkonzentration	22.57 mg/m <sup>3</sup>
Messzeit	180 sec

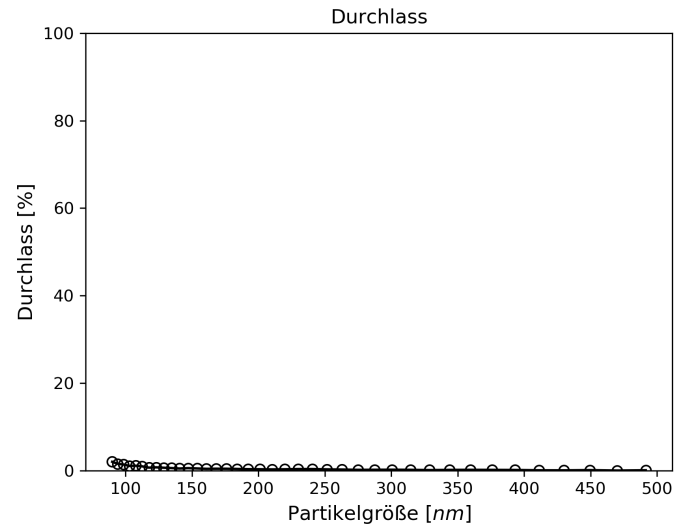

Optische Mängel:

Anmerkungen: